



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209915988 U

(45)授权公告日 2020.01.10

(21)申请号 201920441080.2

(22)申请日 2019.04.02

(73)专利权人 深圳市康立高科技有限公司

地址 518000 广东省深圳市南山区西丽大
勘科技园E栋6楼

(72)发明人 陆永强 侯建凯 侯庆凯 胡映珊
罗庚

(74)专利代理机构 深圳市硕法知识产权代理事
务所(普通合伙) 44321

代理人 王久明

(51)Int.Cl.

A61B 5/0476(2006.01)

A61B 5/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种超低频脑电波检测仪

(57)摘要

本实用新型涉及一种超低频脑电波检测仪，包括能有线或无线通信连接电脑的直流脑电放大器，直流脑电放大器可拆装连接有多个脑电电极，直流脑电放大器内设有与脑电电极电性导通的控制线路板，控制线路板上设有相互电性导通的滤波器单元、运算放大器单元、数模转换器单元、MCU或DSP单元，滤波器单元包括相互电性连接的截止频率为1mHz的高通数字滤波器、截止频率为1Hz的低通数字滤波器，高通数字滤波器在脑电电极安装在直流脑电放大器上后与脑电电极连接并电性导通，低通数字滤波器与运算放大器单元连接并电性导通。该实用新型中通过高通和低通数字滤波器的配合作用，解决了检测1Hz以下的超低频脑电波的问题。

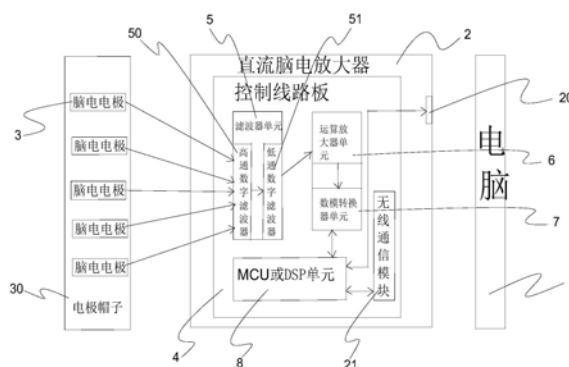

1. 一种超低频脑电波检测仪,其特征在于:包括能有线或无线通信连接电脑的直流脑电放大器,所述直流脑电放大器可拆装连接有多个脑电电极,所述直流脑电放大器内设有与脑电电极电性导通的控制线路板,所述控制线路板上设有相互电性导通的滤波器单元、运算放大器单元、数模转换器单元、MCU或DSP单元,所述滤波器单元包括相互电性连接的截止频率为1mHz的高通数字滤波器、截止频率为1Hz的低通数字滤波器,所述高通数字滤波器在脑电电极安装在直流脑电放大器上后与脑电电极连接并电性导通,所述低通数字滤波器与运算放大器单元连接并电性导通。

2. 根据权利要求1所述超低频脑电波检测仪,其特征在于:所述运算放大器单元和数模转换器单元集成在一个IC里。

3. 根据权利要求1所述超低频脑电波检测仪,其特征在于:所述脑电电极与直流脑电放大器是十八导联可拆装连接的。

4. 根据权利要求3所述超低频脑电波检测仪,其特征在于:所述脑电电极包括十六个设置于头皮上的电极和二个对应设置在左右耳朵上的电极。

5. 根据权利要求1所述超低频脑电波检测仪,其特征在于:所述直流脑电放大器通过设置USB接口与电脑有线通信连接或通过在控制线路板上设置无线通信模块与电脑无线通信连接。

6. 根据权利要求1所述超低频脑电波检测仪,其特征在于:所述直流脑电放大器连接有一固定脑电电极的电极帽子。

一种超低频脑电波检测仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗仪器,尤其是一种能够检测1Hz以下的超低频脑电波的超低频脑电波检测仪。

背景技术

[0002] 脑电(electroencephalograph, EEG)信号作为一种特殊而复杂的生物电信号,反应了大脑的功能状态。大脑皮层的神经元具有生物电活动,经常有持续的节律性电位改变,称为自发脑电活动,通过一定的方式检测这些电活动可以有效地提取人脑中蕴藏的丰富的信息,对这些信息的分析有助于深入的了解大脑的功能,同时可发现大脑的异常病变从而及时诊断大脑疾病。大脑有约170亿的脑细胞构成,不同的脑细胞分管着身体不同的功能,当一种行为产生时,主管该功能的脑细胞就非常活跃,并形成相应的脑波,不同行为脑波频率不同,现代科学已能监测到各种行为的脑波。人的脑波区间主要在4—0.4赫兹之间,分为四个区间,分别命名为 β 、 α 、 θ 、 δ ,兴奋时为 β 波,在14赫兹以上;安静时为 α 波在14-7赫兹,冥想和昏睡时是 θ 波在7—4赫兹,深度睡眠是 δ 波在4—0.4赫兹,眼球快速运动睡眠时脑波在15-30赫兹。通过对不同脑电波的检测就能更好的了解人的身体健康状况,但是现有的脑电图仪都是采用交流脑电放大器,由于脑电放大器中存在高通滤波器(输入端的电容、电阻组成高通滤波器),交流脑电放大器无法检测到1Hz以下的超低频脑电波,也就无法了解人脑在超低频时的状况。

实用新型内容

[0003] 针对现有的不足,本实用新型提供一种能够检测1Hz以下的超低频脑电波的超低频脑电波检测仪。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种超低频脑电波检测仪,包括能有线或无线通信连接电脑的直流脑电放大器,所述直流脑电放大器可拆装连接有多个脑电电极,所述直流脑电放大器内设有与脑电电极电性导通的控制线路板,所述控制线路板上设有相互电性导通的滤波器单元、运算放大器单元、数模转换器单元、MCU或DSP单元,所述滤波器单元包括相互电性连接的截止频率为1mHz的高通数字滤波器、截止频率为1Hz的低通数字滤波器,所述高通数字滤波器在脑电电极安装在直流脑电放大器上后与脑电电极连接并电性导通,所述低通数字滤波器与运算放大器单元连接并电性导通。

[0006] 作为优选,所述运算放大器单元和数模转换器单元集成在一个IC里。

[0007] 作为优选,所述脑电电极与直流脑电放大器是十八导联可拆装连接的。

[0008] 作为优选,所述脑电电极包括十六个设置于头皮上的电极和二对应设置在左右耳朵上的电极。

[0009] 作为优选,所述直流脑电放大器通过设置USB接口与电脑有线通信连接或通过在控制线路板上设置无线通信模块与电脑无线通信连接。

[0010] 作为优选,所述直流脑电放大器连接有一固定脑电电极的电极帽子。

[0011] 本实用新型的有益效果在于:该实用新型将传统的交流脑电放大器改为直流脑电放大器,并采用了高通和低通两种滤波器,先使用截止频率为1mHz的高通数字滤波器过滤掉其他低频信号,然后通过截止频率为1Hz的低通数字滤波器过滤掉高频信号,通过这两种滤波器的配合作用就得到了频率范围为1mHz到1Hz的超低频脑电波信号,就解决了1Hz以下的超低频脑电波无法检测的问题。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型实施例原理结构框图;

[0013] 图2是本实用新型实施例的电路系统示意图;

[0014] 图3是使用本实用新型产品降噪处理后得到的超低频脑电波图;

[0015] 图中零部件名称及序号:1-电脑2-直流脑电放大器20-USB接口21-无线通信模块3-脑电电极30-电极帽子4-控制线路板5-滤波器单元50-高通数字滤波器51-低通数字滤波器单元6-运算放大器单元7-数模转换器单元8-MCU或DSP单元。

具体实施方式

[0016] 为了更清楚地说明本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本实用新型的部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。此外,本实用新型中所提到的方向用语,例如,“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”等,仅是参考附加图示的方向,使用的方向用语是为了更好、更清楚地说明及理解本发明,而不是指示或暗指本实用新型必须具有的方位,因此不能理解为对本发明的限制。

[0017] 本实用新型实施例如图1至图3中所示,一种超低频脑电波检测仪,包括能有线或无线通信连接电脑1的直流脑电放大器2,所述直流脑电放大器2通过设置USB接口20与电脑1有线通信连接或通过控制线路板4上设置无线通信模块21与电脑1无线通信连接,有线连接就可以避免因为通信信号强弱问题而导致的信号连接中断问题的产生,但由于数据线长短的限制会局限其使用范围,无线连接虽然会受到通信信号强弱的影响,但其可以在一定距离范围内移动使用,没有数据线的束缚,使用方便,无线连接可以采用WiFi连接或者蓝牙连接,所述直流脑电放大器2可拆装连接有多个脑电电极3,脑电电极3可拆装连接方便使用,也方便对产品的维护,所述直流脑电放大器2内设有与脑电电极3电性导通的控制线路板4,所述控制线路板4上设有相互电性导通的滤波器单元5、运算放大器单元6、数模转换器单元7、MCU或DSP单元8,所述滤波器单元5采集过滤不需要的脑电波信号并将脑电波信号传输至运算放大器单元6;所述运算放大器单元6将接收到的脑电波信号放大传输至数模转换器单元7;所述数模转换器单元7亦即ADC单元,将接收的脑电波信号转换为数字信号并传输至MCU或DSP单元8,依据不同的需求及对数据不同的处理模式来选择使用MCU还是DSP;所述MCU或DSP单元8作为直流脑电放大器2的大脑控制各个单元的运行并将数字信号传输至电脑1,所述滤波器单元5包括相互电性连接的截止频率为1mHz的高通数字滤波器50、截止频率为1Hz的低通数字滤波器51,所述高通数字滤波器50在脑电电极3安装在直流脑电放大器

2上后与脑电电极3连接并电性导通,所述低通数字滤波器51与运算放大器单元6连接并电性导通,在直流脑电放大器2运行时,高通数字滤波器50与脑电电极3连接并电性导通,也即高通数字滤波器50是处于直流脑电放大器2的输入端,在脑电波数据采集到500秒以上时就可以停止采集,此时截止频率为1mHz (0.001Hz) 的高通数字滤波器50就处理数据过滤掉其它低频信号,然后截止频率为1Hz的低通数字滤波器51就处理经过高通数字滤波器50处理过的数据,过滤掉高频信号,就得到频率范围为1mHz到1Hz的超低频脑电波信号,解决了超低频脑电波信号无法检测的问题,检测到的脑电波信号再经过降噪等相关处理程序后,就得到了准确的脑电波信号,通过对脑电波信号的分析就能精确的了解脑部状况。

[0018] 进一步的改进,如图1中所示,为了简化产品以及控制线路板4的设置,将所述运算放大器单元6和数模转换器单元7集成在一个IC里,这样就方便了产品以及电路的设计,简化了各功能单元的结构布局,方便生产。

[0019] 进一步的改进,如图1中所示,为了更精确的了解大脑的状况,就需要更全面的采集到头部各个部位的脑电波情况,则所述脑电电极3与直流脑电放大器2是十八导联可拆装连接的,而对于该十八导联来说,所述脑电电极3包括十六个设置于头皮上的电极和二个对应设置在左右耳朵上的电极,这样就可以更全面的采集到脑电波的信号,对大脑的状况有更精确的了解判断。设置于头部的脑电电极3过多时就会存在如何将各电极固定在头部相应位置的问题,为了解决该问题,则所述直流脑电放大器2连接有一固定脑电电极3的电极帽子30,这样先将脑电电极3固定在电极帽子30上,然后再将电极帽子30戴在头上就可以,方便使用。

[0020] 应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

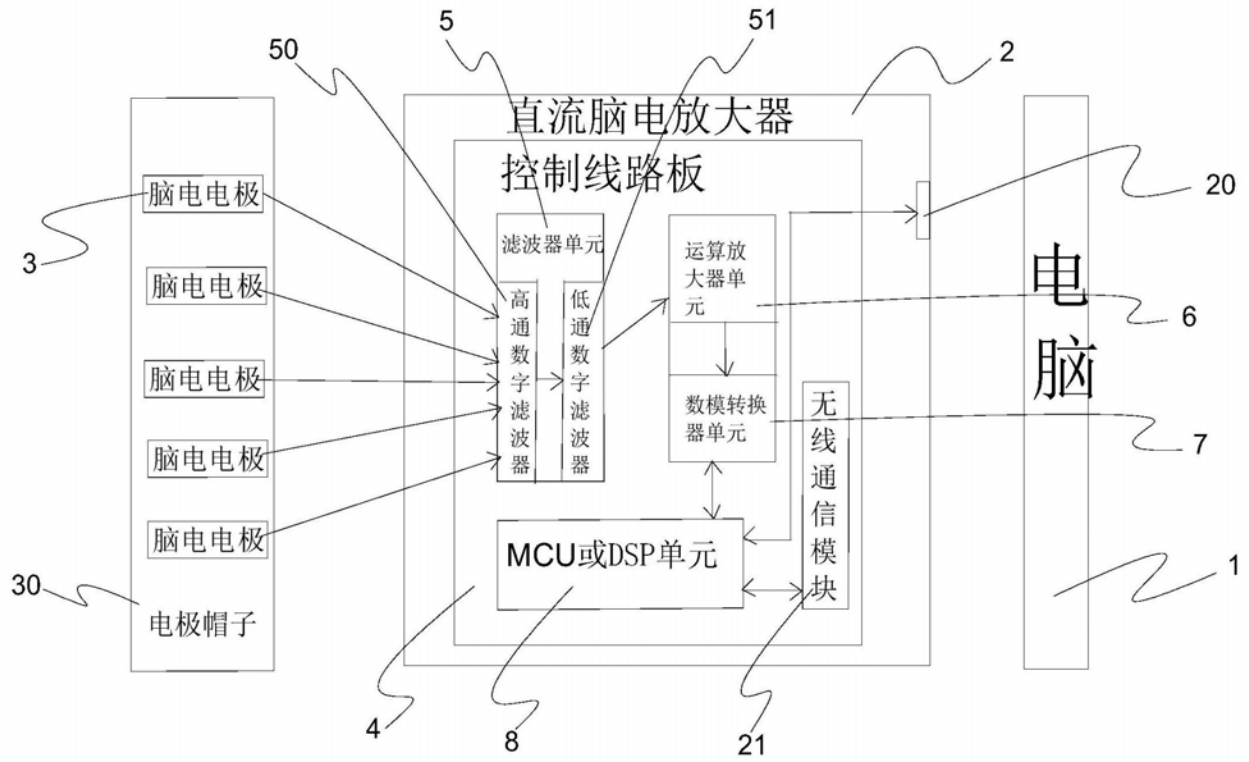


图1

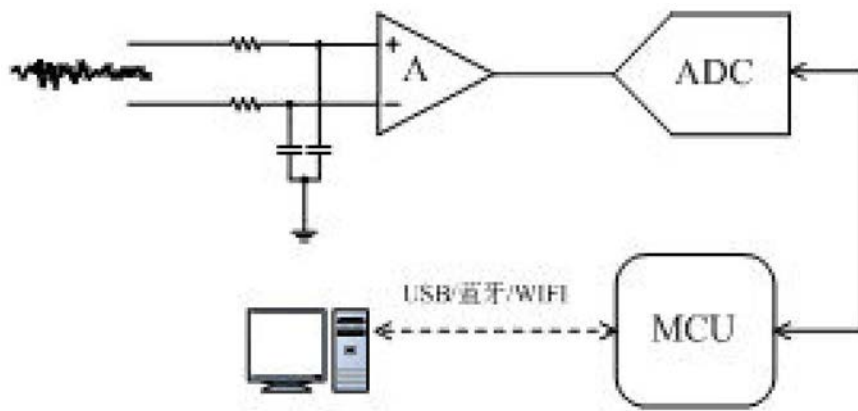


图2

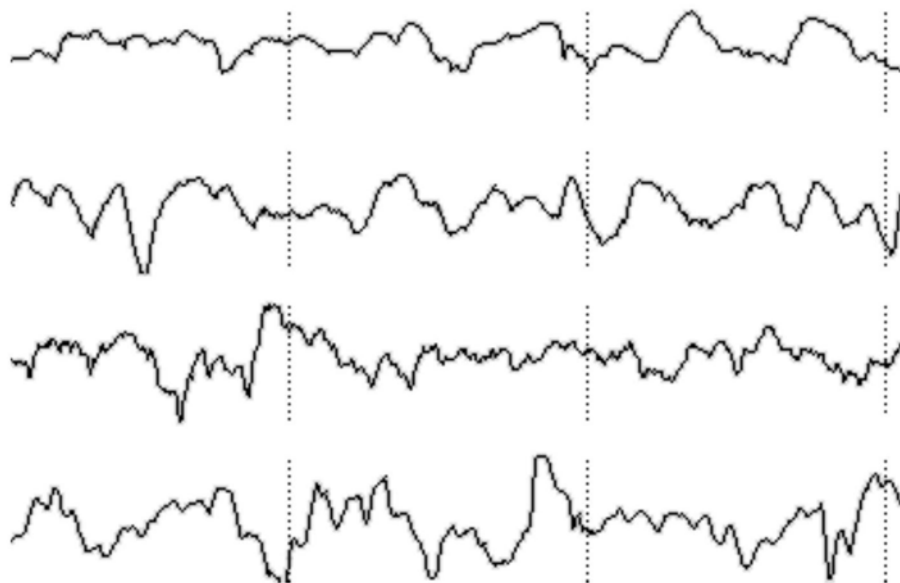


图3

专利名称(译)	一种超低频脑电波检测仪		
公开(公告)号	CN209915988U	公开(公告)日	2020-01-10
申请号	CN201920441080.2	申请日	2019-04-02
[标]申请(专利权)人(译)	深圳市康立高科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	深圳市康立高科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	深圳市康立高科技有限公司		
[标]发明人	陆永强 侯建凯 侯庆凯 罗庚		
发明人	陆永强 侯建凯 侯庆凯 胡映珊 罗庚		
IPC分类号	A61B5/0476 A61B5/00		
代理人(译)	王久明		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型涉及一种超低频脑电波检测仪，包括能有线或无线通信连接电脑的直流脑电放大器，直流脑电放大器可拆装连接有多个脑电电极，直流脑电放大器内设有与脑电电极电性导通的控制线路板，控制线路板上设有相互电性导通的滤波器单元、运算放大器单元、数模转换器单元、MCU或DSP单元，滤波器单元包括相互电性连接的截止频率为1mHz的高通数字滤波器、截止频率为1Hz的低通数字滤波器，高通数字滤波器在脑电电极安装在直流脑电放大器上后与脑电电极连接并电性导通，低通数字滤波器与运算放大器单元连接并电性导通。该实用新型中通过高通和低通数字滤波器的配合作用，解决了检测1Hz以下的超低频脑电波的问题。

