



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203987990 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 10

(21) 申请号 201420223229. 7

(22) 申请日 2014. 05. 04

(73) 专利权人 吴松笛

地址 710002 陕西省西安市碑林区南大街粉巷 30 号

(72) 发明人 不公告发明人

(51) Int. Cl.

A61B 5/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

用于吞咽功能评估的医用刻度勺

(57) 摘要

实用新型涉及一种医疗用具,特别涉及一种用于对吞咽障碍患者进行吞咽功能评估的刻度勺。该医用刻度勺,包括勺头和勺柄,其特征是:勺头能够容纳饮水试验要求的 30ml 饮水量。勺头具有精确刻度,能够准确反映被测试者饮水量,从而方便医师准确判定其吞咽功能。所述勺头的勺沿在勺口处设计为内凹,避免鼻对勺口的阻挡,方便患者饮用。勺柄表面设有防滑纹,有助于评估人员和患者稳定的握持勺子。因此,本实用新型的有益效果是:能够容纳 30ml 水,能准确定量且使用方便的医用刻度勺,便于医师对吞咽障碍患者进行床旁吞咽功能的快速评估,操作简单,评估准确,携带方便。

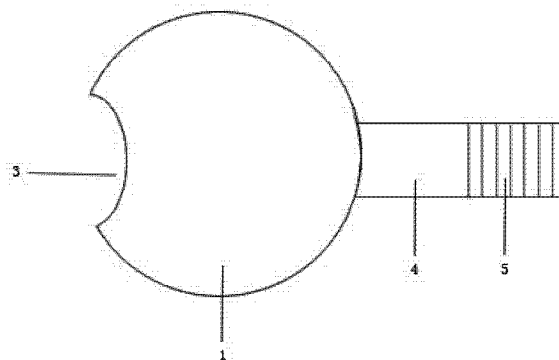

1. 一种用于吞咽功能评估的医用刻度勺,包括勺头和勺柄,其特征在于:勺头(1)能够容纳 30ml 水;勺头(1)从底部至勺沿处具有精确刻度(2),具体刻度包括 5ml、10ml、15ml、20ml、25ml 和 30ml;勺头的勺沿在勺口处(3)设计为内凹;勺柄(4)表面设有防滑纹(5)。

用于吞咽功能评估的医用刻度勺

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医用用具,特别涉及一种用于对吞咽障碍患者进行吞咽功能评估的刻度勺。

背景技术

[0002] 吞咽功能障碍的患者在我国很常见,但以往不被重视。由于此类患者得不到及时和有效的治疗,因此给整个社会和家庭带来沉重负担。要对吞咽功能障碍患者进行规范且持续的康复治疗,首先就是要对此类患者进行吞咽功能的评估。吞咽功能评估最常用的方法是床旁饮水试验,需让患者在坐位状态下,饮 30ml 常温水,观察全部饮完的状况及时间。但目前医疗及日常用具中没有用于该试验的能容纳 30ml 饮水量且具有刻度的勺子,给临床工作带来很多不便。

发明内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的不足,提供了一种能准确评估患者吞咽功能的医用刻度勺。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种医用刻度勺,包括勺头和勺柄,其特殊之处在于:所述勺头能够容纳 30ml 水;所述勺头从底部至勺沿具有精确刻度,具体刻度包括 5ml、10ml、15ml、20ml、25ml 和 30ml;所述勺头的勺沿在勺口处设计为内凹。所述勺柄表面设有防滑纹。

[0005] 勺头能够满足容纳饮水试验要求的 30ml 饮水量。勺头具有精确刻度,能够准确反映被测试者饮水量,从而方便医师准确判定其吞咽功能。所述勺头的勺沿在勺口处设计为内凹,避免鼻对勺口的阻挡,方便患者饮用。勺柄表面设有防滑纹,有助于评估人员和患者稳定的握持勺子。

[0006] 因此,本实用新型的有益效果是:具有能容纳 30ml 水,能准确定量且使用方便的医用刻度勺,便于医师对吞咽障碍患者进行床旁吞咽功能评估,操作简单,评估准确,携带方便。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的俯视示意图。

[0008] 图 2 为本实用新型的侧视示意图。

[0009] 图中,1 勺头,2 刻度标示,3 勺口,4 勺柄,5 防滑纹。

具体实施方式

[0010] 附图为本实用新型的具体实施例。该实施例包括勺头(1)能够容纳 30ml 水;勺头(1)从底部至勺沿具有精确刻度(2),具体刻度包括 5ml、10ml、15ml、20ml、25ml 和 30ml;勺头的勺沿在勺口处(3)设计为内凹。勺柄(4)表面设有防滑纹(5)。

[0011] 采用本实用新型的医用刻度勺,勺头能够容纳饮水试验要求的 30ml 饮水量。勺头具有精确刻度,能够准确反映被测试者饮水量,从而方便医师准确判定其吞咽功能。所述勺头的勺沿在勺口处设计为内凹,避免鼻对勺口的阻挡,方便患者饮用。勺柄表面设有防滑纹,有助于评估人员和患者稳定的握持勺子。因此,本实用新型的有益效果是:能够容纳 30ml 水,能准确定量且使用方便的医用刻度勺,便于医师对吞咽障碍患者进行床旁吞咽功能的快速评估,操作简单,评估准确,携带方便。

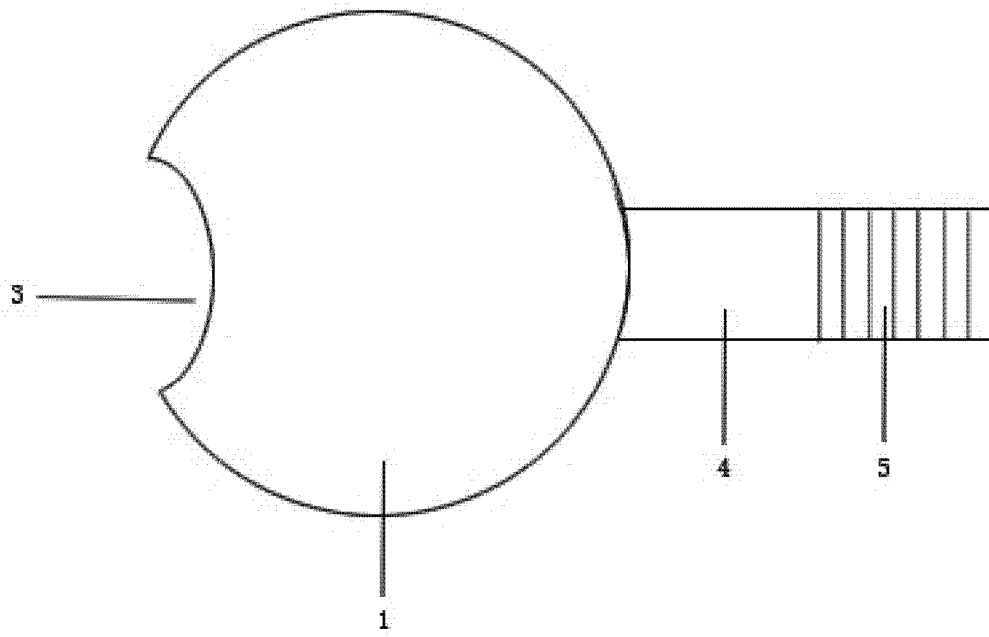


图 1

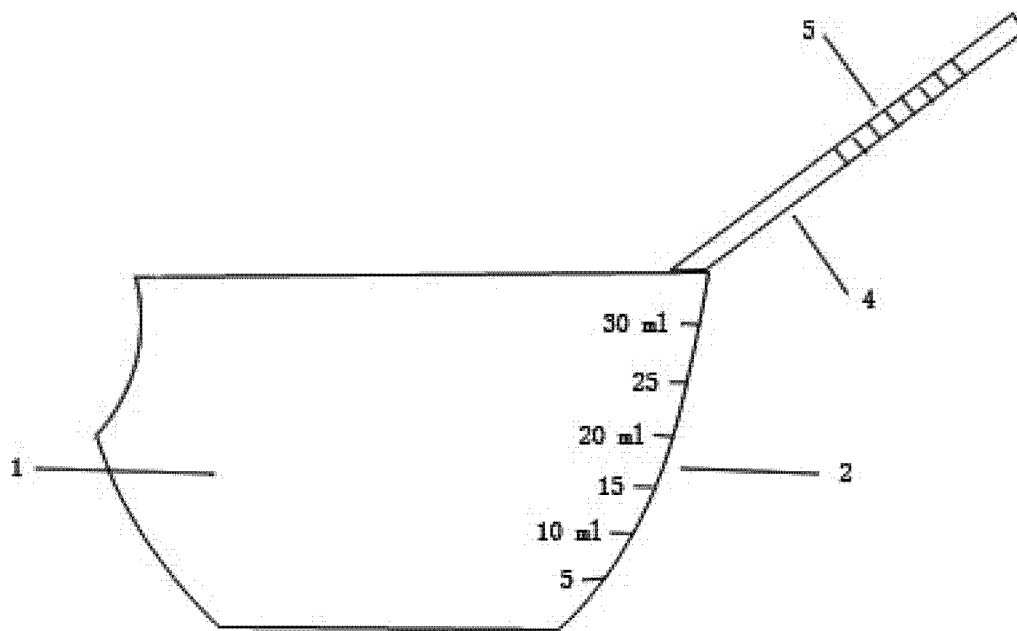


图 2

专利名称(译)	用于吞咽功能评估的医用刻度勺		
公开(公告)号	CN203987990U	公开(公告)日	2014-12-10
申请号	CN201420223229.7	申请日	2014-05-04
[标]发明人	不公告发明人		
发明人	不公告发明人		
IPC分类号	A61B5/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

实用新型涉及一种医疗用具，特别涉及一种用于对吞咽障碍患者进行吞咽功能评估的刻度勺。该医用刻度勺，包括勺头和勺柄，其特征是：勺头能够容纳饮水试验要求的30ml饮水量。勺头具有精确刻度，能够准确反映被测试者饮水量，从而方便医师准确判定其吞咽功能。所述勺头的勺沿在勺口处设计为内凹，避免鼻对勺口的阻挡，方便患者饮用。勺柄表面设有防滑纹，有助于评估人员和患者稳定的握持勺子。因此，本实用新型的有益效果是：能够容纳30ml水，能准确定量且使用方便的医用刻度勺，便于医师对吞咽障碍患者进行床旁吞咽功能的快速评估，操作简单，评估准确，携带方便。

