



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
26.12.2007 Patentblatt 2007/52

(51) Int Cl.:
A61B 5/00 (2006.01) **A61N 1/08** (2006.01)
G06F 13/22 (2006.01) **H04L 12/28** (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **06012693.5**

(22) Anmeldetag: **21.06.2006**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA HR MK YU

(71) Anmelder:
• **Roche Diagnostics GmbH**
68305 Mannheim (DE)
Benannte Vertragsstaaten:
DE
• **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG**
4070 Basel (CH)
Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

(72) Erfinder:
• **Rasch-Menges, Juergen, Dr.**
68723 Schwetzingen (DE)
• **Jansen, Paul**
68163 Mannheim (DE)
• **Haar, Hans-Peter, Dr.**
69168 Wiesloch (DE)
• **Haueter, Ulrich**
3506 Grosshöchstetten (CH)
• **Poreda, Andreas, Dr.**
68259 Mannheim (DE)

(74) Vertreter: **Petirsch, Markus et al**
Durm & Partner
Beiertheimer Allee 19
76137 Karlsruhe (DE)

(54) **Diabetescare-System zur Detektion eines Analyten und Verfahren zur selektiven Datenübertragung**

(57) Ein Diabetescare-System weist eine mobile Komponente (2) und eine Basisstation (3) auf, wobei die mobile Komponente (2) am Körper tragbar oder in den Körper implantierbar ist, und einen Speicher (7) zum Speichern von Daten und eine Kommunikationseinheit (5) zur Übertragung von Daten an die Basisstation (3) einschließt, die Basisstation (3) eine Kommunikationseinheit (8) zum drahtlosen Empfangen von Daten von der mobilen Komponente (2) und eine Speichereinheit (9) zum Abspeichern von übertragenen Daten und optional eine Ausgabeeinheit (10) zur Anzeige von von der mobilen Komponente (2) übertragenen Daten aufweist, eine Datenübertragung zwischen der mobilen Komponente (2) und der Basisstation (3) innerhalb einer Zeitspanne stattfindet, in der eine drahtlose Kommunikationsverbindung besteht, dadurch gekennzeichnet, dass eine Datenübertragung derartig selektiv durchgeführt wird, dass innerhalb einer ersten Zeitspanne in der eine drahtlose Kommunikationsverbindung besteht, eine erste Teilmenge der Daten von der mobilen Komponente (2) an die Basisstation (3) übertragen wird, wobei die erste Teilmenge mittels eines prozessorgesteuerten Selektionsalgorithmus derartig selektiert wird, dass die in der ersten Zeitspanne übertragenen Daten für die Gesamtheit der in der mobilen Komponente (2) abgespeicherten Daten repräsentativ ist.

Ein Verfahren zur selektiven Datenübertragung innerhalb eines solchen Systems umfasst das Selektieren einer ersten Teilmenge der Daten mittels eines prozessorgesteuerten Selektionsalgorithmus und das Übertragen der ersten Teilmenge von der mobilen Komponente (2) zur Basisstation (3) innerhalb der ersten Zeitspanne, wobei die erste Teilmenge derartig selektiert wird, dass die in der ersten Zeitspanne übertragenen Daten für die Gesamtheit der in der mobilen Komponente (2) abgespeicherten Daten repräsentativ ist.

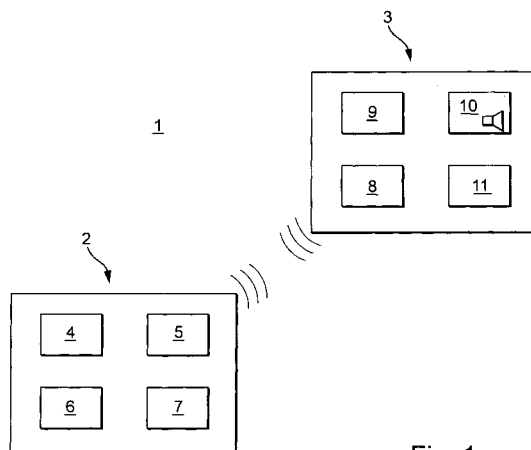


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Diabetescare-System mit einer mobilen Komponente und einer Basisstation, wobei die mobile Komponente am Körper tragbar oder in den Körper implantierbar ist und einen Speicher zum Speichern von Daten, sowie eine Kommunikationseinheit zur Übertragung von Daten an die Basisstation einschließt. Die Basisstation weist eine Kommunikationseinheit zum drahtlosen Empfangen von Daten von der mobilen Komponente und eine Speichereinheit zum Abspeichern von übertragenen Daten auf. Optional kann eine Ausgabereinheit zur Anzeige von Daten, die von der mobilen Komponente übertragen worden sind, vorgesehen sein. Eine Datenübertragung zwischen der mobilen Komponente und der Basisstation findet innerhalb einer Zeitspanne statt, in der eine drahtlose Kommunikationsverbindung besteht. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur selektiven Datenübertragung innerhalb eines Diabetescare-Systems mit einer mobilen Komponente und einer Basisstation.

[0002] Diabetescare-Systeme dienen zur Detektion eines für die Behandlung des Diabetes Mellitus relevanten Analyten im menschlichen Körper und/oder zur Therapie, insbesondere durch Injektion von Medikamenten. Wichtige Beispiele sind Blutglucosemeter oder Insulinpumpen. Moderne Diabetescare-Systeme unterstützen ihre Benutzer, indem durchgeführte Aktionen protokolliert werden und somit für eine spätere Auswertung zur Verfügung stehen. Auf diese Weise entstehen im Laufe einer längeren Benutzungsdauer sogenannte "history-files".

[0003] Ebenso wie die Protokolldaten von ausgeführten Aktionen können bei Diabetescare-Systemen Analysedaten abgespeichert werden. Speziell bei am Körper tragbaren (invasiven oder nicht-invasiven) und bei im Körper implantierten Analysesystemen findet eine häufige, oft sogar praktisch kontinuierliche Messung und Bestimmung des Analyten statt, bei der eine große Menge an Mess- bzw. Analysedaten gewonnen werden. Die zwischengespeicherten Daten müssen dann von Zeit zu Zeit an eine Basisstation, beispielsweise einen PC, übertragen werden.

[0004] Zu diesem Zweck werden bei am Körper tragbaren Geräten häufig drahtgebundene Schnittstellen oder drahtlose Schnittstellen mit entsprechenden Schnittstellenprotokollen verwendet. Bei implantierten Geräten erfolgt die Datenübertragung naturgemäß immer drahtlos. Bei der "klassischen" Datenübertragung wird typischerweise das gesamte vorhandene Datenmaterial heruntergeladen. Dabei findet eine sequentielle Übertragung statt, wobei die Daten in der Reihenfolge ihrer Erzeugung (first in - first out) oder in der umgekehrten Reihenfolge Erzeugung (last in - first out) übertragen werden.

[0005] Bei diesem klassischen Vorgehen wird vorausgesetzt, dass die Datenverbindung wenigstens für die Dauer des Übertragens aller Daten besteht. Sie darf in

der Regel nicht unterbrochen werden. Der Benutzer ist sich bewusst, dass die Datenübertragung stattfindet, da er die Übertragung aktiv initiiert hat und überwacht den Vorgang. Die verwendete Software zur Datenübertragung zeigt den Verlauf der Übertragung zudem meist an, beispielsweise als Graphik und/oder als Prozentzahl.

[0006] Dieses Übertragen der Daten wird von den Benutzern als recht unkomfortabel empfunden. Sie sehen sich an die Basisstation "angebunden", da die Übertragung nicht unterbrochen werden soll und sie sich während der Datenübertragung nicht von der Basisstation entfernen können.

[0007] Um den Bedienerkomfort zu erhöhen, werden Systeme gefordert, bei denen die Kommunikation zwischen der mobilen Komponente, die am oder im Körper tragbar ist, und der Basisstation "on-demand" gestaltet ist, ohne dass sie von dem Benutzer initiiert oder überwacht werden muss. Dabei findet eine drahtlose Kommunikation automatisch statt, wenn der Benutzer die mobile Komponente in die Nähe der Basisstation bringt. Die Geräte erkennen die Nähe der jeweiligen Partnerkomponente automatisch. Der Verbindungsaufbau ist für den Benutzer deshalb sehr komfortabel und anwenderfreundlich.

[0008] Nur wenn sich der Benutzer nahe genug an der Basisstation aufhält, kann eine Datenübertragung durchgeführt werden. Die Verbindungsdauer, die für eine derartige Kommunikation zwischen einer am Körper getragenen mobilen Komponente und der Basisstation zur Verfügung steht, ändert sich in Abhängigkeit der Verweildauer des Benutzers in der Nähe der Basisstation. Somit ist die zur Datenübertragung nutzbare Zeitdauer dem System unbekannt. Mit den im Stand der Technik bekannten Diabetescare-Systemen ist eine zuverlässige Datenübertragung bei variierender und unbekannter Verbindungsdauer nicht möglich.

[0009] Bei der Verwendung von Diabetescare-Systemen besteht darüber hinaus eine besondere Problematik:

- Auf der einen Seite übernehmen diese Systeme lebenswichtige medizinische Funktionen mit hoher Komplexität. Ein Eingriff in das Regulationssystem des menschlichen Körpers, wie es aufgrund der von solchen System gewonnenen Daten oder von den Systemen direkt vorgenommen werden kann, wird sonst typischerweise von medizinisch hochqualifiziertem Personal und unter dessen ständiger Beobachtung vorgenommen, zum Beispiel auf einer Intensivstation. Der Bediener der Diabetescare-Systeme, beispielsweise einer Insulinpumpe, ist jedoch der Patient, der in der Regel ein medizinischer Laie ist und die Auswirkungen eines Eingriffs in das System nicht vollständig übersehen kann.
- Auf der anderen Seite verfügen Diabetiker aufgrund ihrer Krankheit, gerade im fortgeschrittenen Stadium, nur noch über eine eingeschränkte Motorik und

eine reduzierte Aufmerksamkeit. Dies kann zu Fehlfunktionen und Fehleinstellungen der Geräte oder dazu führen, dass abweichende Einstellungen, wie beispielsweise eine falsch geregelte Insulinzugabe, nicht bemerkt werden. Dies kann schwere gesundheitliche Schäden bei den Patienten hervorrufen. Auch aus diesem Grund ist es wichtig, die Aktionen des Patienten zu protokollieren und regelmäßig an eine Basisstation zu übertragen, die Auswerte- und Alarmierungsfunktionen übernehmen kann.

[0010] Aufgrund der geschilderten Probleme besteht ein erhebliches Risiko, dass bei einer drahtlosen Kommunikationsverbindung zwischen dem am Körper getragenen Gerät und der Basisstation die gesamte Verbindungsdauer zum vollständigen Übertragen aller Daten nicht zuverlässig gewährleistet werden kann.

[0011] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Diabetescare-System vorzuschlagen, bei dem eine Datenübertragung von einer am Körper getragenen mobilen Komponente an eine Basisstation unter Berücksichtigung der erläuterten Probleme und Anforderungen mit erhöhtem Benutzerkomfort erreicht wird.

[0012] Gelöst wird die vorliegende Aufgabe durch ein Diabetescare-System mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch ein Verfahren zur selektiven Datenübertragung mit den Merkmalen des Anspruchs 16.

[0013] Das erfindungsgemäße Diabetescare-System zur Anwendung am menschlichen Körper umfasst eine mobile Komponente und eine Basisstation. Die mobile Komponente ist am Körper tragbar oder in den Körper implementierbar und schließt einen Speicher zum Speichern von Daten und eine Kommunikationseinheit zur Übertragung von Daten an die Basisstation ein. Die Basisstation hat eine Kommunikationseinheit zum drahtlosen Empfangen von Daten von der mobilen Komponente und eine Speichereinheit zum Abspeichern von übertragenen Daten. Optional weist die Basisstation auch eine Ausgabereinheit zur Anzeige von Daten auf, die von der mobilen Komponente übertragen worden sind. Die Datenübertragung zwischen der mobilen Komponente und der Basisstation erfolgt innerhalb einer Zeitspanne, in der eine drahtlose Kommunikationsverbindung besteht. Da die Zeitspanne zur Datenübertragung prinzipiell unbekannt ist, wird eine selektive Datenübertragung durchgeführt, wobei innerhalb der ersten Zeitspanne eine erste Teilmenge von Daten übertragen wird. Die erste Teilmenge der Daten wird mittels eines prozessorgesteuerten Selektionsalgorithmus derart selektiert, dass die in der Zeitspanne übertragenen Daten für die Gesamtheit der in der mobilen Komponente abgespeicherten Daten repräsentativ ist.

[0014] Im Rahmen der Erfindung wurde festgestellt, dass gerade bei Diabetescare-Systemen mit einer kurzen Übertragungszeit zu rechnen ist, da der Diabetiker aufgrund eingeschränkter Aufmerksamkeit die drahtlose Kommunikation zwischen der am Körper getragenen mobilen Komponente und der Basisstation häufig nicht

wahrnimmt bzw. überwacht. Deshalb ist die Datenmenge, die während der bestehenden Verbindung übertragen werden kann, häufig nur ein Bruchteil der in der mobilen Komponente gespeicherten Daten.

[0015] Durch geeignete Selektion der Daten kann schon mit einer relativ geringen Anzahl an selektierten und übertragenen Daten eine zuverlässige Aussage über die Gesamtheit der Daten gemacht werden. Dazu findet bevorzugt eine Priorisierung der Daten dergestalt statt, dass die Daten, deren Informationsgehalt am höchsten ist, bevorzugt übertragen werden. Dadurch, dass die in der ersten Teilmenge selektierten Daten die Gesamtheit der Daten abbilden, ist es nicht notwendig, alle Daten zu übertragen bzw. auszuwerten, um einen hinreichend genauen Informationsüberblick über die Gesamtheit der Daten zu erhalten.

[0016] Ein derartiges Diabetescare-System ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die mobile Komponente eine kontinuierlich arbeitende und messende Messeinheit aufweist, die im Körper implantiert ist. In dem Speicher der mobilen Komponente sind in der Regel Messwerte aus einem längeren Zeitraum, bis zu mehreren Tagen, enthalten. Aus dieser großen Zahl der Messwerte wird mit der vorliegenden Erfindung ein möglichst genaues Bild der Gesamtheit der Messwerte schon durch eine kleine Teilmenge erzeugt.

[0017] Da die Messwerte bzw. deren Auswertung zur Analyse und Bewertung von Regelgrößen dienen, nämlich beispielsweise bei Blutzuckermessgeräten zur Festlegung der zu verabreichenden Insulindosis, sind die aktuellsten Messwerte in der Regel besonders wichtig. Bevorzugt wird deshalb mindestens ein Teil der ersten Teilmenge der selektierten Daten oder Messwerte in einer Reihenfolge an die Basisstation übertragen, die umgekehrt zu der Reihenfolge ihrer Erzeugung ist ("last in - first out - Prinzip"). Der zuletzt gemessene Messwert wird zuerst übertragen. Dieses Prinzip muss nicht strikt angewendet werden, da es mit anderen Kriterien der Übertragung, die im Vordergrund stehen, kombiniert werden kann. Prinzipiell gilt auch hier, dass der Informationsgehalt eines Messwertes entscheidend ist, nicht allein der Zeitpunkt seiner Erstellung.

[0018] Um ein möglichst gutes Abbild der Gesamtheit der Daten zu erhalten, sind generell zwei Strategien möglich:

1. Die Auswahl bzw. Selektion der Daten aus der Gesamtheit kann mit einem festen Raster von Daten, die sich auf äquidistante Zeitpunkte beziehen, vorgenommen werden.
2. Die Daten der ersten Teilmenge werden derart selektiert, dass ein festes Raster vermieden wird, also der zeitliche Abstand zwischen zwei selektierten Daten nicht äquidistant ist.

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform, in der die erste Teilmenge der Daten in einem festen zeitlichen

Raster selektiert wird, wobei der zeitliche Abstand zwischen zwei selektierten Daten äquidistant ist, wird eine gleichmäßige Übersicht der Daten aus der Gesamtheit erzeugt. Die Selektion der Daten kann dann, nachdem die erste Teilmenge der Daten von der mobilen Komponente an die Basisstation übertragen worden ist, sukzessive verfeinert werden, indem das Raster verschoben wird, beispielsweise so, dass der erste auszuwählende Wert zwischen zwei Daten der ersten Teilmenge liegt. Alternativ kann auch der äquidistante zeitliche Abstand zwischen den selektierten Daten verringert werden.

[0020] Die Selektion mit einem konstanten Raster bietet einen guten und schnellen Überblick über die Gesamtheit der Daten. Diese Methode ist insbesondere dann anzuwenden, wenn keiner der ausgewählten Messwerte auffällig erscheint. Allerdings werden bei einem konstanten Raster periodische Fehler nicht zuverlässig erkannt. Auch Ausreißer, also Daten, die oberhalb einer medizinisch akzeptablen Grenze liegen, oder Messfehler, werden bei einem festen Raster nicht unbedingt detektiert.

[0021] Vorteilhafterweise werden die Daten der ersten Teilmenge mittels eines Selektionsalgorithmus selektiert, in dem eine Wahrscheinlichkeitsfunktion implementiert ist. Dabei ist der zeitliche Abstand zwischen je zwei zeitlich benachbarten selektierten Daten der ersten Teilmenge verschieden. Die selektierten Daten der ersten Teilmenge werden gemäß einer Wahrscheinlichkeitsdichte ausgewählt.

[0022] In der Funktion können auch übergeordnete "Meta-Informationen" implementiert sein. Diese "Meta-Informationen" können von dem Diabetescare-System oder dem Analysesystem bzw. der mobilen Komponente selbst generiert werden, wenn es sich um ein "selbstlernendes" System handelt. Dazu werden aus der Vergangenheit und der Analyse der schon bei früheren Datenübertragungen ausgewählten und übertragenen Daten, beispielsweise Informationen darüber gewonnen, wann verstärkt Auffälligkeiten in Messwerten auftreten. Ist bei einem Patienten das Auftreten von auffälligen Werten am Morgen bisher verstärkt vorgekommen, so ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass auch bei den aktuell im Speicher der mobilen Komponente vorhandenen Werten auffällige Werte am Morgen detektiert wurden, erhöht. Der Selektionsalgorithmus kann derart verändert werden, dass insbesondere morgens verstärkt Werte abgefragt werden.

[0023] Dem Selektionsalgorithmus kann anstatt der Wahrscheinlichkeitsfunktion auch eine Zufallsfunktion zugrunde liegen, so dass die selektierten Daten der ersten Teilmenge "zufällig" ausgewählt werden. Der zeitliche Abstand je zweier benachbarter selektierter Daten ist dann in der Regel ebenfalls verschieden und nicht äquidistant, so dass die Probleme beim Auftreten periodischer Fehler vermieden werden.

[0024] Vorzugsweise wird aus bereits durchgeführten Datenübertragungen zwischen der mobilen Komponente und der Basisstation auch die voraussichtliche Dauer der ersten Zeitspanne für die Datenübertragung ermittelt.

Ebenso kann aus bereits stattgefundenen Datenübertragungen die voraussichtliche Datenmenge, die in der Zeitspanne der bestehenden Kommunikationsverbindung übertragen werden kann, ermittelt werden. Diese Zeitdauer bzw. die Menge der Daten ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit dafür, dass auch bei der nun stattfindenden bzw. bei der nächsten Datenübertragung zwischen der mobilen Komponente und der Basisstation die gleiche Verbindungsdauer zur Verfügung steht bzw. die gleiche Anzahl an Daten übertragen werden können. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Patient ein in etwa gleichbleibendes Verhaltensmuster zeigt. Insbesondere wenn mehrere bereits stattgefundene Datenübertragungen ausgewertet werden können, lässt sich die Vorhersage der nächsten Übertragungsdauer präzisieren. Somit lässt sich eine effektive Nutzung des zur Verfügung stehenden Zeitraums der Datenübertragung erreichen.

[0025] Bevorzugt wird die erste Teilmenge der Daten, die von der mobilen Komponente an die Basisstation während einer Datenübertragung übertragen worden ist, in dem Diabetescare-System registriert. Besonders vorteilhaft ist es, wenn sowohl in der mobilen Komponente als auch in der Basisstation die bereits übertragenen Daten vermerkt werden. Alternativ wird nur in einem der beiden Geräte ein Merker gesetzt. Wird eine Datenübertragung vorzeitig abgebrochen, beispielsweise weil sich der Benutzer mit seiner mobilen Komponente von der Basisstation entfernt, und dies auch nicht seinem vorhergesagten Verhaltensmuster entspricht, so kann bei der nächsten Datenübertragung die abgebrochene Übertragung fortgesetzt werden. In diesem Fall müssen bereits übertragene Daten nicht noch einmal von der mobilen Komponente an die Basisstation übermittelt werden. Die Effizienz der Datenübertragung von der mobilen Komponente zur Basisstation steigt dadurch. In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Diabetescare-Systems werden die bereits übertragenen Daten der ersten Teilmenge aus dem Speicher der mobilen Komponente gelöscht.

[0026] Unter mobilen Komponenten, die "am Körper tragbar" sind, werden auch solche verstanden, die mit dem Körper in Kontakt gebracht werden. Ein Beispiel hierfür ist ein Injektionspen zum Spritzen eines Medikaments, beispielsweise Insulin, bei dem Dosierinformationen an eine Basisstation übertragen werden sollen. Ein derartiges mobiles Gerät wird nur kurzzeitig am Körper getragen, nämlich während der Applikation des Medikaments.

[0027] Der Begriff "Daten" wird im Rahmen dieser Erfindung in seiner allgemeinen Form verstanden und umfasst alle Informationen, die zwischen einer mobilen Komponente und einer Basisstation eines Diabetescare-Systems übertragen werden. Hierzu gehören beispielsweise Messwerte von Blutparametern, wie Blutzucker, Dosiervolumina, insbesondere von Injektionspens, Fördervolumina von Pumpen, insbesondere Insulinpumpen oder gemessene Druckverläufe. Ebenso sind auch Zeitwerte von dem Begriff "Daten" umfasst, die beispielsweise

se von einer internen Uhr oder einem Zähler generiert werden und als absolute oder relative Zeit vorliegen können. Auf diese Weise kann der Zeitpunkt der Erhebung der Messwerte erfasst und übertragen werden. Daten können darüberhinaus gemessene elektrische Widerstände, Spannungen oder Ströme sein. Auch optisch erfasste Werte (Photometrie) oder andere Zustandsinformationen sind im Rahmen dieser Erfindung unter den Begriff "Daten" subsumiert.

[0028] Eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Diabetescare-Systems wird anhand der nachstehenden Zeichnungen im Detail erläutert. Die dargestellten Besonderheiten können einzeln oder in Kombination verwendet werden, um bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung zu schaffen. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit wird hier ein Analysesystem als eine mögliche Ausführungsform des Diabetescare-Systems beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 ein Analysesystem mit einem Analysegerät und einer Basisstation;

Fig. 2 eine Grafik des zeitlichen Verlaufs der in einem Speicher des Analysegerätes hinterlegten Messwerte;

Fig. 3 einen zeitlichen Verlauf der Messwerte mit einem ersten Auswahlkriterium;

Fig. 4 einen zeitlichen Verlauf der Messwerte mit einem zweiten Auswahlkriterium;

Fig. 5 den zeitlichen Verlauf mit einem dritten Auswahlkriterium;

Fig. 6 den zeitlichen Verlauf mit einem vierten Auswahlkriterium;

[0029] Das in Figur 1 dargestellte Analysesystem 1 umfasst als mobile Komponente ein am Körper tragbares oder implantierbares Analysegerät 2 und eine separate Basisstation 3.

[0030] Das Analysegerät 2 enthält eine Messeinheit 4 zur Detektion eines Analyten und zum Erzeugen von für die Analyse geeigneten Messwerten. Es schließt weiter eine Kommunikationseinheit 5, einen Prozessor 6 und einen Speicher 7 zur Speicherung von Messwerten ein. Die Messwerte bilden Daten, die bei bestehender Kommunikationsverbindung an die Basisstation übertragen werden. Eine erste Teilmenge der Messwerte wird mittels eines Selektionsalgorithmus selektiert, der vorzugsweise von dem Prozessor 6 des Analysegerätes 2 gesteuert wird.

[0031] Bevorzugt wird die erste Teilmenge der Messwerte schon vor Beginn der Datenübertragung zwischen dem Analysegerät 2 und der Basisstation 3 selektiert. Damit stehen beim Aufbau einer Datenverbindung zwischen dem Analysegerät 2 und der Basisstation 3 alle

zu übertragenden Messwerte zur Verfügung, so dass sie sofort übermittelt werden können.

[0032] Die Basisstation 3 umfasst eine Kommunikationseinheit 8 zum drahtlosen Empfangen von Messwerten des Analysegerätes 2, eine Speichereinheit 9 zum Abspeichern der von dem Analysegerät 2 übertragenen Messwerte und eine Ausgabereinheit 10, mit der die Messwerte angezeigt werden. Die Ausgabereinheit 2 kann neben einem Display auch einen Lautsprecher umfassen, um akustische Signale bzw. den Messwert in Form von Sprache auszugeben.

[0033] Vorzugsweise schließt die Basisstation 3 eine Meldeeinrichtung 11 ein, um eine optische und/oder akustische Warnmeldung auszugeben, wenn die Anzahl der übertragenen Messwerte eine untere Grenze unterschreitet. Die Meldeeinrichtung 11 kann ein Display, eine optische Lichtanzeige und/oder einen Lautsprecher umfassen. Die Warnmeldung kann insbesondere erzeugt werden, wenn zu wenig Messwerte vom Analysegerät 2 zur Basisstation 3 übertragen worden sind, um eine zuverlässige Aussage über die Gesamtheit der in dem Analysegerät gespeicherten Messwerte zu treffen.

[0034] Zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung zwischen der Kommunikationseinheit 5 des Analysegerätes 2 und der Kommunikationseinheit 8 der Basisstation 3, sendet die Basisstation 3 auf einer definierten Frequenz und mit einer definierten Sendeleistung eine Anfrage aus. Die Basisstation 3 wird dabei als "Master" bezeichnet, während das Analysegerät 2 der "Slave" ist, so dass eine "Master-Slave-Beziehung" zwischen den beiden Geräten besteht. Das Analysegerät 2 als Slave lauscht auf der gleichen Frequenz auf eine ankommende Anfrage von der Basisstation 3. Die Sendeleistung kann derart ausgelegt sein, dass das Analysegerät anhand der Zunahme der Signalstärke die Unterschreitung eines definierten Abstandes erkennt. Möglich ist auch eine Messung der bidirektionalen Datenübertragungszeit zwischen der Kommunikationseinheit 5 und der Kommunikationseinheit 8.

[0035] Wird der vorgegebene Abstand zwischen dem Analysegerät 2 und der Basisstation 3 unterschritten, so antwortet das Analysegerät 2 auf die Anfrage der Basisstation 3. Die Verbindung zwischen den Kommunikationseinheiten 5,8 wird aufgebaut. Optional kann eine Wartezeit vor Beginn der eigentlichen Datenübertragung festgelegt werden, z.B. um eine zu kurze oder eventuell ungewollte Verbindung zu erkennen oder um die Datenübertragungsparameter zwischen den beiden Geräten zu justieren, also die Geschwindigkeit der Datenübertragung, die Sendeleistung, etc. einzustellen.

[0036] Sind alle Voraussetzungen erfüllt, so sendet das Analysegerät 2 (vorzugsweise auch ohne eine direkte Anfrage von der Basisstation 3) die erste Teilmenge der Messwerte an den Master, also die Basisstation 3. Der Verzicht auf die Anfrage der Basisstation 3 verkürzt die zum Datenaustausch benötigte Zeit.

[0037] Vorzugsweise wird das Analysegerät 2 durch einen Impuls, ein Signal oder einem Befehl von der Ba-

sisstation 3 aus seinem "Ruhezustand" in einen "aktiven Zustand" versetzt. Der Ruhezustand ist ein Energiesparmodus oder ein Modus mit verringerter Sendeleistung. Dadurch wird zum einen die Strahlenbelastung des Patienten, der das Analysegerät 2 trägt, reduziert; zum anderen wird Energie gespart.

[0038] Figur 2 zeigt in dem Analysegerät 2 gespeicherte Messwerte. Dabei ist die Gesamtheit aller diskreten Messwerte dargestellt, die in äquidistanten Zeitabschnitten gemessen worden sind.

[0039] Da bevorzugt die zu übertragenen Messwerte als erste Teilmenge bereits vor Aufbau der Datenübertragung selektiert sind, kann beim Bestehen einer Kommunikationsverbindung sofort mit der Datenübertragung zwischen dem Analysegerät 2 und der Basisstation 3 begonnen werden. Während der Datenübertragung arbeitet vorzugsweise das Analysegerät 2 als Master und die Basisstation als Slave. Beispielsweise kann der jüngste gemessene Messwert A aus der ersten Teilmenge zuerst übertragen werden. Möglich ist auch, einen anderen Wert aus der ersten Teilmenge als ersten Wert zu übertragen, beispielsweise einen als auffällig detektierten Messwert. Liegt kein Kriterium vor, aufgrund dessen ein Messwert wegen seines erhöhten Informationsgehaltes zuerst übermittelt wird, so wird der jüngste gemessene Messwert verwendet.

[0040] Nach der Übertragung des ersten Messwertes kann die Basisstation 3 optional ein Signal ausgeben, um dem Patienten mitzuteilen, dass ein Wert übertragen wurde. Bevorzugt kann der Patient selbst einstellen, ob eine Meldung der Basisstation 3 erfolgen soll. Falls eine derartige Rückmeldung gewünscht ist, kann sie entweder nach der Übertragung des ersten und/oder jedes weiteren Messwertes oder am Ende der durchgeführten Datenübertragung erfolgen.

[0041] Bricht die Kommunikationsverbindung nach dem Übertragen des ersten bzw. während der Übertragung der weiteren Werte ab, so wird das während der Datenübertragung als Master arbeitende Analysegerät 2 wieder zum Slave und fällt nach einer optionale Wartezeit wieder in seinen Ruhezustand zurück. Die Basisstation 3 wird wieder zum Master, so dass das Analysegerät 2 und die Basisstation 3 stets zwischen der Funktion des Masters und des Slaves hin- und herschalten.

[0042] Wurde die erste Teilmenge der selektierten Messwerte vollständig übertragen, so kann ein Bestätigungssignal zwischen dem Analysegerät 2 und der Basisstation 3 ausgetauscht werden. Die Basisstation 3 kann daraufhin weitere Messwerte von dem Analysegerät 2 anfordern. Alternativ kann das Analysegerät 2 auch so lange weitere Messwerte übertragen, bis die Gesamtheit der in ihrem Speicher befindlichen Messwerte an die Basisstation 3 übermittelt worden ist.

[0043] Bei der Selektion der ersten Teilmenge der Messwerte ist zu beachten, dass die Gesamtdauer der Kommunikationsverbindung stets unbekannt ist und mit einem vorzeitigen Abbruch jederzeit gerechnet werden muss. Die Selektion richtet sich deshalb vorzugsweise

nach für eine medizinische Beurteilung notwendigen Anforderungen. Aus diesem Grund sind häufig die unmittelbar vor der Datenübertragung gemessenen Werte von Interesse. Bei der Ermittlung eines auffälligen Wertes, der über einem medizinisch festgelegten Grenzwert oder außerhalb eines Toleranzbandes liegt, wird dieser Wert bevorzugt übertragen. Das Toleranzband ist in dem System vorgegeben und kann vorzugsweise verändert werden, beispielsweise durch medizinisches Personal. Eine Veränderung durch die Patienten selbst ist in der Regel nicht gewünscht, aber möglich.

[0044] Die Selektion weiterer Messwerte kann in Abhängigkeit von einem bereits ausgewählten Messwert getroffen werden. Vorteilhaft ist diese abhängige Auswahl insbesondere, wenn der ausgewählte Wert als auffällig charakterisiert wird. Bevorzugt werden innerhalb eines Intervalls um einen auffälligen Messwert, der außerhalb eines vorgegebenen Toleranzbandes liegt, die weiteren Messwerte mit einem festen zeitlichen Raster selektiert. Besonders bevorzugt werden alle Messwerte innerhalb eines Intervalls um den auffälligen Messwert ausgewählt.

[0045] In Figur 3 werden die Messwerte A und A' als auffällige Werte erachtet, da sie oberhalb einer medizinisch indizierten Grenze liegen. Daraufhin wird das Intervall B ausgewählt, in dem die gestrichelt dargestellten Messwerte B1 bis B4 selektiert werden. Die äquidistante Auswahl der Messwerte im Intervall B vermittelt einen Überblick über den Werteverlauf in diesem Zeitraum und ermöglicht einen Anstieg oder einen Abfall zu dem auffälligen Wert A, A' hin zu erkennen. Auch hier könnte die Datenübertragung mit dem jüngsten Wert beginnen und so lange fortgesetzt werden, wie die Kommunikationsverbindung Bestand hat.

[0046] Um einen erweiterten Überblick zu erhalten, wird im Anschluß an das Intervall B ein weiteres Intervall C festgelegt, in dem ebenfalls Werte mit äquidistantem Raster selektiert werden. Hierdurch wird der Überblick über die Gesamtheit der Werte erweitert. Ein derartiges Vorgehen ist in Figur 4 dargestellt.

[0047] Vorteilhafterweise wird die Gesamtheit der in dem Speicher gespeicherten Messwerte in mehrere Intervalle unterteilt, wobei die erste Teilmenge aus Messwerten der Intervalle zusammengesetzt wird. Dabei werden die Messwerte derartig mit einer unterschiedlichen Dichte aus den Intervallen selektiert, dass eine Gewichtung der Intervalle erreicht wird. Die Auswahl von Messwerten mit einer unterschiedlichen Gewichtung aus verschiedenen Intervallen ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn aus der Historie bekannt ist, dass in bestimmten Zeitintervallen häufiger auffällige Messwerte auftreten können. Aus diesen Intervallen wird dann eine relativ höhere Dichte an Messwerten selektiert, als aus anderen Intervallen, die sich in der Vergangenheit als eher unkritisch erwiesen haben.

[0048] Beispielsweise kann die Gesamtheit der gespeicherten Messwerte in zwei Intervalle unterteilt werden, wobei die Messwerte des ersten Intervalls jünger

sind als die Messwerte des zweiten Intervalls. Die erste Teilmenge wird derart selektiert, dass die Dichte der aus dem ersten Intervall selektierten Messwerte größer ist als die Dichte der aus dem zweiten Intervall selektierten Messwerte. Hierdurch wird berücksichtigt, dass in der Regel die jüngeren Messwerte einen höheren Informationsgehalt enthalten. Insbesondere wenn die Messwerte dazu dienen, die Insulinabgabe zu dosieren, sind die jüngeren Messwerte von größerem Interesse als weiter zurückliegende Messwerte.

[0049] Die Aufteilung der Gesamtheit der gespeicherten Messwerte in zwei Intervalle ist in Figur 5 dargestellt. Das Intervall B umfasst eine erste Anzahl jüngerer Messwerte. Die im Intervall B zusammengefassten Messwerte spiegeln im dargestellten Beispiel etwa 15 Prozent der Gesamtheit der Messwerte wider. Aus diesen 15 Prozent werden die vier Messwerte B1 bis B4 selektiert. Das Intervall D umfasst die verbleibenden 85 Prozent der Messwerte. Aus diesem Intervall werden insgesamt 9 gestrichelt dargestellte Messwerte selektiert. Die absolute Anzahl der aus dem Intervall D ausgewählten Messwerte ist zwar größer als die Anzahl der Messwerte aus dem Intervall B; dennoch ist die Messwertdichte der selektierten Werte aus dem Intervall B höher.

[0050] Figur 5 zeigt, dass im Intervall B die Messwerte mit einem konstanten Raster selektiert werden, während im Intervall D die Messwerte mit einem Raster ausgewählt werden, das auf einer Wahrscheinlichkeitsfunktion beruht. Die zeitlichen Abstände der ausgewählten Messwerte sind hier nicht äquidistant.

[0051] In Figur 6 ist der Fall gezeigt, dass bei einer Einteilung der Gesamtheit der Messwerte in zwei Intervalle B,E im zweiten Intervall E zwei Messwerte E1 und E2 ausgewählt wurden, die als auffällig charakterisiert werden, da sie außerhalb eines Toleranzbandes liegen. Obwohl die Selektion der Messwerte im Intervall E mit einem variablen Raster erfolgt, wird nach Detektion der Auffälligkeit der Messwerte E1 und E2 die Auswahlstrategie derart verändert, dass um die auffälligen Messwerte E1, E2 je ein Intervall E1' und E2' gebildet wird, in dem die Messwerte mit einem konstanten Raster selektiert werden. Im vorliegenden Fall werden dabei alle Messwerte innerhalb des Intervalls E1' und E2' ausgewählt. Somit kann das Analysesystem sehr flexibel auf auffällige Messwerte reagieren. Der hohe Informationsgehalt, der den auffälligen Werten und den zu ihnen benachbarten Werten zugrunde liegt, wird bei der Selektion der ersten Teilmenge berücksichtigt. Die selektierten Messwerte der ersten Teilmenge bilden damit die Gesamtheit der Messwerte hinreichend genau ab, um aus der ersten Teilmenge der Messwerte bereits eine Aussage über alle Messwerte zu machen, beispielsweise um den Gesundheitszustand des Patienten oder den Systemzustand einer Insulinpumpe beurteilen zu können.

Patentansprüche

1. Diabetescare-System mit einer mobilen Komponente (2) und einer Basisstation (3), wobei die mobile Komponente (2) am Körper tragbar oder in den Körper implantierbar ist, und einen Speicher (7) zum Speichern von Daten, und eine Kommunikationseinheit (5) zur Übertragung von Daten an die Basisstation (3) einschließt, die Basisstation (3) eine Kommunikationseinheit (8) zum drahtlosen Empfangen von Daten von der mobilen Komponente und eine Speichereinheit (9) zum Abspeichern von übertragenen Daten und optional eine Ausgabereinheit (10) zur Anzeige von von der mobilen Komponente übertragenen Daten aufweist, und eine Datenübertragung zwischen der mobilen Komponente (2) und der Basisstation (3) innerhalb einer Zeitspanne stattfindet, in der eine drahtlose Kommunikationsverbindung besteht, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Datenübertragung derartig selektiv durchgeführt wird, dass innerhalb einer ersten Zeitspanne, in der eine drahtlose Kommunikationsverbindung besteht, eine erste Teilmenge der Daten von der mobilen Komponente (2) an die Basisstation (3) übertragen wird, wobei die erste Teilmenge mittels eines prozessorgesteuerten Selektionsalgorithmus derartig selektiert wird, dass die in der ersten Zeitspanne übertragenen Daten für die Gesamtheit der in der mobilen Komponente (2) abgespeicherten Daten repräsentativ ist.
2. Diabetescare-System nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die erste Teilmenge der Daten vor Beginn der Datenübertragung selektiert wird.
3. Diabetescare-System nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die erste Teilmenge der Daten mittels eines Selektionsalgorithmus selektiert wird, der von einem Prozessor (6) der mobilen Komponente (2) gesteuert wird.
4. Diabetescare-System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** mindestens ein Teil der ersten Teilmenge der Daten in einer Reihenfolge, die umgekehrt zu der Reihenfolge ihrer Erzeugung ist, an die Basisstation (3) übertragen wird.
5. Diabetescare-System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die erste Teilmenge der Daten in einem festen zeitlichen Raster so selektiert wird, dass der zeitliche

Abstand zwischen benachbarten selektierten Daten äquidistant ist.

6. Diabetescare-System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die erste Teilmenge der Daten mittels eines Selektionsalgorithmus, in dem eine Wahrscheinlichkeitsfunktion implementiert ist, so selektiert wird, dass der zeitliche Abstand zwischen benachbarten selektierten Daten verschieden ist.
7. Diabetescare-System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Gesamtheit der in dem Speicher (7) gespeicherten Daten in mehrere Intervalle unterteilt wird und die erste Teilmenge derart aus Daten der Intervalle zusammengesetzt wird, dass aus den Intervallen die Daten mit unterschiedlicher Dichte dergestalt selektiert werden, dass die Intervalle unterschiedlich gewichtet werden.
8. Diabetescare-System nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Gesamtheit der gespeicherten Daten in mindestens zwei Intervalle unterteilt wird, wobei die Daten eines ersten Intervalls jünger sind als die Daten eines zweiten Intervalls sind, und die erste Teilmenge derart selektiert wird, dass die Dichte der aus dem ersten Intervall selektierten Daten größer ist als die Dichte der aus dem zweiten Intervall selektierten Daten.
9. Diabetescare-System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Auswahl weiterer Daten in Abhängigkeit von einem Datenwert bereits ausgewählter Daten getroffen wird.
10. Diabetescare-System nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** innerhalb eines Zeitintervalls um Daten mit einem auffälligen Datenwert, der außerhalb eines vorgegebenen, vorzugsweise veränderbaren, Toleranzbandes liegt, weitere Daten, vorzugsweise alle Daten innerhalb des Zeitintervalls, selektiert werden.
11. Diabetescare-System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die voraussichtliche Anzahl der Daten der ersten Teilmenge und/oder die voraussichtliche Dauer der ersten Zeitspanne für eine Datenübertragung aus bereits durchgeführten Datenübertragungen zwischen der mobilen Komponente (2) und der Basisstation (3) ermittelt wird.
12. Diabetescare-System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** an der Basisstation (3) eine Meldeeinrichtung (11) vorgesehen sind, um eine optische und/oder akustische Warnmeldung auszugeben, wenn die Anzahl der übertragenen Daten eine untere Grenze unterschreitet.

Abstand zwischen benachbarten selektierten Daten äquidistant ist.

13. Diabetescare-System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Anzahl der Daten der ersten Teilmenge, die von der mobilen Komponente (2) an die Basisstation (3) übertragen worden ist, in der mobilen Komponente (2) und/oder in der Basisstation (3) registriert wird.
14. Diabetescare-System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** übertragene Daten aus dem Speicher (7) der mobilen Komponente (2) gelöscht werden.
15. Diabetescare-System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** es als Analysesystem zur Detektion eines Analyten in einem menschlichen Körper ausgebildet ist und eine mobile Komponente aufweist, welches eine Messeinheit zur Detektion des Analyten und Erzeugung von für die Analyse charakteristischen Daten einschließt.
16. Verfahren zur selektiven Datenübertragung innerhalb eines Diabetescare-Systems mit einer mobilen Komponente (2) und einer Basisstation (3), wobei die mobile Komponente (2) am Körper tragbar oder in den Körper implantierbar ist, und einen Speicher (7) zum Speichern von Daten, und eine Kommunikationseinheit (5) zur Übertragung von Daten an die Basisstation (3) einschließt, die Basisstation (3) eine Kommunikationseinheit (8) zum drahtlosen Empfangen von Daten von der mobilen Komponente (2) und eine Speichereinheit (9) zum Abspeichern von übertragenen Daten und optional eine Ausgabereinheit (10) zur Anzeige von von der mobilen Komponente (2) übertragenen Daten aufweist, und eine Datenübertragung zwischen der mobilen Komponente (2) und der Basisstation (3) innerhalb einer Zeitspanne stattfindet, in der eine drahtlose Kommunikationsverbindung besteht, **gekennzeichnet durch** selektives Durchführen einer Datenübertragung mit den folgenden Schritten:

 Selektieren einer ersten Teilmenge der Daten mittels eines prozessorgesteuerten Selektionsalgorithmus;
 Übertragen der ersten Teilmenge der Daten von der mobilen Komponente (2) an die Basisstation (3) innerhalb einer ersten Zeitspanne, in der eine

drahtlose Kommunikationsverbindung besteht,

wobei die erste Teilmenge derart selektiert wird,
dass die in der ersten Zeitspanne übertragenen Da-
ten für die Gesamtheit der in der mobilen Kompo-
nente (2) abgespeicherten Daten repräsentativ ist.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

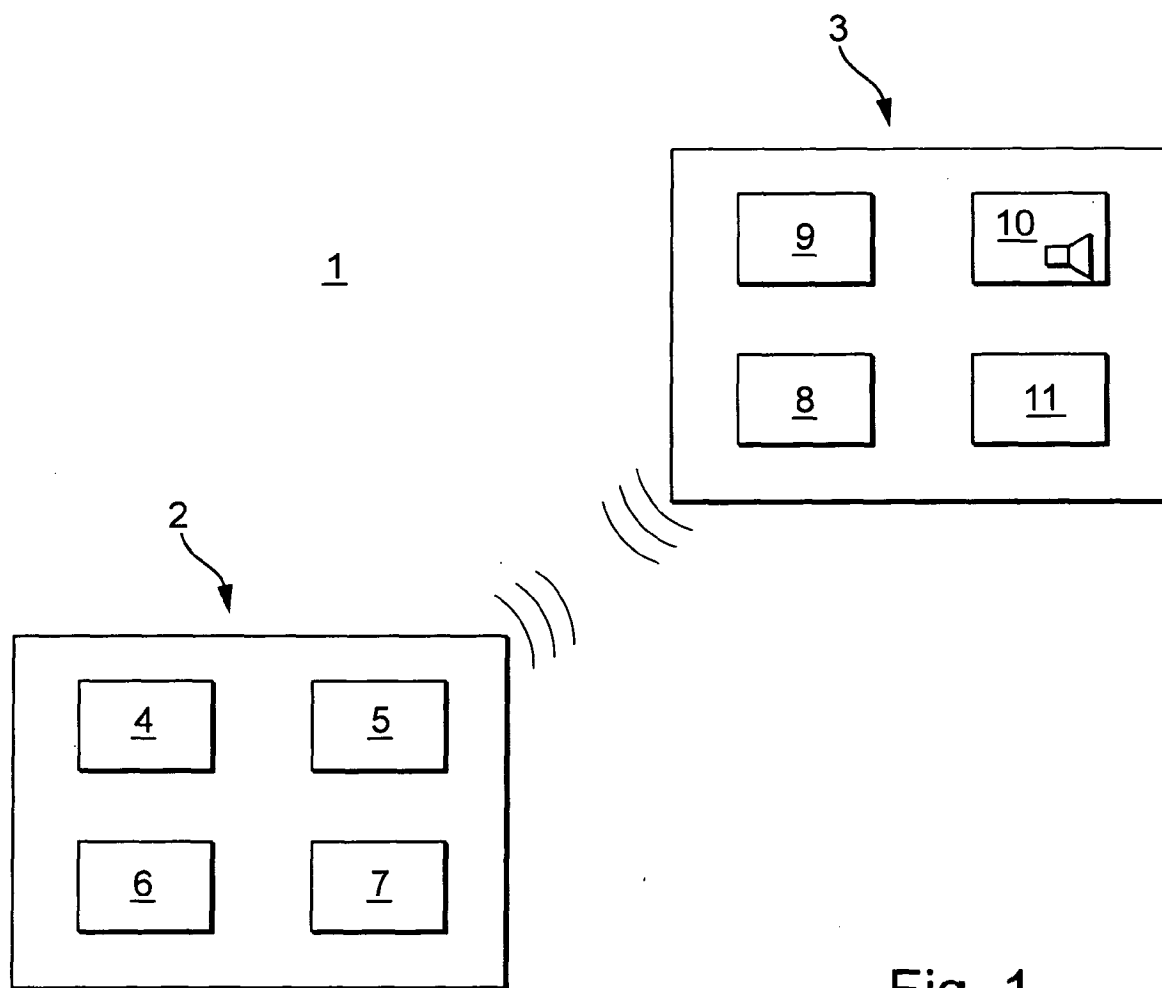


Fig. 1

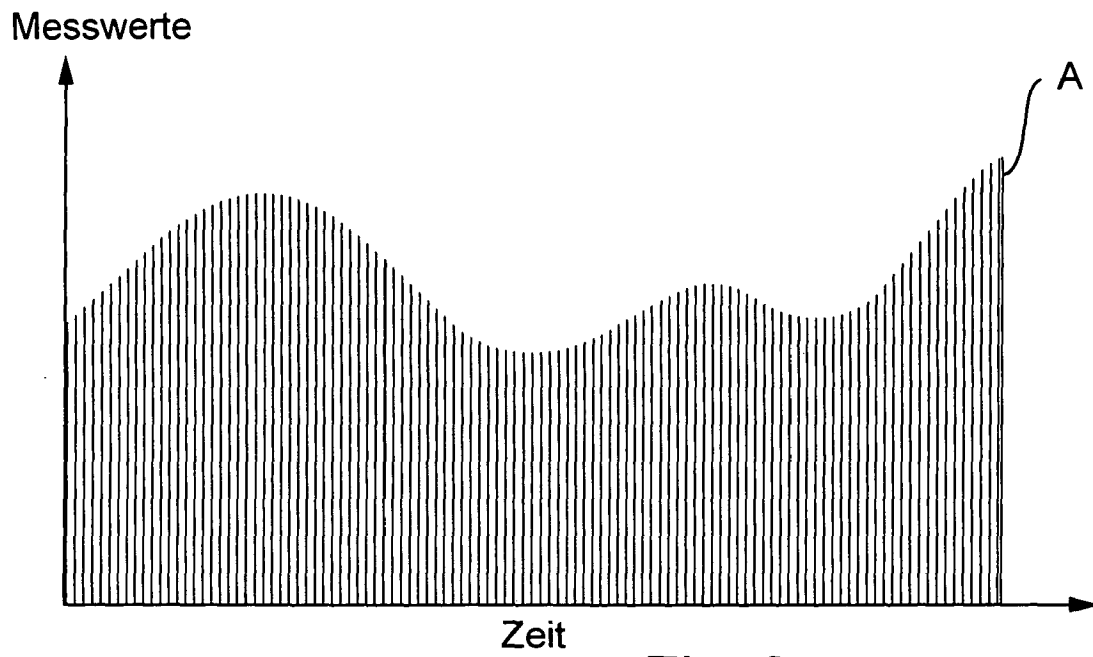


Fig. 2

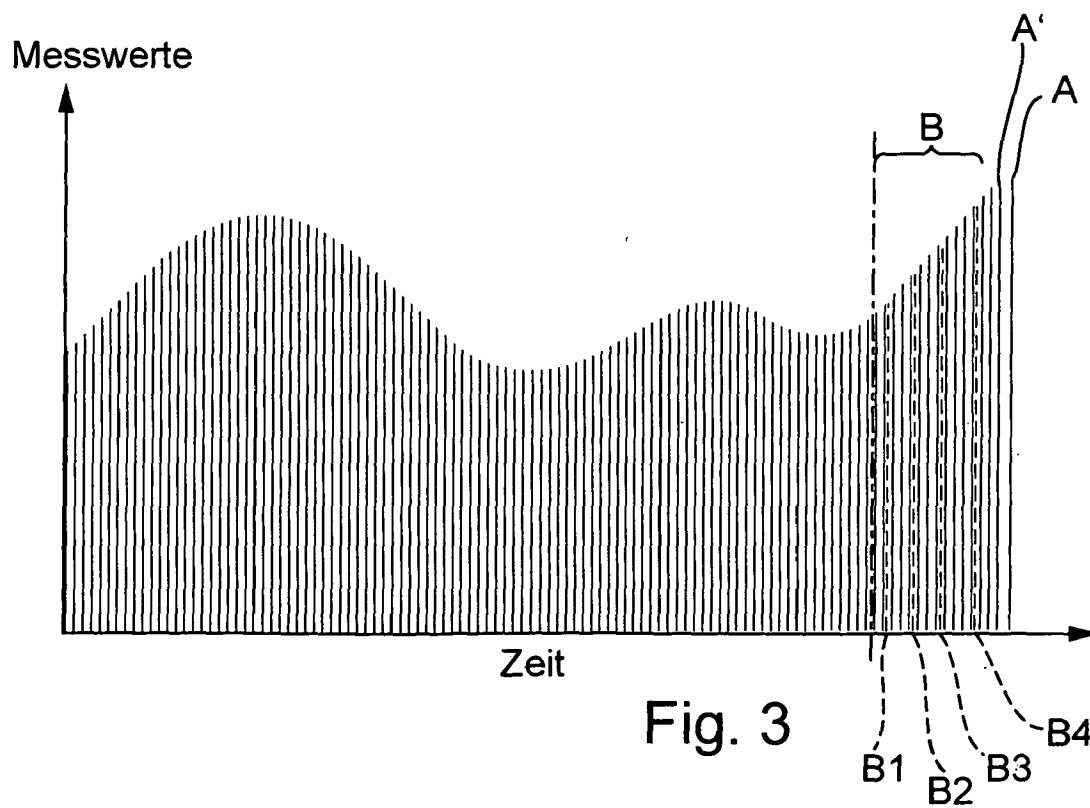


Fig. 3

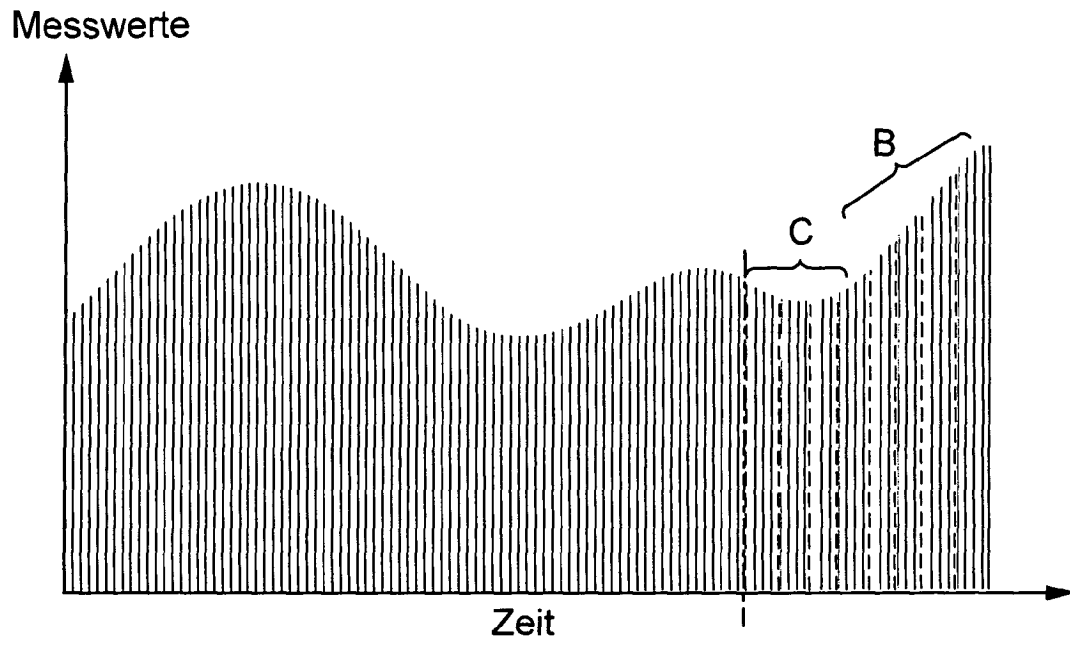


Fig. 4

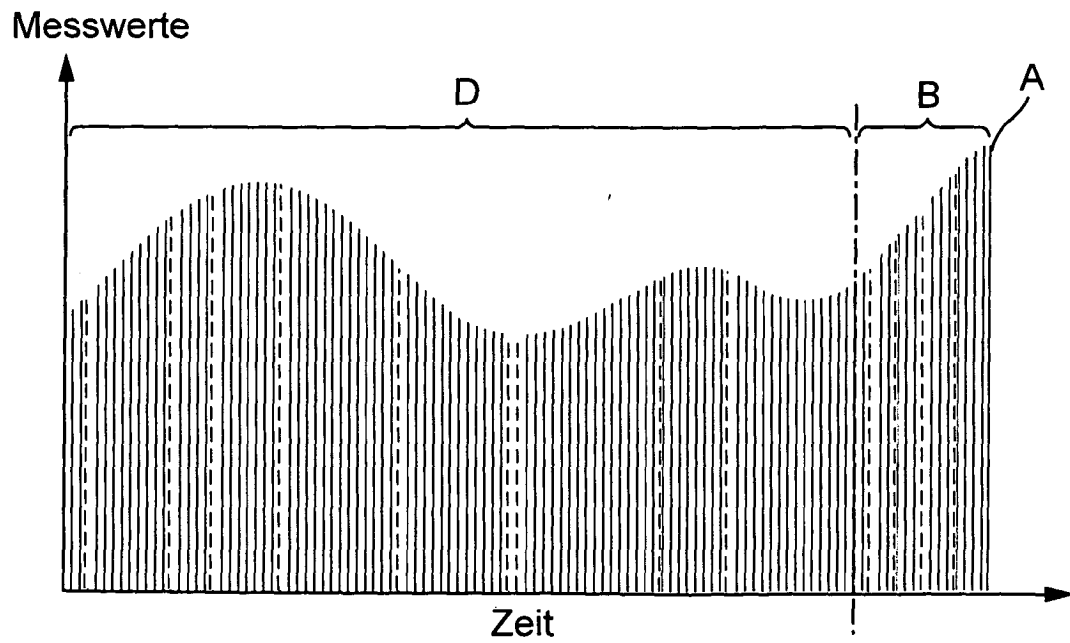


Fig. 5

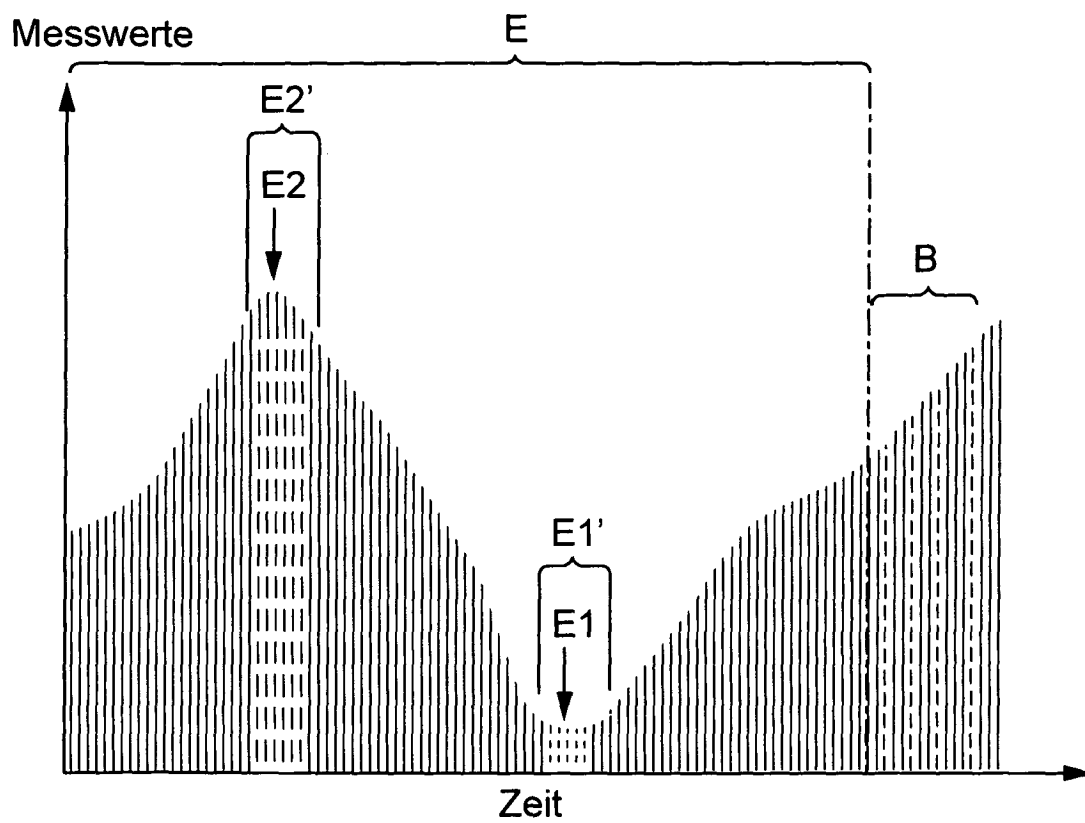


Fig. 6



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 06 01 2693

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	US 2006/122469 A1 (MARTEL NORMAND M [US]) 8. Juni 2006 (2006-06-08) * Absätze [0030], [0034], [0045] * * Abbildung 1 *	1-16	INV. A61B5/00 A61N1/08 G06F13/22 H04L12/28
A	US 2004/215270 A1 (RITSCHER DAVID E [US] ET AL) 28. Oktober 2004 (2004-10-28) * Zusammenfassung * * Absatz [0057] *	1-16	
A	US 2004/122488 A1 (MAZAR SCOTT T [US] ET AL) 24. Juni 2004 (2004-06-24) * Zusammenfassung * * Absätze [0065], [0086] *	1-16	
A	US 2001/027384 A1 (SCHULZE ARTHUR E [US] ET AL) 4. Oktober 2001 (2001-10-04) * Zusammenfassung *	1-16	
A	US 5 564 429 A (BORN ROBERT [US] ET AL) 15. Oktober 1996 (1996-10-15) * Zusammenfassung * * Spalte 37, Zeile 63 *	1-4, 14-16	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) A61B G06F A61N H04L
A	EP 1 437 674 A2 (NOVO NORDISK AS [DK]) 14. Juli 2004 (2004-07-14) * Zusammenfassung * * Absatz [0028] *	1,16	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 24. November 2006	Prüfer Schwenke, Stephanie
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

1
EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 06 01 2693

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

24-11-2006

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2006122469	A1	08-06-2006	KEINE	
US 2004215270	A1	28-10-2004	KEINE	
US 2004122488	A1	24-06-2004	KEINE	
US 2001027384	A1	04-10-2001	US 6443890 B1 US 2002019584 A1	03-09-2002 14-02-2002
US 5564429	A	15-10-1996	KEINE	
EP 1437674	A2	14-07-2004	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

专利名称(译)	用于分析物检测的糖尿病护理系统和选择性地传输优先数据的方法。		
公开(公告)号	EP1870026A1	公开(公告)日	2007-12-26
申请号	EP2006012693	申请日	2006-06-21
[标]申请(专利权)人(译)	罗氏诊断公司		
申请(专利权)人(译)	罗氏诊断有限公司 F.HOFFMANN-LA ROCHE AG		
当前申请(专利权)人(译)	罗氏诊断有限公司 F.HOFFMANN-LA ROCHE AG		
[标]发明人	RASCH MENGES JUERGEN DR JANSEN PAUL HAAR HANS PETER DR HAUETER ULRICH POREDDA ANDREAS DR		
发明人	RASCH-MENGES, JUERGEN, DR. JANSEN, PAUL HAAR, HANS-PETER, DR. HAUETER, ULRICH POREDDA, ANDREAS, DR.		
IPC分类号	A61B5/00 A61N1/08 G06F13/22 H04L12/28		
CPC分类号	A61B5/0002 A61B5/14532 G01N33/48792 H04L67/14 H04L69/04 A61N1/37276		
其他公开文献	EP1870026B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

该系统具有分析设备(2)和基站(3)，其中分析设备和基站之间的数据传输在一段时间内发生，其中存在无线通信连接。选择性地实现数据传输，使得在一段时间内从分析设备向基站发送部分数据量。通过处理器控制的选择算法选择部分数据量，使得在该时间内发送的数据代表存储在设备中的整个数据。对于在糖尿病护理系统内进行选择性数据传输的方法，还包括独立权利要求。

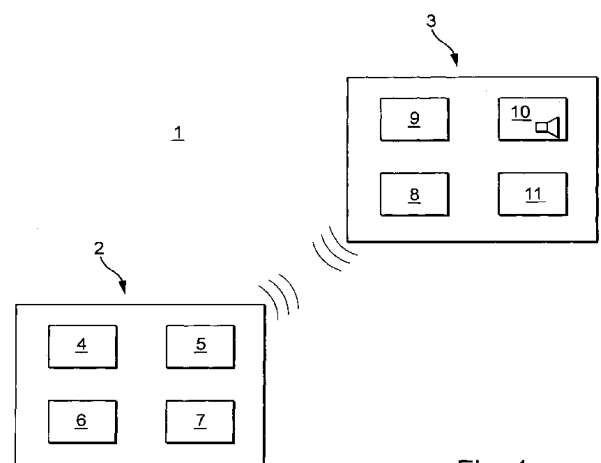


Fig. 1