



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103841898 A

(43) 申请公布日 2014. 06. 04

(21) 申请号 201280047540. 4

代理人 王英 刘炳胜

(22) 申请日 2012. 09. 14

(51) Int. Cl.

(30) 优先权数据

61/541, 369 2011. 09. 30 US

A61B 8/06 (2006. 01)

G01S 7/52 (2006. 01)

G01S 15/58 (2006. 01)

G01S 15/89 (2006. 01)

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2014. 03. 28

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/IB2012/054812 2012. 09. 14

(87) PCT国际申请的公布数据

W02013/046089 EN 2013. 04. 04

(71) 申请人 皇家飞利浦有限公司

地址 荷兰艾恩德霍芬

(72) 发明人 A·萨阿德 T·卢帕斯 D·赫尔

S·J·希尔

(74) 专利代理机构 永新专利商标代理有限公司

72002


权利要求书2页 说明书5页 附图11页

(54) 发明名称

具有随样本体积移动的自动动态多普勒流设置的超声系统

(57) 摘要

一种超声系统, 执行双功能彩色流与频谱多普勒成像, 其中在所述彩色流图像上所示的样本体积位置执行频谱多普勒探测。所述彩色流图像被显示在叠加在共配准的 B 模式图像上的彩色框中。彩色框位置与转向角度处理器分析空间多普勒数据, 并自动地针对最佳多普勒灵敏度和准确度来设置所述彩色框在血管上的角度和位置。所述处理器也可以自动地设置流角度校正指针与流方向对齐。在优选的实施例中, 随着用户为了多普勒测量而在沿所述血管的长度的点暂停, 自动地并连续地进行这些优化调整。

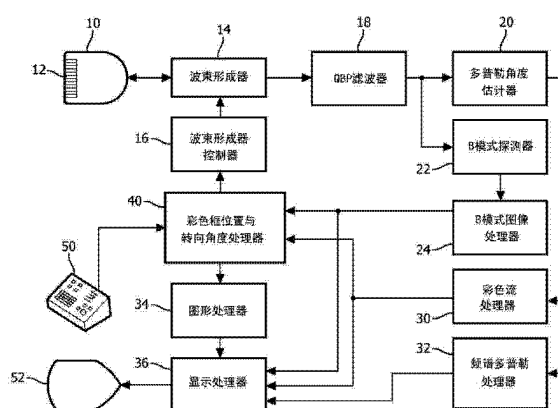

1. 一种超声诊断成像系统,其产生针对选自彩色流图像的解剖位置的流的频谱多普勒显示,包括:

超声换能器阵列探头,其发射波束并接收来自受试者中存在流的区域的回波信号;

波束形成器,其控制由所述探头发射波束的方向;

多普勒处理器,其响应于所述回波信号而产生彩色流多普勒图像和频谱多普勒图像;

显示器,在所述显示器上同时显示所述彩色流多普勒图像和所述频谱多普勒图像;

用户控制器,其能够由用户操纵,以在所述彩色流多普勒图像的彩色框中示出的血管中指示要进行频谱多普勒测量的多个位置;以及

彩色框位置与转向角度处理器,其响应于多普勒信号而在所述用户操纵所述控制器从一个指示位置到另一个指示位置时自动地确定最佳的彩色框位置。

2. 如权利要求1所述的超声诊断成像系统,还包括用户流控制器,所述用户流控制器能够由用户操作以打开或关闭所述彩色框位置与转向角度处理器的自动操作。

3. 如权利要求2所述的超声诊断成像系统,还包括用户配置控制器,所述用户配置控制器能够由用户操作以确定当所述彩色框位置与转向角度处理器被打开时要被自动化的功能。

4. 如权利要求2所述的超声诊断成像系统,其中,被用于指示多个位置的所述用户控制器还能够操作用于在所述图像上移动样本体积指针;并且还包括用户控制器,其能够操作用于每当所述用户暂停所述样本体积指针的移动时令所述彩色框位置与转向角度处理器自动确定最佳的彩色框位置。

5. 如权利要求1所述的超声诊断成像系统,其中,所述彩色框位置与转向角度处理器通过确定所述彩色框的角度来自动确定所述彩色框位置。

6. 如权利要求5所述的超声诊断成像系统,其中,所述彩色框位置与转向角度处理器还能够操作用于将所述多普勒转向角度线的角度自动确定为与所确定的所述彩色框的角度一致。

7. 如权利要求6所述的超声诊断成像系统,其中,所述彩色框位置与转向角度处理器被耦合到所述波束形成器,以控制多普勒波束发射的角度与所确定的多普勒转向角度线一致。

8. 如权利要求1所述的超声诊断成像系统,其中,所述彩色框位置与转向角度处理器通过确定相对于超声图像中的血管的位置的所述彩色框位置来自动确定所述彩色框位置。

9. 如权利要求1所述的超声诊断成像系统,其中,所述彩色框位置与转向角度处理器通过确定相对于超声图像中多普勒样本体积的位置的所述彩色框位置来自动确定所述彩色框位置。

10. 如权利要求1所述的超声诊断成像系统,其中,所述彩色框位置与转向角度处理器还能够操作用于自动设置流方向指针的取向,

其中,彩色框的角度是考虑所述流方向指针的取向而设置的。

11. 如权利要求1所述的超声诊断成像系统,还包括图形处理器,所述图形处理器响应于所述彩色框位置与转向角度处理器而在超声图像上以图形方式描绘彩色框的所述位置。

12. 如权利要求11所述的超声诊断成像系统,其中,所述图形处理器还能够操作用于在超声图像上以图形方式描绘多普勒样本体积图形的位置和多普勒转向角度线。

13. 如权利要求 1 所述的超声诊断成像系统,还包括 B 模式处理器,所述 B 模式处理器响应于所述回波信号而产生 B 模式图像,

其中,所述彩色流多普勒图像与所述 B 模式图像空间配准地显示在所述彩色框中。

14. 如权利要求 1 所述的超声诊断成像系统,其中,所述彩色框位置与转向角度处理器还响应于来自血管的多普勒信号而确定所述血管的流的质心。

15. 如权利要求 14 所述的超声诊断成像系统,其中,所述彩色框位置与转向角度处理器还能够操作用于将所述彩色框的所述位置定位为以所确定的所述血管的流的质心为中心。

具有随样本体积移动的自动动态多普勒流设置的超声系统

技术领域

[0001] 本发明涉及超声诊断成像系统,并且尤其涉及带有自动多普勒流设置的超声系统。

背景技术

[0002] 超声成像系统可在 B 模式操作用于组织成像,以及在多普勒模式操作用于流分析与成像。典型的多普勒模式包括用于组织运动和流成像两者的功率多普勒模式,用于定性流成像的彩色流多普勒,以及用于流定量的频谱多普勒。多普勒可以在一维(M 模式和频谱多普勒)、二维成像以及三维成像中执行。

[0003] 当前的诊断超声系统为用户操纵提供若干采集控制,以实现最佳图像品质来帮助患者诊断。在血管检查期间,用户频繁使用所述彩色流多普勒成像模式,以评估和诊断血管。用户频繁操纵彩色框位置以使其以感兴趣血管为中心,并操纵多普勒样本体积以将其定位在感兴趣血管位点上,以在人体的特定位置采集频谱多普勒波形。用户也操纵多普勒角度校正,以使流方向指针与血管取向对齐。已提出建议使流角度指针在血管的血流上的放置自动化,如美国专利 6464637 (Criton 等人)、W096/17549 (Goujon)、美国专利 6068598 (Pan 等人),以及美国专利 6176830 (Freiburger)所示。Freiburger 也讨论了基于在图像中探测到的最大速度的位置来自动放置对多普勒样本体积;基于最大探测频移来设置脉冲重复频率(PRF);以及基于彩色流数据的幅度自动设置增益。美国专利 6126605 (Washburn 等人)通过使用直方图并对彩色流数据取样来自动调节针对多普勒图像的阈值和数据压缩,并且美国专利 6322509 (Pan 等人)基于血管的图像数据,调节多普勒样本体积位置和大小。W003/19227 (Christopher 等人)描述了基于频谱多普勒与彩色流多普勒信息,自动设置对频谱多普勒和彩色流多普勒的显示。

[0004] 为了获得针对相同患者的多次检查一致的速度测量,或者为了比较不同患者的测量结果,用户尝试维持固定的多普勒角度——在相对于流的方向的该角度发射多普勒波束,并且实现该目标有两种方法。一种方法是固定图像上的角度校正指针,并且脚跟脚尖操纵换能器,以使血管与角度线对齐。另一种方法是依赖提供如下特征的超声系统,所述特征即在用户每次改变角度校正时调节波束转向角度以实现固定的多普勒角度。然而,角度校正仍是手动完成的。需要的是这样一种超声系统,其基于图像中血管的特性,自动地调节波束转向角度以及在其中执行多普勒探测的彩色框,并且每当超声医师将样本体积移动到新的位置以进行频谱多普勒测量时就自动地这么做。

发明内容

[0005] 根据本发明的原理,描述一种诊断超声系统,其使用血管分割以及流图像分析,使彩色框放置、多普勒样本体积放置、角度校正以及波束转向角度自动化。在优选的实施例中,在每次用户指示血管中的点用于流量分析时,执行所述自动化,无需调节任何用户控制。每次所述用户指示新的位置用于诊断时,自动地确定和设置最佳超声发射与察看参数,

消除了在其他情况中针对每个新的感兴趣位点的每次选择所需要的耗时且繁琐的调节。减少了因重复控制操纵造成的人体工学相关的损伤,尤其是在扫描长血管(例如颈动脉和下肢动脉)时。

附图说明

[0006] 在附图中:

[0007] 图 1 以框图的形式图示了根据本发明的原理构建的诊断超声系统。

[0008] 图 2 的流程图图示了图 1 的彩色框位置与转向角度处理器的操作。

[0009] 图 3a 和图 3b 图示了对血管的血流图像的分割与分析。

[0010] 图 3c 和图 3d 图示了根据本发明的原理对彩色框的自动重新定位。

[0011] 图 4 至图 7 为图示本发明的实现方式的超声系统显示的序列。

[0012] 图 8 为超声系统显示,其图示了根据本发明的原理用于自动流跟踪的控制。

[0013] 图 9 和图 10 为超声系统显示,其示出了无需用户干预而在超声检查期间自动跟踪样本体积、彩色框放置以及角度校正。

具体实施方式

[0014] 首先参考图 1,以框图形式示出了根据本发明的原理构建的超声系统。超声探头 10 包含换能器元件的换能器阵列 12,所述换能器元件将超声波发射到人体并接收返回的回波信号。所发射的波在波束或扫描线中被导向,以探询所述人体中的感兴趣区域。可以使用一维阵列以在单一平面发射波束用于二维成像,或者可以使用换能器元件的二维阵列以在所述人体的体积区域上发射波束用于三维成像。可以由所述探头在不同方向中操纵并聚焦所述波束,以在特定位置或特定方向的血流中探询组织,如下文更全面地解释。由波束形成控制器 16 来提供对发射和接收时波束的控制和处理,波束形成控制器 16 控制被连接到换能器阵列 12 的元件的波束形成器 14,以发射适当成形的波束,并通过延迟和加合成相干回波信号使所接收的信号形成波束。波束形成器可以控制换能器阵列,以例如在期望的图像平面上扫描波束,以及在所述图像平面的面积上重复扫描波束,要在该面积中评估血流处于适合在人体的该区域中存在的血流速度的 PRF。

[0015] 正交带通滤波器 18 将所述回波信号处理成正交的 I 和 Q 分量。所述正交分量被多普勒角度估计器用于估计多普勒信号在要执行多普勒探询的点处的相移或频移。B 模式探测器使用所述 I 和 Q 分量,以通过取所述 I 和 Q 分量的和的平方根来执行对组织图像的 B 模式探测。在空间基础上处理探测到的回波强度,以形成所述人体中的所述组织的二维或三维图像,该图像被图像处理器 36 处理用于显示,并被显示在显示屏 52 上。

[0016] 可以直接将由多普勒角度估计器 20 产生的图像平面中的位置处的多普勒频率映射到在那些位置处的速度值。该多普勒数据被耦合到彩色流处理器 30,其将所述数据空间处理成二维或三维图像格式,在其中所述速度值被彩色编码。由显示处理器 36 将该多普勒彩色图叠加在空间对应的 B 模式图像上,以通过色彩编码来图示在解剖结构中流发生处的位置以及该流的速度和方向。通过样本体积在所述图像中的特定点的放置而选择的、来自所述图像中的该位置的多普勒数据,被耦合到频谱多普勒处理器 32,其产生该点处的流速度随时间的变化与分布的频谱显示。所述频谱多普勒显示被转发到显示处理器 36,用于在

显示屏 52 上的频谱多普勒显示的处理和显示。

[0017] 根据本发明的原理,来自彩色流处理器 30 的彩色流数据,以及优选地,来自 B 模式处理器 34 的 B 模式数据,被耦合到彩色框位置与转向角度处理器 40。彩色框位置与转向角度处理器控制对所述彩色流图像的设置和特征的自动化,包括:正确地定位所述彩色框、设置多普勒波束的多普勒角度、在所述图像中定位所述样本体积以及正确地定位对流角度指针。在对所述多普勒角度的控制方面,所述彩色框位置与转向角度处理器被耦合到波束形成控制器 16 以控制所述多普勒波束方向。由所述彩色框位置与转向角度处理器提供的对所述自动化的设置与控制,是通过在用户控制面板 50 上对控制的设置而提供的。由图形处理器 34 提供由所述彩色框位置与转向角度处理器控制的功能的图形显示,例如所述彩色框的轮廓线和所述流角度指针,图形处理器 34 被耦合到显示处理器 36 以将所述图形叠加在所述超声图像上。

[0018] 由图 2 的流程图示出了彩色框位置与转向角度处理器 40 的操作。过程中的第一个步骤 102 是在超声图像中在空间上分割所述流。这可以通过用蒙板遮盖图像中没有出现流的区,而得以执行。在给定的实现方式中,来自所述彩色流处理器的所述多普勒图像可以提供仅所述图像中的流位置的空间图像。该步骤也可以包括在心脏周期的一些或全部上平均化所述流数据,以产生平均或中值流值。在步骤 104 中,分割血管,将它们与诸如灌注或组织运动的其他运动作用分开。在步骤 106 中,选择感兴趣血管。感兴趣血管一般将位于由用户采集的图像的中心。也可以通过考虑已被分割的血管的大小、流量和类型来选择感兴趣血管。例如,在颈动脉检查中,所述颈动脉将被识别为动脉,并被识别为图像中的最大血管。图 3a 示出了血管中流的实际超声流图像 120,其已被分割和选择用于进一步处理。

[0019] 在步骤 108 中,识别血管的流径的中心。已知用于绘制流的中心的几种技术,例如通过速度定位层流场的中心。另一种技术是分析地绘制横穿血管腔的线,如在前面提及的 Goujon 专利申请中所示的。所述线的中心或它们的交叉点限定了所述血管的中心。图 3b 图示了图 3a 的血管流,其中已由白色描记线 122 识别了流径的中心。该范例在图像底部示出了相连血管的分支。在步骤 110 中,计算流量加权的质心。这是通过分析目标血管中流的空间尺寸并寻找其中心而完成的。简单的方法是测量血管的流的长度和宽度,并取每个的中心。也可以使用更为复杂的加权和积分方法。

[0020] 在其中要自动设置样本体积的系统中,所述过程接下来在步骤 112 中将样本体积位置设置为流径 122 上最接近所计算的质心的点。这一般将所述样本体积定位在所述血管的所述图像的中心并且在一般在取得流测量结果的血管的中心。在步骤 114 中,根据被定位到所述样本体积位置的流向量,设置流角度。在本专利开始所描述的技术之一可以被用于设置流角度指针取向。另一种方法是将所述流角度指针设置为平行于中心线 122,因为所述中心线是在所述样本体积附近取向的。

[0021] 使用之前,在步骤 110 中计算的所述流的所述质心,将所述彩色框定位为以所述质心为中心。如果所述质心距所述图像的侧边太近,则可以根据需要截去所述彩色框的一些。如果期望均匀外观的话,也可以在高度或宽度上重新缩放所述彩色框。图 3c 和图 3d 图示了在超声图像 60 中对彩色框 70 的这种重新定位。在图 3c 中,流区域 76 为在彩色框 70 顶部的血管中的平滑灰色区域。图 3d 中示出了对流 76 的质心的计算以及它到彩色框 70 的中心的重新定位,其中所述彩色框已被重新定位为使得流 76 在所述彩色框更加处于中心。

在步骤 118 中,设置彩色框转向角度以及多普勒波束的角度,以达到期望的多普勒角度。例如,如果在步骤 114 中的流角度设置显示,目标血管流在所述图像中是从左上到右下的,则所述转向角度将被设置为从左上到右下的角度。该操纵方向比从所述图像的右上到左下方向的转向角度,更接近地与所述流方向一致,后者将更接近地正交于所述流方向并因此对多普勒流较不灵敏。针对浅表血管的典型转向角度为 $\pm 60^\circ$ 。步骤 118 的所述设置将然后设置所述转向角度为 $+60^\circ$ 或 -60° ,视哪个将产生较佳的多普勒灵敏度而定。通过比较图 3c 中的彩色框角度与图 3d 中的重置角度,也可见对所述彩色框转向角度的重置。可以根据所述样本体积位置的局部流方向,或者根据沿所述血管的所显示长度的一些或全部的平均或中值流角度,设置对所述彩色框转向角度的该设置。随着所述彩色框角度被这样重置,所述角度的新设置被耦合到波束形成控制器 16,从而将以新确定的角度发射被发射到所述彩色框的所述超声束。

[0022] 图 4 至图 7 的图像的序列图示上述的超声系统可以如何操纵的范例。图 4 示出了具有非最佳多普勒设置的典型彩色流 / 频谱多普勒双功能图像的超声系统显示。解剖学超声图像 60 在屏幕的上部,并且频谱多普勒显示 62 在所述屏幕的下部。多普勒探询在彩色框 70 内部完成,并且在该框内部显示彩色流图像。在彩色框 70 外部,以 B 模式灰阶示出所述图像的其余部分。彩色框的使用描绘了要在其中执行多普勒的区域,并且在所述彩色框外部不执行针对多普勒系列采集的重复多普勒发射。将所述多普勒发射限制到仅所述彩色框,消除了所述框外部对重复联机探询的需要,并因此限制了要产生所述图像所需要的发送 - 接收循环的总数目,由此减少了采集所述图像所需要的时间,这改善了显示的实时帧率。沿束方向线 68 发送和接收用于所述频谱多普勒数据的所述多普勒束,并且从在所述束方向线上返回自样本体积 SV 的回波,采集用于所述频谱多普勒显示的数据。被用于角度校正的多普勒流方向指针 66,没有与血管 64 (其应与所述流方向平行)的取向对齐,并且没有针对最佳色彩和频谱多普勒灵敏度优化所述多普勒转向角度。在该范例中,所述多普勒转向角度为 0° ,在所述图像中垂直并且法向于所述换能器探头的所述面。

[0023] 图 5 示出了在已由彩色框位置与转向角度处理器 40 进行了几次本发明的所述自动调节之后的所述超声系统显示。在用户已将所述多普勒样本体积 SV 置于血管 64 中的感兴趣位点上之后,处理器 40 分割血管 64 的血流,并且容易地将血管 64 (步骤 106) 识别为目标血管,彩色框 70 中的最大血管。识别 (步骤 108) 流径的中心,并如图 5 中图示,将流方向指针 66 的取向设置为平行于所述流方向 (步骤 114)。也看到,彩色框 70 的角度和波束方向线 68 已被设置为与血管 64 的所述取向达到 60° 角度 (步骤 118)。由于更优化的设置,新设置将产生更好的多普勒灵敏度和准确度。

[0024] 图 6 图示了其中用户已将所述样本体积 SV 移动到血管 64 上的不同位置的情景。所述自动系统已通过计算彩色框 70 内部的血管 64 中流的质心做出响应 (步骤 110)。彩色框 70 已被重新定位,使得所述框以所计算的质心为中心 (步骤 116);所述样本体积 SV 位于彩色框 70 的中心。流方向指针 66 与束方向线 68 的角度和彩色框 70 也已被调节,以达到期望的所述束方向与所述流防线之间的 60° 多普勒角度。

[0025] 在图 7 中,用户已通过移动所述超声探头改变了所述图像视图,并且已将所述样本体积 SV 重新定位到血管 64 之上的不同血管。基于先前选择的血管 64 及其视图的所述计算现在不再适用于新的感兴趣位点。现在必须使用来自所述不同血管的新数据初始化图

2 的流程图的计算,以将自动调节应用于新视图中的所述不同血管。

[0026] 图 8 图示了本发明的实现方式,其中针对自动流调节的用户控制被实施为显示屏上的软键,并且通过控制面板 50 上的鼠标或轨迹球控制进行选择 and 致动。按钮 82,致动自动流开 / 关按钮以打开或关闭流自动化。点击该按钮会将所述自动系统切换关闭(如果是打开的)或切换打开(如果是关闭的)。如果所述用户对它们不满意,自动流重置按钮 84 将重置所述自动化结果。促动该按钮将取消处理器 40 的所有之前的计算,并重新启动它们。自动流配置按钮 86 打开菜单(未示出),其中用户可以选择所述用户想要使用的自动调节特征中的哪个。所述用户例如,可能想要使所述系统自动重新定位所述彩色框以及所述彩色框与束方向的角度,但想要手动放置样本体积指针 SV 和设置流方向指针的取向。在该情况中,处理器 40 可以使用手动地设置的流方向指针的取向来计算并设置所述彩色框以及束方向转向角度,或使用计算的平均或中值流角度。对自动流 SV 追踪按钮 88 的促动引起所述系统动态追踪所述样本体积(随着其被重新定位)并进行自动流调节,如下文所述。

[0027] 图 9 图示了这样的情景,其中用户刚刚在血管 64 中的位置 80 获取了多普勒测量结果,并且想要在沿所述血管的一段的不同点处取得一系列测量结果。在现有技术的系统中,必须针对每个新的测量进行对多普勒采集设置的调节,要求所述用户用对所述超声系统的控制连续进行手动调节。在该图示中,用户在位置 80 的测量已结束,并且已将所述样本体积 SV 移动到所述血管中左边的另一位置。当所述用户暂停所述样本体积运动,以在到左边的新测量位置停止,或点击所述新位置时,所述超声系统立即进行全部的自动设置调节,所述自动设置调节是所述用户已用所述自动流配置按钮设置选择了的。结果由图 10 图示,其中所述系统已自动重新定位所述彩色框为围绕新的样本体积位置为中心,以自动调节彩色框 70 的多普勒角度以及频谱波束方向线 68,并且已自动设置流方向指针 66 的角度。所述系统立即准备好在最佳条件下,在新的样本体积位置处采集频谱多普勒数据。所述检查可以以此方式继续。用户每次移动样本体积指针到血管上新的位置并在那里暂停时,或者在所述新的位置上点击时,所述系统将针对最佳数据采集自动重置所述多普勒采集控制。用户可以沿所述血管的连续长度取测量结果,无需手动重新调节任何多普勒控制设置,加速了检查的执行并改善了超声医师的舒适度和方便性。

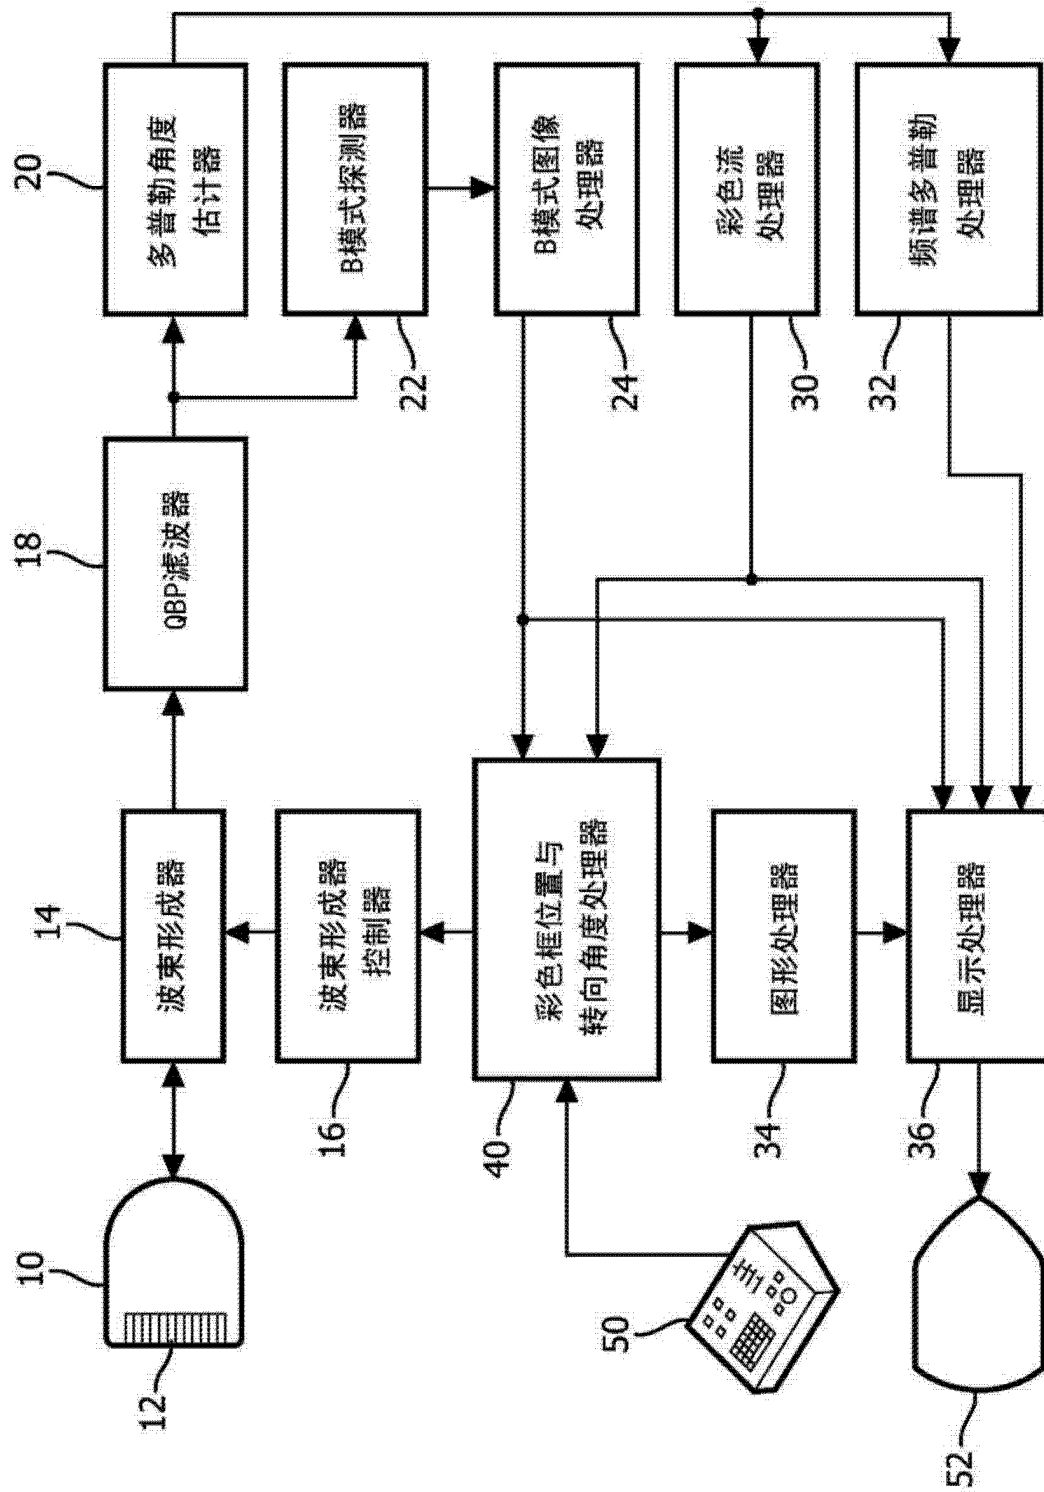


图 1

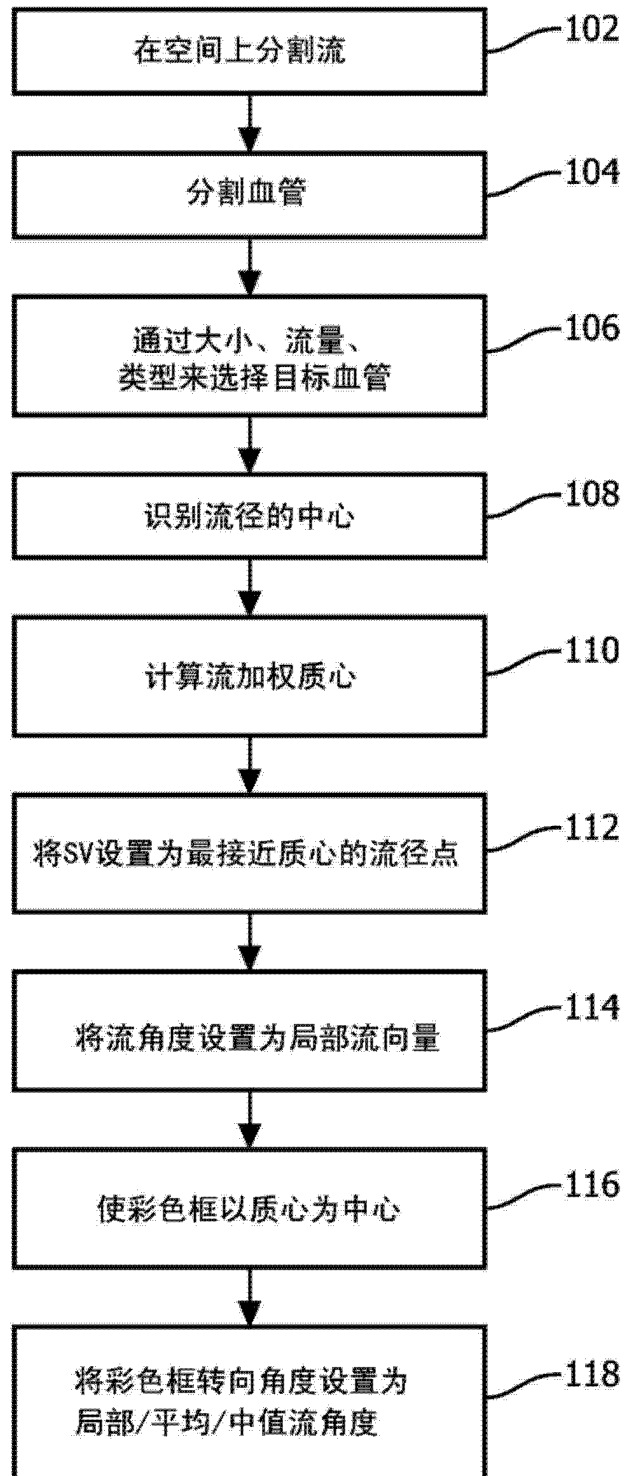


图 2

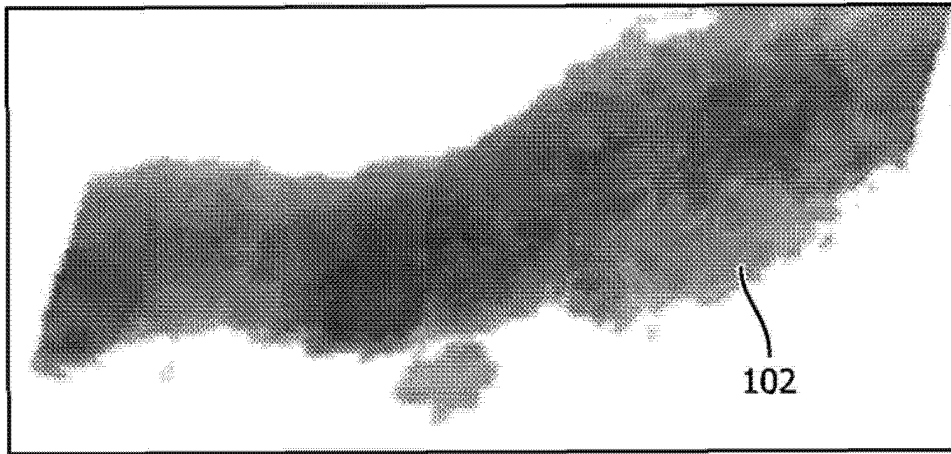


图 3a

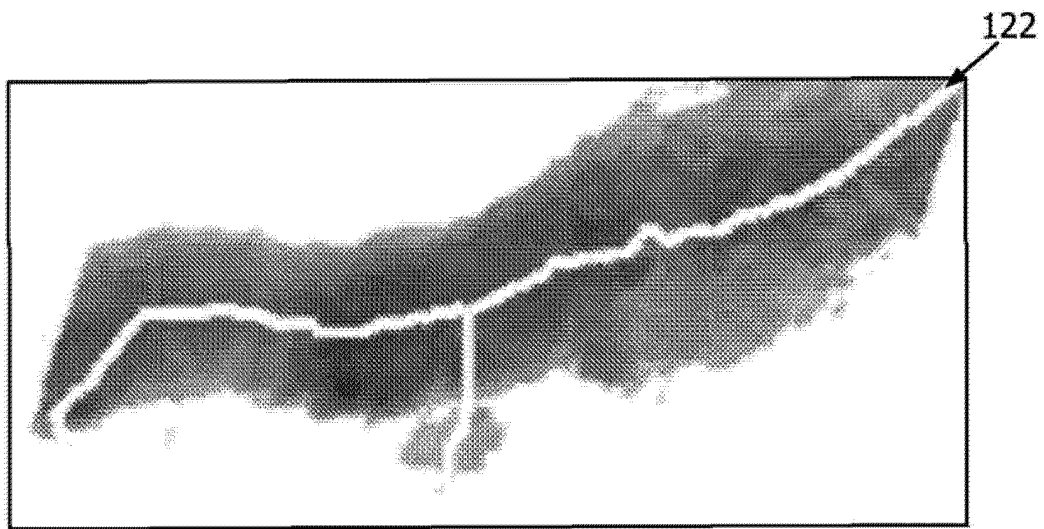


图 3b

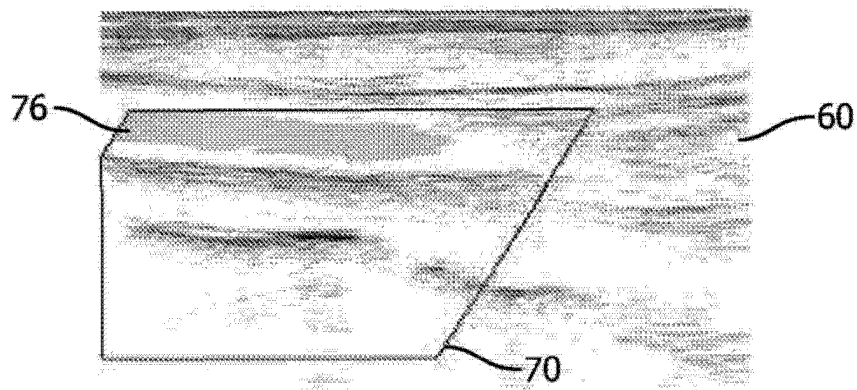


图 3c

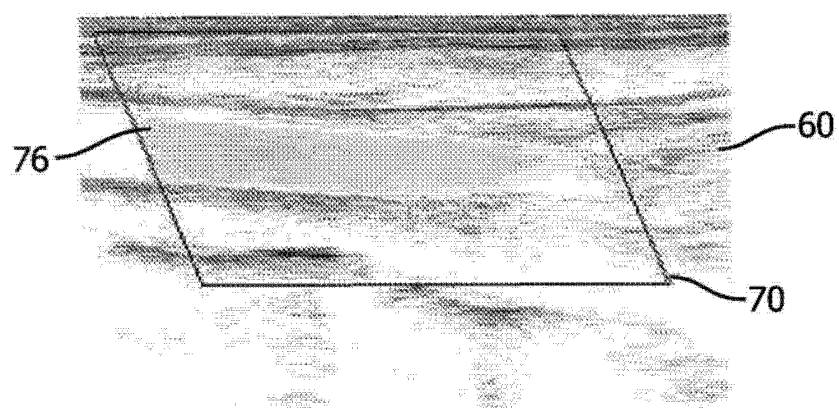


图 3d

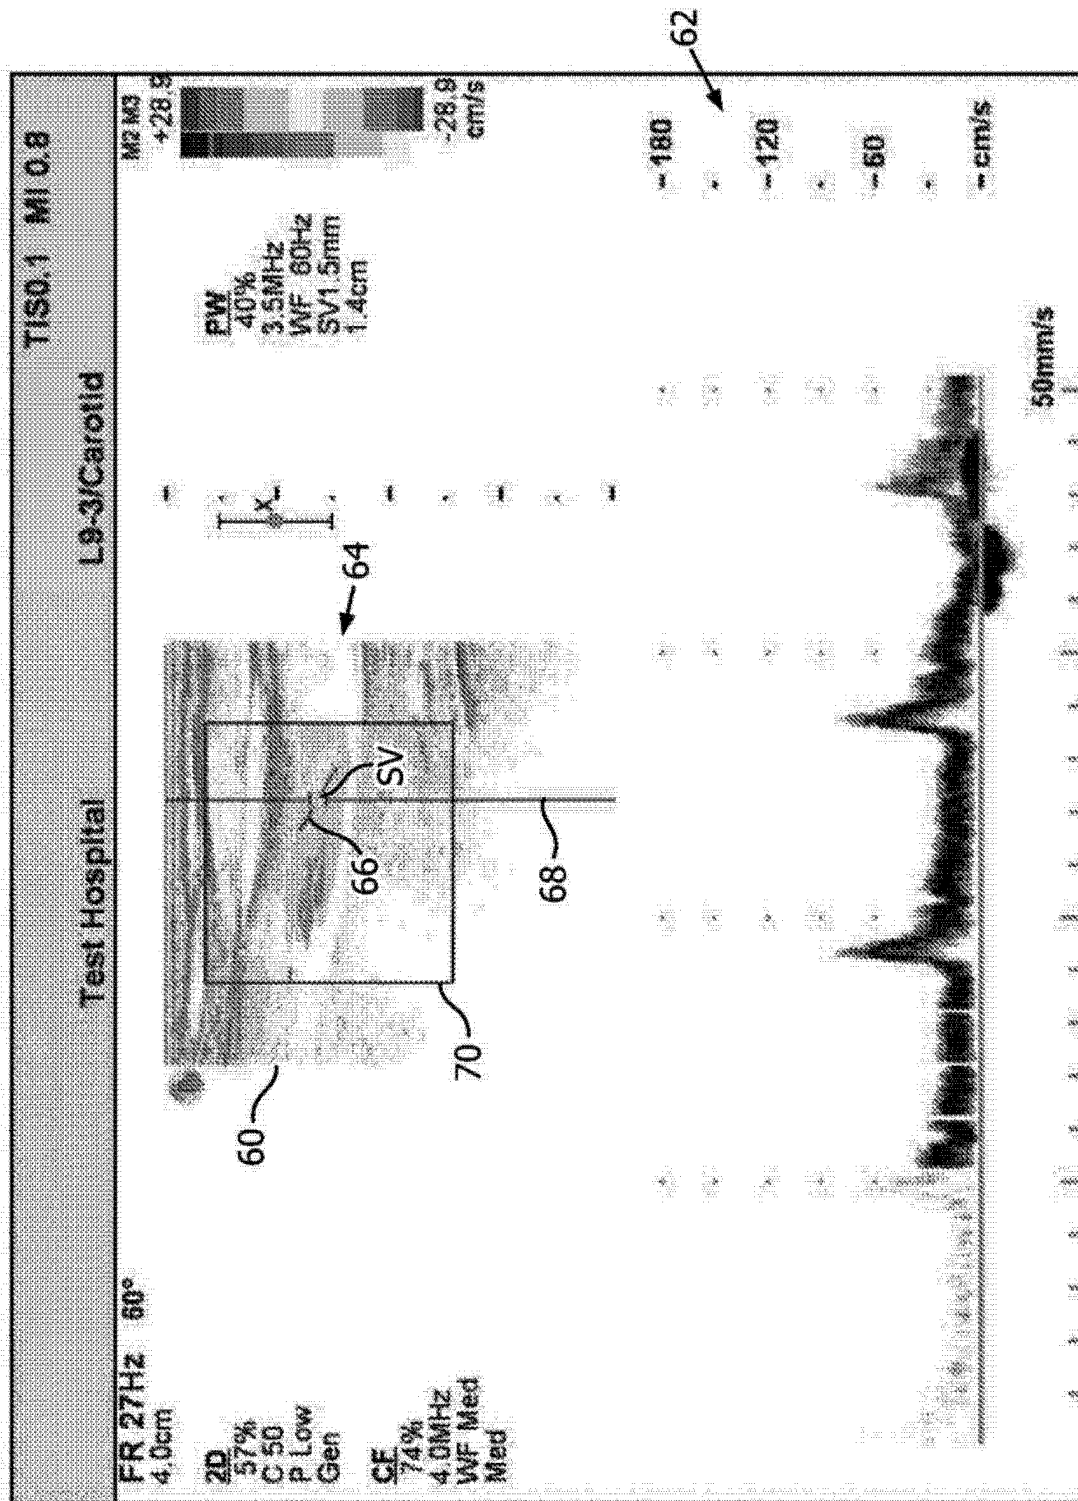


图 4

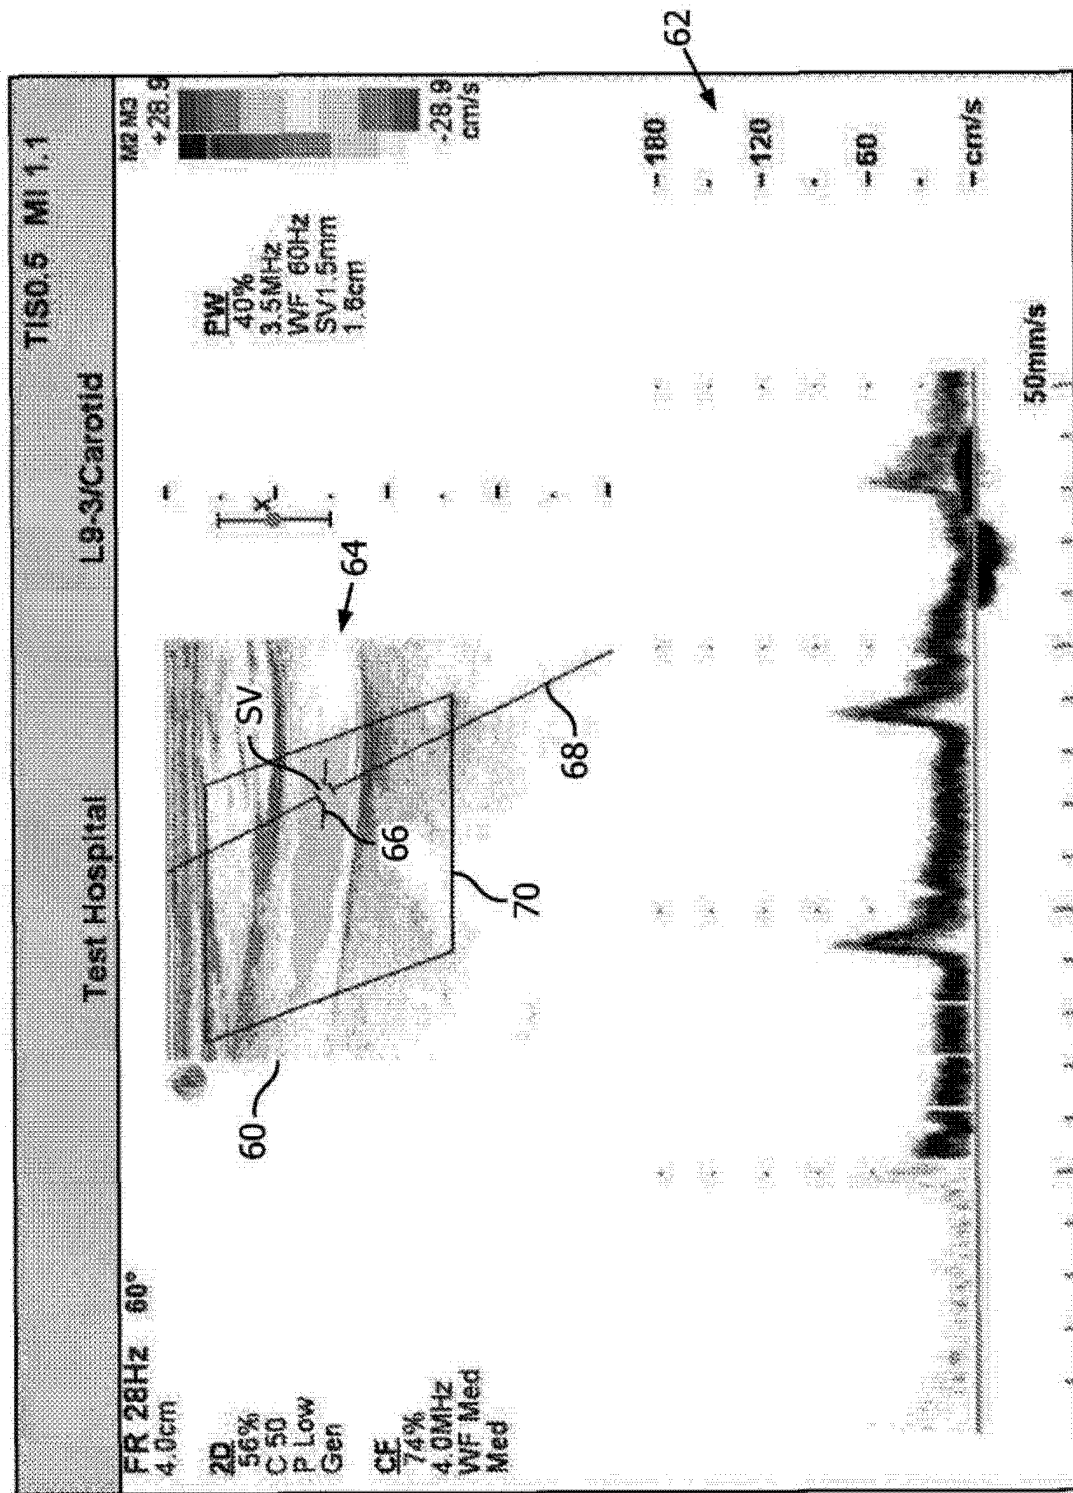


图 5

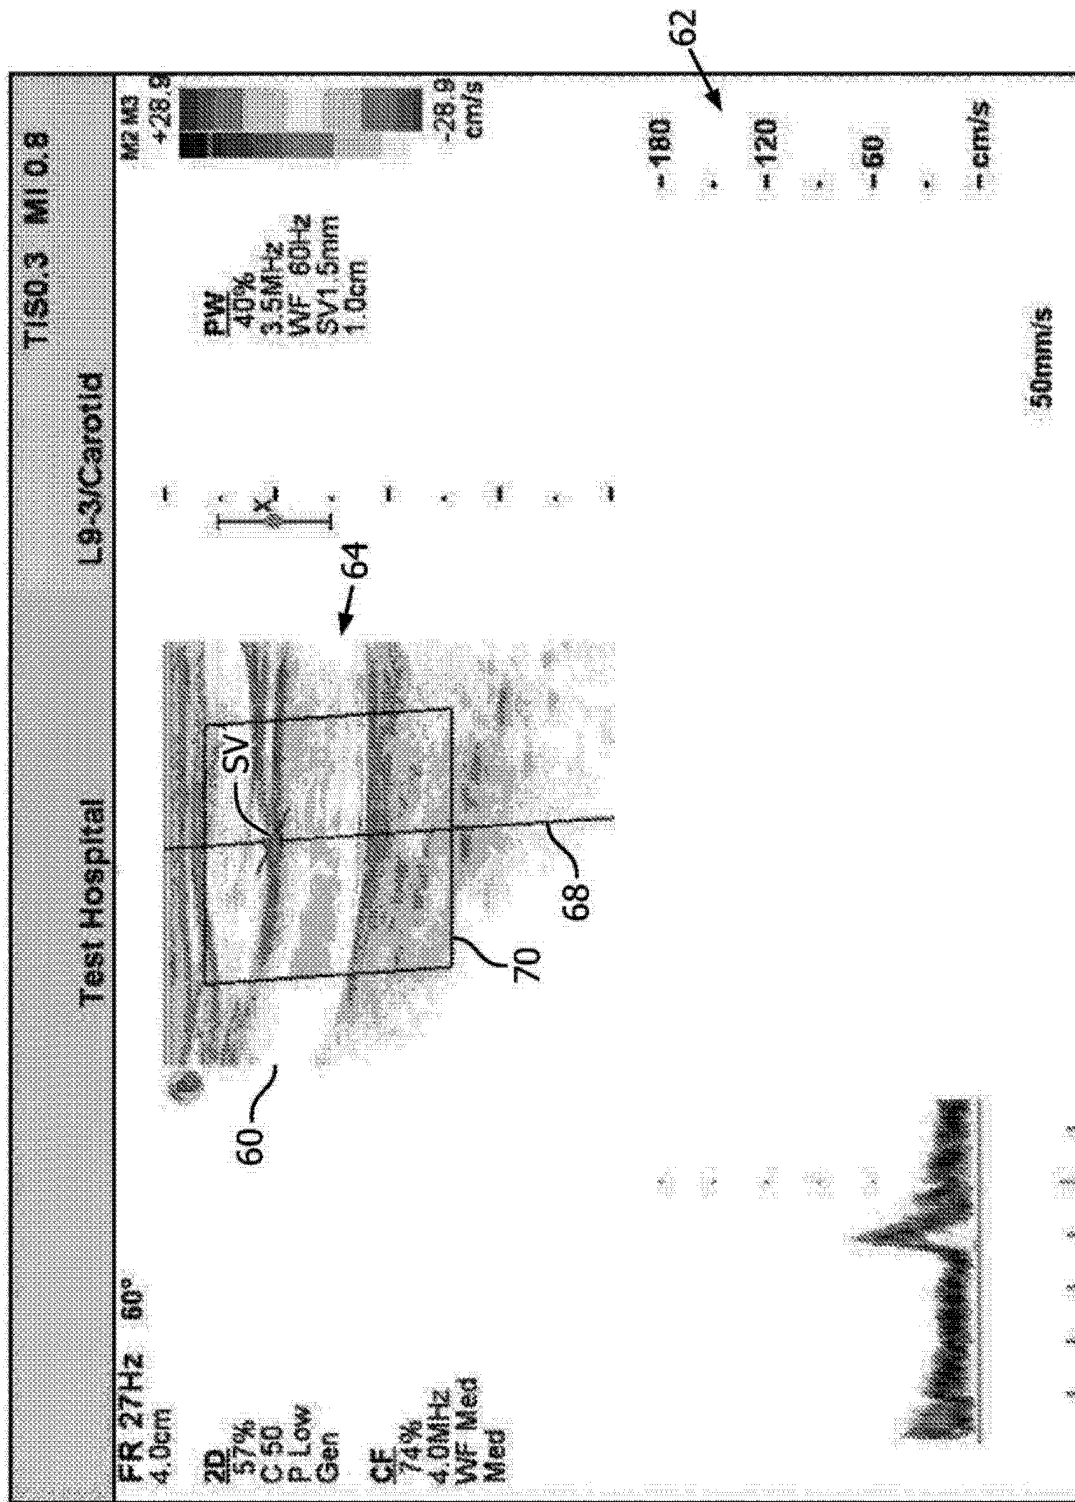


图 7

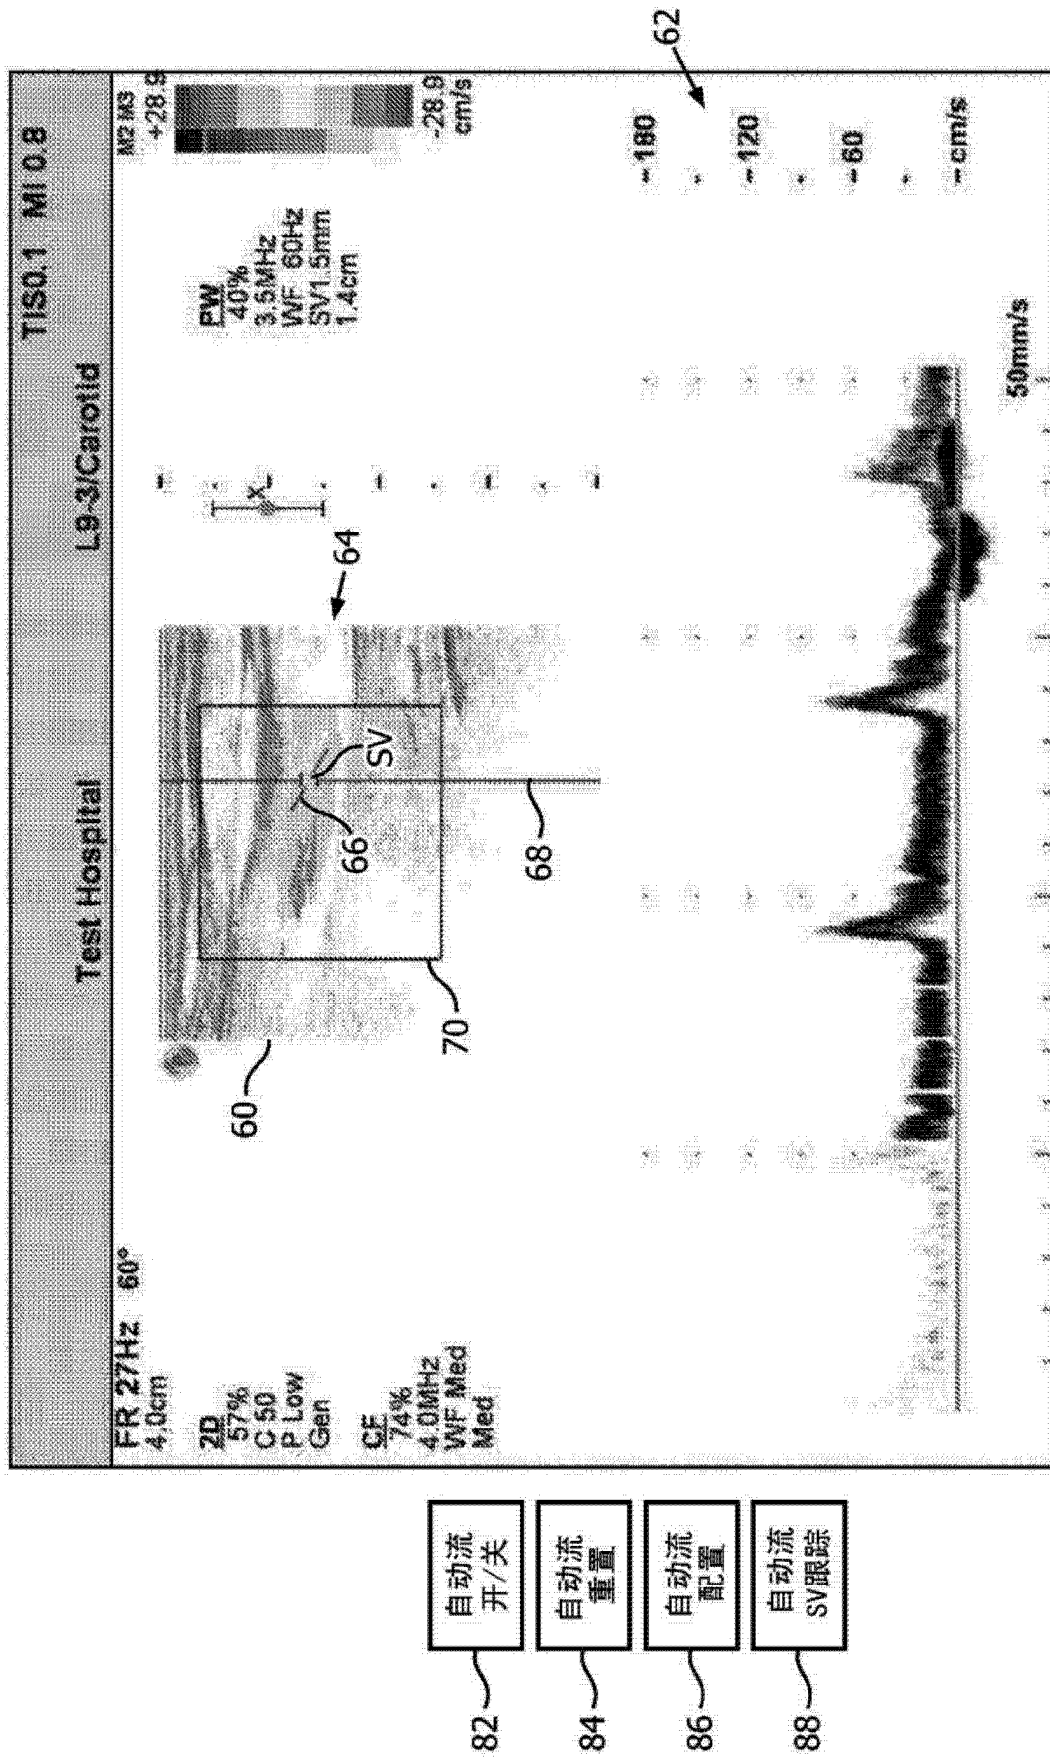


图 8

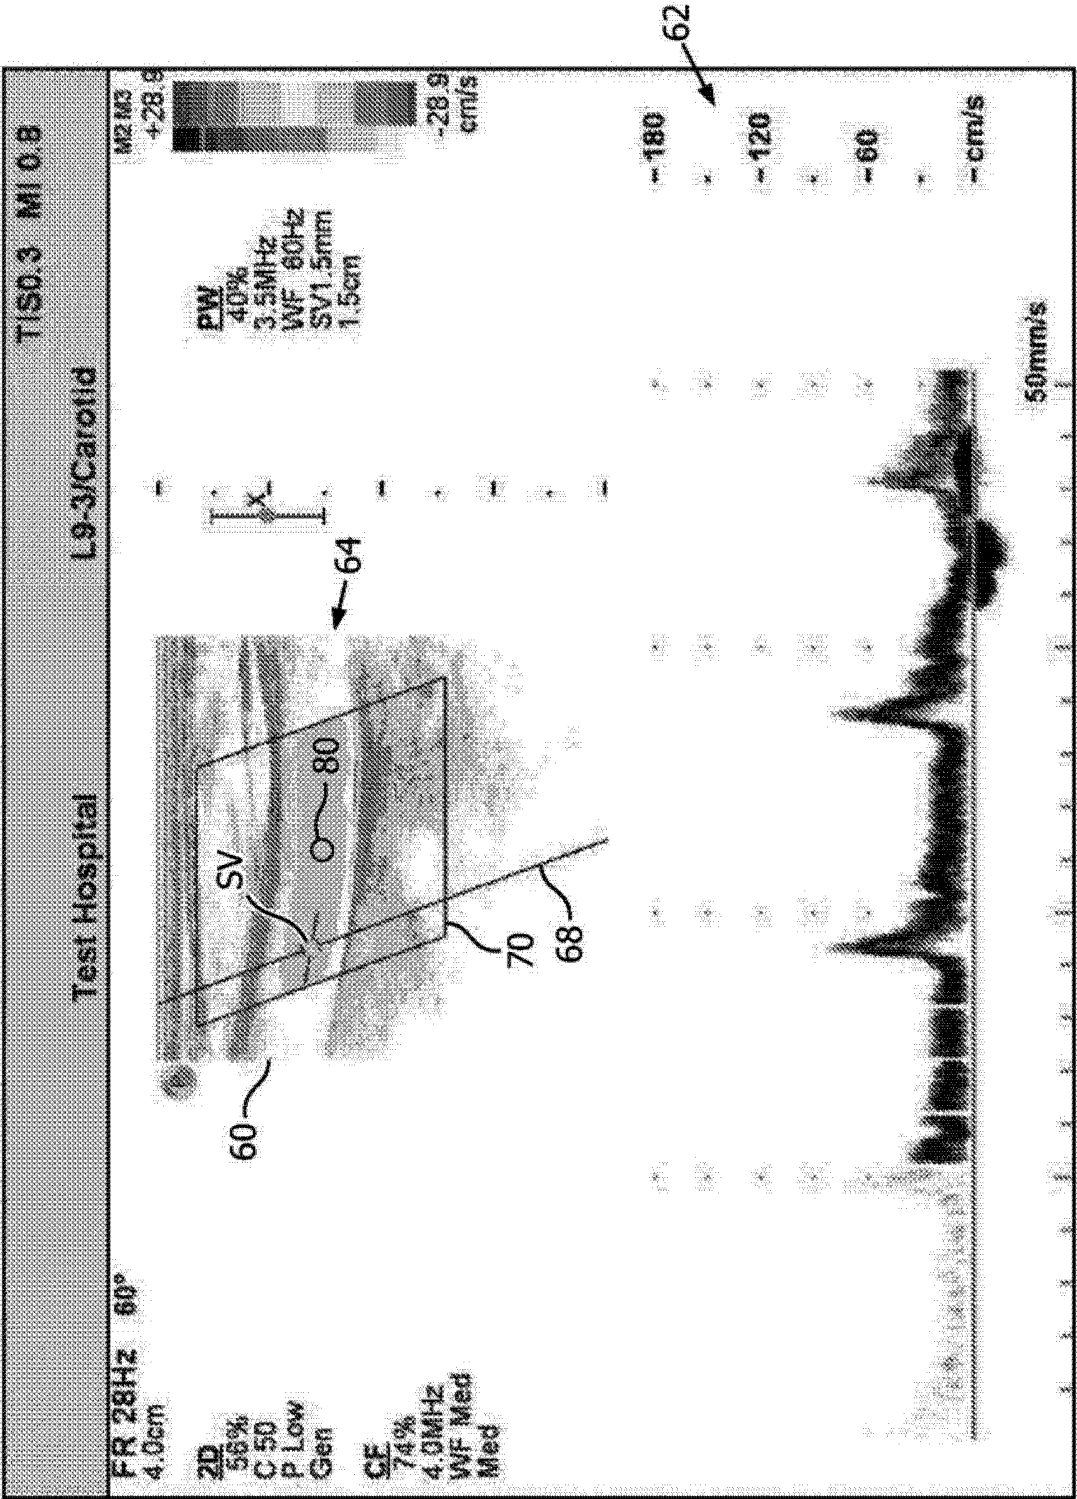


图 9

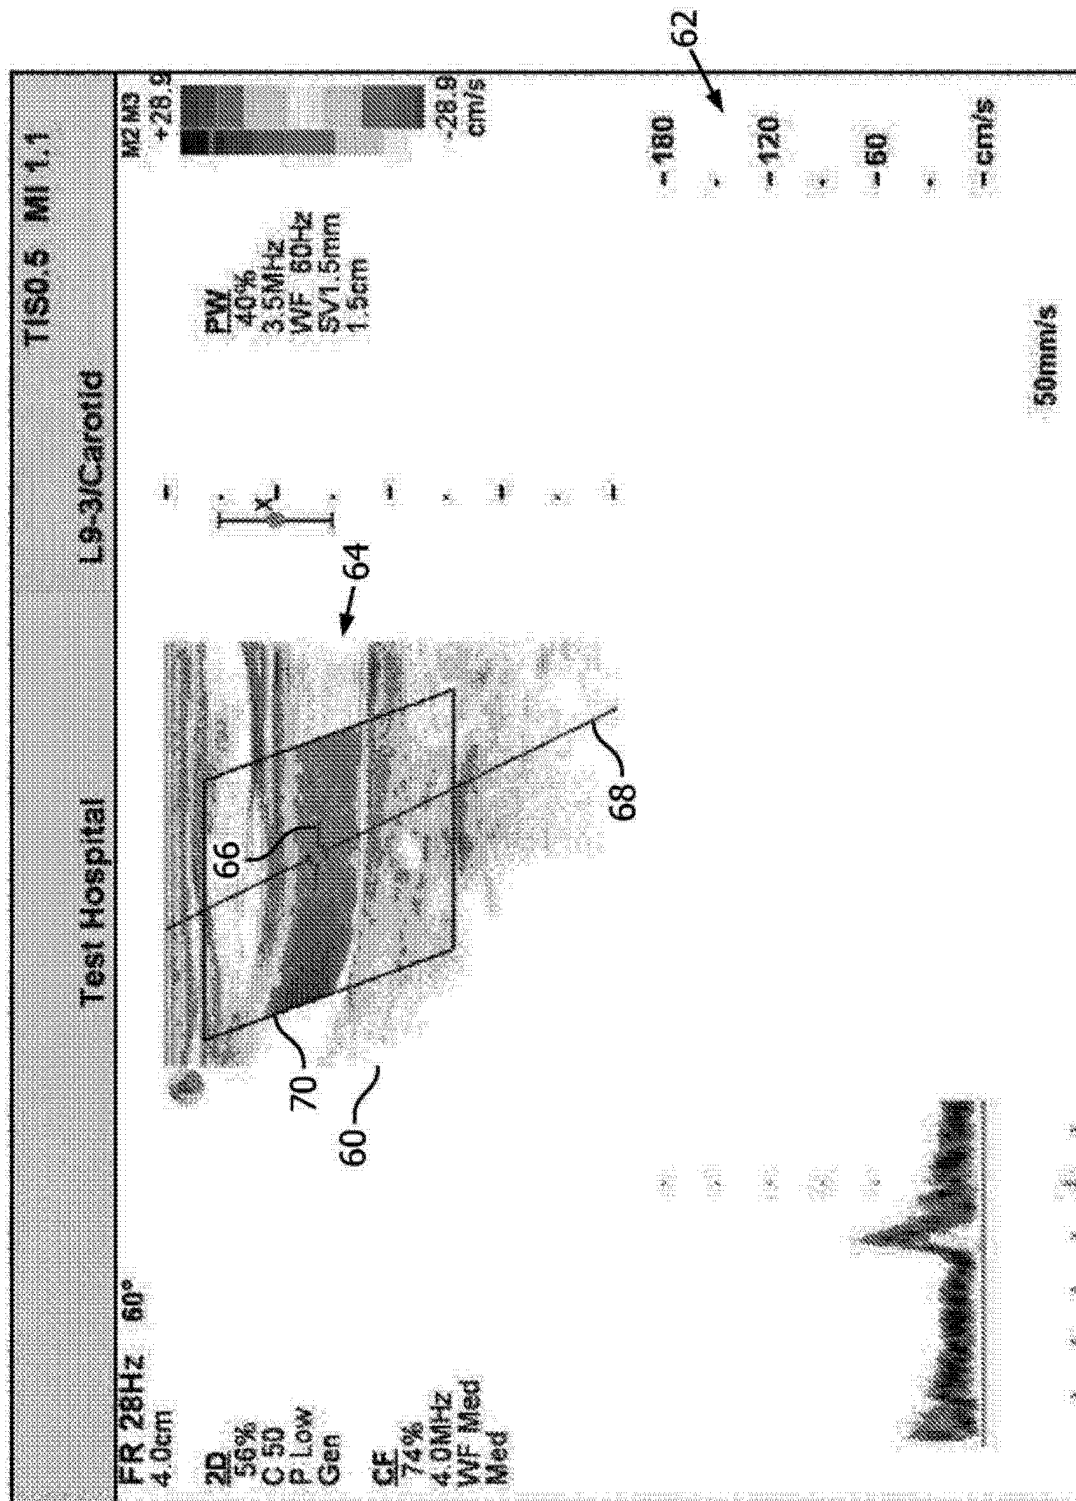


图 10

专利名称(译)	具有随样本体积移动的自动动态多普勒流设置的超声系统		
公开(公告)号	CN103841898A	公开(公告)日	2014-06-04
申请号	CN201280047540.4	申请日	2012-09-14
[标]申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦电子股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦有限公司		
[标]发明人	A萨阿德 T卢帕斯 D赫尔 SJ希尔		
发明人	A·萨阿德 T·卢帕斯 D·赫尔 S·J·希尔		
IPC分类号	A61B8/06 G01S7/52 G01S15/58 G01S15/89		
CPC分类号	A61B8/488 G01S7/52066 G01S15/8988 G01S15/8981 G01S7/52073 A61B8/06 G01S7/52071 G01S15/8984		
代理人(译)	王英 刘炳胜		
优先权	61/541369 2011-09-30 US		
其他公开文献	CN103841898B		
外部链接	SIPO		

摘要(译)

一种超声系统，执行双功能彩色流与频谱多普勒成像，其中在所述彩色流图像上所示的样本体积位置执行频谱多普勒探测。所述彩色流图像被显示在叠加在共配准的B模式图像上的彩色框中。彩色框位置与转向角度处理器分析空间多普勒数据，并自动地针对最佳多普勒灵敏度和准确度来设置所述彩色框在血管上的角度和位置。所述处理器也可以自动地设置流角度校正指针与流方向对齐。在优选的实施例中，随着用户为了多普勒测量而在沿所述血管的长度的点暂停，自动地并连续地进行这些优化调整。

