

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2008-6108
(P2008-6108A)

(43) 公開日 平成20年1月17日(2008.1.17)

(51) Int. Cl.
A61B 8/12 (2006.01)

F I
A61B 8/12

テーマコード(参考)
4C601

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 49 頁)

(21) 出願番号 特願2006-180435 (P2006-180435)
(22) 出願日 平成18年6月29日(2006.6.29)

(71) 出願人 304050923
オリンパスメディカルシステムズ株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
(74) 代理人 100076233
弁理士 伊藤 進
(72) 発明者 川島 知直
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
リンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72) 発明者 生熊 聡一
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
リンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72) 発明者 小幡 里織
東京都渋谷区初台1丁目53番6号 オ
リンパスシステムズ株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 体腔内プローブ装置

(57) 【要約】

【課題】 体腔内プローブの挿入形状とリアルタイム画像の方向とを侵襲を少なく検出でき、体腔内プローブの挿入形状とリアルタイム画像の方向とを含んだガイド画像を作成することができる体腔内プローブ装置を提供する。

【解決手段】 体腔内に挿入される体腔内プローブとしての超音波内視鏡2の先端の硬性部21内には超音波のエコー信号を取得する超音波振動子アレイ29が設けられると共に、その近傍に画像位置配向検出用コイル31を設け、さらに可撓部22の長手方向に挿入形状検出用コイル32を設ける等して、可撓部22の挿入形状と、エコー信号から生成したリアルタイム画像としての超音波断層像の方向等を含むガイド画像を生成する。

【選択図】 図1

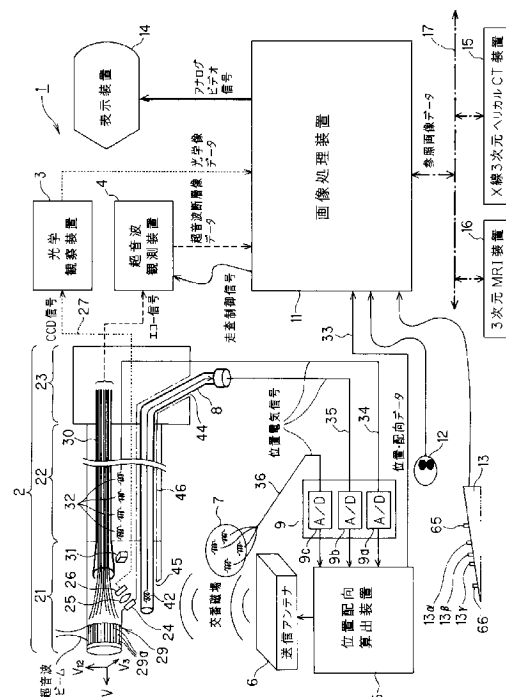

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被検体の体腔内へ挿入される体腔内プローブと、
前記体腔内プローブの挿入形状を作成する挿入形状作成手段と、
人体の 3 次元データから前記人体の 3 次元画像を作成する 3 次元画像作成手段と、
前記挿入形状と、前記 3 次元画像とを合成する合成手段と、
を備えた体腔内プローブ装置において、
前記体腔内プローブは、前記体腔内への挿入側に前記被検体内の画像を作成するための
信号を取得する画像信号取得手段を固定して設けた硬性部と、前記硬性部より手前側の可
撓部とを具備し、

10

前記画像信号取得手段が取得した信号から前記被検体内のリアルタイム画像を作成する
画像作成手段と、

前記硬性部に対して位置が固定された画像位置配向検出用素子と、

前記可撓部に沿って複数個設けられた挿入形状検出用素子と、

前記被検体に接触可能な被検体検出用素子と、

前記画像位置配向検出用素子の位置と配向との 6 自由度と、前記複数個の挿入形状検出
用素子の各位置と、前記被検体検出用素子の位置もしくは配向とを検出し、検出値として
出力する検出手段と、

前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像の位置と配向とを示
す画像指標を作成する画像指標作成手段と、

20

を具備し、

前記合成手段は、前記検出手段が出力した検出値を基に、前記挿入形状と前記画像指標
と前記 3 次元画像とを合成し、前記被検体に対する前記可撓部と前記リアルタイム画像の
位置および配向をガイドする 3 次元ガイド画像を作成することを特徴とする体腔内プロ
ーブ装置。

【請求項 2】

前記被検体検出用素子を固定して内蔵し、前記被検体の所定の位置に同時もしくは順次
に接触する接触手段を有し、

前記検出手段が、前記被検体検出用素子が前記接触位置から、前記所定の位置を検出値
として出力し、

30

前記合成手段は、前記検出手段が出力した検出値を基に、前記挿入形状と前記画像指標
と前記 3 次元画像との位置を合わせて合成し、前記被検体に対する前記可撓部と前記リア
ルタイム画像の位置および配向をガイドする 3 次元ガイド画像を作成することを特徴とす
る請求項 1 に記載の体腔内プローブ装置。

【請求項 3】

前記可撓部は、管状のチャンネルを有し、

前記接触手段は、先端に前記被検体検出用素子を固定して内蔵し、前記チャンネルに挿
通して前記被検体の前記体腔内の所定の位置に接触することを特徴とする請求項 2 に記載
の体腔内プローブ装置。

【請求項 4】

40

前記 3 次元画像作成手段は、前記被検体から撮像された 3 次元データから臓器もしくは
脈管を抽出する抽出手段を有し、

前記 3 次元画像作成手段は、前記抽出手段が抽出した前記被検体の前記臓器もしくは前
記脈管から、前記臓器もしくは前記脈管の形状と配置とを表現する 3 次元画像を作成し、

前記合成手段は、前記検出手段が出力した検出値を基に、前記挿入形状と前記画像指標
と前記 3 次元画像とを合成し、前記被検体に対する前記可撓部と前記リアルタイム画像の
位置および配向をガイドする 3 次元ガイド画像を作成することを特徴とする請求項 1 に記
載の体腔内プローブ装置。

【請求項 5】

前記画像信号取得手段は、前記被検体内を撮像して映像信号を出力する撮像素子であり

50

、前記画像作成手段は、前記映像信号から前記リアルタイム画像として光学像を作成することを特徴とする請求項1に記載の体腔内プローブ装置。

【請求項6】

前記画像信号取得手段は、前記被検体内に超音波を送受信してエコー信号を出力する超音波振動子であり、

前記画像作成手段は、前記エコー信号から前記リアルタイム画像として超音波断層像を作成することを特徴とする請求項1に記載の体腔内プローブ装置。

【請求項7】

前記画像位置配向検出用素子と前記挿入形状検出用素子と前記被検体検出用素子とは、磁場発生器もしくは磁場検出器であり、

前記検出手段は、磁場を用いて前記検出を行うことを特徴とする請求項1に記載の体腔内プローブ装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、体腔内に挿入される体腔内プローブを用いて体腔内を診断等する体腔内プローブ装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来より、内視鏡、超音波内視鏡、細径超音波プローブなど、消化管、胆膵管、血管などの体腔内へ挿入して、診断、治療に用いる体腔内プローブが周知である。これら体腔内プローブは通常、先端にCCDカメラなどの撮像素子や超音波振動子を先端に設けている。

そして、これら体腔内プローブは、撮像素子や超音波振動子から得られた信号から光学像や超音波断層像を作成するプロセッサと一体となった体腔内プローブ装置として用いられることが通例である。

さらに、近年、これら体腔内プローブを目的部位まで容易に到達するよう補助するためにナビゲーション機能を備えた体腔内プローブ装置が公知である。

【0003】

このうち、第1の従来例としての特開2004-113629号公報で開示されている体腔内プローブ装置は、被検体に超音波を送受して得られる超音波信号により、超音波画像を生成する超音波診断装置であり、超音波を送受する部位の位置を検出するための超音波走査位置検出手段と、超音波信号を基に超音波画像を生成する超音波画像生成手段と、超音波走査位置検出手段により得られる位置情報に対応する被検体の部位の解剖学的な画像情報を、ガイド画像としての人体の模式図データを有する画像情報保持手段より取得し超音波画像と同一の画面に表示させる制御手段と、を備えている。

この体腔内プローブ装置では、超音波画像がリアルタイム画像として表示される。

【0004】

また、この体腔内プローブ装置では、実際の位置情報検出には磁場を発生する送信コイルと磁場を受信する受信コイルとが用いられており、このうち、あるコイルは体腔内プローブとしての超音波内視鏡の挿入端に設けられ、あるコイルは被検体に装着される。このため、この体腔内プローブ装置では被検体の姿勢を検出して、超音波を送受する被検体の部位の位置を検出することができる。

一方、第2の従来例としての特開2002-306403号公報で開示されている体腔内プローブ装置は、内視鏡の挿入形状を検出し、挿入形状を描出する映像信号を得る内視鏡装置であり、予め被検体のCTスキャンにて3次元領域の連続するスライス断層像から被検体の3次元画像を生成する画像生成手段と、挿入形状と挿入形の周囲の被検体の3次元画像とを合成して表示する表示手段と、を設けている。

【0005】

この体腔内プローブ装置では、内視鏡像がリアルタイム画像として表示される。

10

20

30

40

50

また、この体腔内プローブ装置では、実際の挿入形状検出には、内視鏡の可撓管に充填された線を放射する放射性物質と、線吸収により発光するシンチレータと受光素子とを組み合わせた底部検出部と垂直検出部と、が用いられている。

【特許文献1】特開2004-113629号公報

【特許文献2】特開2002-306403号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

上述した特開2004-113629号公報には、体腔内プローブの挿入形状とリアルタイム画像(この特開2004-113629号公報では超音波画像)の方向とを含んだガイド画像を作成することができるよう記載されている。しかし、この公報では、これを実施する構成が以下の通り不足している。 10

第1に挿入形状を検出する構成の記載がない。そのため、挿入形状を含んだガイド画像を作成することができないという課題がある。

第2にリアルタイム画像の方向を検出する構成の記載がない。特に、先端の体腔内プローブ挿入端に設けられたコイルの取付方法、出力内容、検出自由度についての記載がない。それゆえ、走査面が体腔内プローブに対し、どの方向を向いているかを検出することができない。

【0007】

そのため、リアルタイム画像の方向を含んだガイド画像を作成することができないという課題がある。体腔内プローブとして特開2004-113629号公報に記載の電子コンベックス走査型超音波内視鏡を採用したとき、特に挿入軸の周りのねじれの角度について検出ができないので、この課題は顕著である。 20

そのためさらに、特開2004-113629号公報と特開2002-306403号公報とに開示されている体腔内プローブ装置と組み合わせた構成の体腔内プローブ装置を仮定すると、上記の課題は以下のように整理される。

第1に挿入形状を含んだガイド画像を作成することができないという課題については、特開2002-306403号公報で開示されている体腔内プローブ装置との組み合わせにより挿入形状を検出する構成が得られるため、挿入形状を含んだガイド画像を作成することができる。 30

【0008】

しかし、この特開2002-306403号公報で開示されている体腔内プローブ装置では挿入形状の検出に線を用いており、術者にも被検体にも放射線被曝の侵襲が大きいという新たな課題が生じる。

第2にリアルタイム画像の方向を含んだガイド画像を作成することができないという課題については、特開2002-306403号公報にもリアルタイム画像の方向を検出する構成の記載がなくこの、課題が解決されない。

【0009】

(発明の目的)

本発明は、上述した点に鑑みてなされたもので、体腔内プローブの挿入形状とリアルタイム画像の方向とを侵襲を少なく検出でき、両者を含んだガイド画像を作成することができる体腔内プローブ装置を提供することを目的とする。 40

また、本発明は、体腔内プローブの挿入形状とリアルタイム画像の方向とを含んだガイド画像を作成することができる体腔内プローブ装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明の請求項1は、被検体の体腔内へ挿入される体腔内プローブと、前記体腔内プローブの挿入形状を作成する挿入形状作成手段と、人体の3次元データから前記人体の3次元画像を作成する3次元画像作成手段と、前記挿入形状と、前記3次元画像とを合成する合成手段と、

を備えた体腔内プローブ装置において、

前記体腔内プローブは、前記体腔内への挿入側に前記被検体内の画像を作成するための信号を取得する画像信号取得手段を固定して設けた硬性部と、前記硬性部より手前側の可撓部とを具備し、

前記画像信号取得手段が取得した信号から前記被検体内のリアルタイム画像を作成する画像作成手段と、

前記硬性部に対して位置が固定された画像位置配向検出用素子と、

前記可撓部に沿って複数個設けられた挿入形状検出用素子と、

前記被検体に接触可能な被検体検出用素子と、

前記画像位置配向検出用素子の位置と配向との6自由度と、前記複数個の挿入形状検出用素子の各位置と、前記被検体検出用素子の位置もしくは配向とを検出し、検出値として出力する検出手段と、

前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像の位置と配向とを示す画像指標を作成する画像指標作成手段と、

を具備し、

前記合成手段は、前記検出手段が出力した検出値を基に、前記挿入形状と前記画像指標と前記3次元画像とを合成し、前記被検体に対する前記可撓部と前記リアルタイム画像の位置および配向をガイドする3次元ガイド画像を作成することを特徴とする。

上記構成により、体腔内プローブの挿入形状とリアルタイム画像の方向とを侵襲を少なく検出でき、体腔内プローブの挿入形状とリアルタイム画像の方向とを含んだガイド画像を作成することができるようにしている。

【0011】

また、本発明の請求項2は、上記請求項1の体腔内プローブ装置において、前記被検体検出用素子を固定して内蔵し、前記被検体の所定の位置に同時もしくは順次に接触する接触手段を有し、

前記検出手段が、前記被検体検出用素子が前記接触位置から、前記所定の位置を検出値として出力し、

前記合成手段は、前記検出手段が出力した検出値を基に、前記挿入形状と前記画像指標と前記3次元画像との位置を合わせて合成し、前記被検体に対する前記可撓部と前記リアルタイム画像の位置および配向をガイドする3次元ガイド画像を作成することを特徴とする。

上記構成により、被検体の所定の位置を接触させることにより、その位置をより確実に検出してガイド画像を作成することができるようにする。

【0012】

また、本発明の請求項3は、上記請求項2の体腔内プローブ装置において、前記可撓部は、管状のチャンネルを有し、

前記接触手段は、先端に前記被検体検出用素子を固定して内蔵し、前記チャンネルに挿通して前記被検体の前記体腔内の所定の位置に接触することを特徴とする。

上記構成により、体腔内における所望とする部位の位置検出をより確実に行うことができるようにしている。

【0013】

また、本発明の請求項4は、上記請求項1の体腔内プローブ装置において、前記3次元画像作成手段は、前記被検体から撮像された3次元データから臓器もしくは脈管を抽出する抽出手段を有し、

前記3次元画像作成手段は、前記抽出手段が抽出した前記被検体の前記臓器もしくは前記脈管から、前記臓器もしくは前記脈管の形状と配置とを表現する3次元画像を作成し、

前記合成手段は、前記検出手段が出力した検出値を基に、前記挿入形状と前記画像指標と前記3次元画像とを合成し、前記被検体に対する前記可撓部と前記リアルタイム画像の位置および配向をガイドする3次元ガイド画像を作成することを特徴とする。

上記構成により、臓器若しくは脈管の3次元画像を含む3次元ガイド画像を作成するこ

とにより、ガイドする機能がより向上した 3 次元ガイド画像を作成することができるようにしている。

【0014】

また、本発明の請求項 5 は、上記請求項 1 の体腔内プローブ装置において、前記画像信号取得手段は、前記被検体内を撮像して映像信号を出力する撮像素子であり、前記画像作成手段は、前記映像信号から前記リアルタイム画像として光学像を作成することを特徴とする。

上記構成により、撮像素子により撮像された光学像のリアルタイム画像に対する 3 次元ガイド画像を作成することができるようにしている。

【0015】

また、本発明の請求項 6 は、上記請求項 1 の体腔内プローブ装置において、前記画像信号取得手段は、前記被検体内に超音波を送受信してエコー信号を出力する超音波振動子であり、

前記画像作成手段は、前記エコー信号から前記リアルタイム画像として超音波断層像を作成することを特徴とする。

上記構成により、超音波振動子により撮像された超音波断層像のリアルタイム画像に対する 3 次元ガイド画像を作成することができるようにしている。

【0016】

また、本発明の請求項 7 は、上記請求項 1 の体腔内プローブ装置において、前記画像位置配向検出用素子と前記挿入形状検出用素子と前記被検体検出用素子とは、磁場発生器もしくは磁場検出器であり、

前記検出手段は、磁場を用いて前記検出を行うことを特徴とする。

上記構成により、簡単な構成で画像位置配向検出用素子、挿入形状検出用素子及び被検体検出用素子の位置などを検出できるようにしている。

【発明の効果】

【0017】

本発明によれば、体腔内プローブの挿入形状とリアルタイム画像の方向とを侵襲を少なく検出でき、両者を含んだガイド画像を作成することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

以下、図面を参照して本発明の各実施例を説明する。

【実施例 1】

【0019】

図 1 から図 2 1 を参照して本発明の実施例 1 を説明する。図 1 は本発明の実施例 1 の体腔内プローブ装置の構成を示し、図 2 は体表検出用コイルを使用例で示し、図 3 は体腔内接触プローブを示し、図 4 は画像処理装置の構成を示し、図 5 は参照画像記憶部に記憶される参照画像データを示す。

図 6 は、ボクセル空間を示し、図 7 は位置・配向データを表すために送信アンテナ上に原点を設定した直交基底を示し、図 8 は被検体側の超音波断層像の中心をボクセル空間へ写像する説明図を示し、図 9 は被検体側の体腔内特徴点をボクセル空間へ写像する説明図を示し、図 10 は画像指標作成回路により画像指標データが作成される様子を示す。

【0020】

図 11 は挿入形状作成回路により作成される挿入形状データが作成される様子を示し、図 12 は 3 次元人体画像データを示し、図 13 は合成回路により画像指標データと挿入形状データとが合成メモリ内のボクセル空間に埋められていく様子を示し、図 14 は被検体の腹側から観察した場合の 3 次元ガイド画像データを示し、図 15 は被検体の足側から観察した場合の 3 次元ガイド画像データを示す。

図 16 は表示装置に表示される 3 次元ガイド画像及び超音波断層像を示し、図 17 は本実施例の全体的な処理内容をフローチャートで示し、図 18 は図 17 における参照画像上での体表特徴点、体腔内特徴点指定処理の具体的な処理内容をフローチャートで示し、図

10

20

30

40

50

19は図17における補正值算出処理の具体的な処理内容をフローチャートで示し、図20は図19における処理の説明図を示し、図21は図17における超音波断層像・3次元ガイド画像作成/表示処理の具体的な処理内容をフローチャートで示す。

【0021】

まず、本発明の実施例1の体腔内プローブ装置1の構成を説明する。

図1に示すように実施例1の体腔内プローブ装置1は、体腔内プローブとしての電子ラジアル走査型の超音波内視鏡2と、光学観察装置3と、超音波観測装置4と、位置配向算出装置5と、送信アンテナ6と、体表検出用コイル7と、体腔内接触プローブ8と、A/Dユニット部9と、画像処理装置11と、マウス12と、キーボード13と、表示装置14とからなり、これらは信号線で接続されている。

体腔内プローブ装置1の外部にはX線3次元ヘリカルCT装置(X-ray 3 dimensional computer tomography system)15、3次元MRI装置(3 dimensional magnetic resonance imaging system)16と、それらを接続した光通信やADSL等の高速のネットワーク17がある。X線3次元ヘリカルCT装置15、3次元MRI装置16とは、ネットワーク17経由で本体腔内プローブ装置1の画像処理装置11と接続している。

【0022】

超音波内視鏡2は、食道、胃、十二指腸などの体腔内に挿入できるよう、先端のステンレス等の硬質な材料で構成された硬性部21と、硬性部21より後端側に可撓性のある材料で構成された長尺の可撓部22と、可撓部22より後端側(手前側)に硬質な材料で構成された操作部23とを有する。なお、硬性部21と可撓部22は、体腔内に挿入される挿入部を形成する。

硬性部21には、以下のように光学的に撮像して画像信号を取得する画像信号取得手段が、硬性部21に固定して設けてある。

硬性部21には、カバーガラスで形成された光学観察窓24が設けてあり、この光学観察窓24の内側に光学像を結ぶ対物レンズ25と、その結像位置に配置された撮像素子として、例えばCCD(charge coupled device)カメラ26とが設けてある。また、この光学観察窓24に隣接して、体腔内に照明光を照射する図示しない照明光照射窓(照明窓)が設けられている。

【0023】

CCDカメラ26は、光学観察装置3と信号線27で接続されている。図示しない照明光照射窓は照明光を照射し、体腔内を照明するよう構成されている。体腔表面の像は、光学観察窓24から対物レンズ25を経由してCCDカメラ26に結像され、CCDカメラ26からのCCD信号は信号線27を経由して光学像のリアルタイム画像を生成する画像作成手段としての光学観察装置3へ出力される。

また、この硬性部21には音響的に撮像して画像信号としてエコー信号を取得する画像信号取得手段も、硬性部21に固定して設けてある。

硬性部21における例えば円柱状の先端部分は、短冊状に細かく切断され、挿入軸の周囲に環状でアレイ状に配列させた超音波振動子群が設けてあり、この超音波振動子群で超音波振動子アレイ29が形成されている。

超音波振動子アレイ29を構成する各超音波振動子29aはそれぞれ信号線30を介して操作部23経由で超音波によるリアルタイム画像を生成する画像作成手段としての超音波観測装置4と接続されている。超音波振動子アレイ29の環の中心は、後述するラジアル走査による超音波ビームの旋回中心である。

【0024】

ここで、硬性部21に固定された正規直交基底(各方向の単位ベクトル) V 、 V_3 、 V_{12} を図1のように定義する。

つまり、 V は硬性部21の長手方向(挿入軸方向)と平行で、後述するように、この V は超音波断層像の法線方向ベクトルとなる。このベクトル V に直交する V_3 は、3時方向ベクトル、そして V_{12} は、12時方向ベクトルである。

硬性部21内には、超音波振動子アレイ29に対する画像位置配向検出用素子としての

10

20

30

40

50

画像位置配向検出用コイル 3 1 が超音波振動子アレイ 2 9 の環の中心のごく近傍に固定して設けてある。画像位置配向検出用コイル 3 1 は、ベクトル V 及び V_3 の 2 つの方向（軸）を指向するように、2 軸方向に巻かれたコイルが一体に形成され、ベクトル V 及び V_3 の両方向を検出できるように設定されている。

【0025】

可撓部 2 2 内には、超音波内視鏡 2 における挿入部を構成するこの可撓部 2 2 の挿入形状を検出するため、挿入軸に沿って、例えば一定間隔で複数の挿入形状検出用コイル 3 2 が設けてある。

図 1 に示すように、挿入形状検出用コイル 3 2 は、1 軸方向に巻かれたコイルで、その巻線軸方向が可撓部 2 2 の挿入軸方向と一致するよう可撓部 2 2 内部に固定されている。10

なお、硬性部 2 1 は、上記画像位置配向検出用コイル 3 1 の位置から検出できる。

従って、挿入形状検出用素子は、より正確には硬性部 2 1 内に設けた画像位置配向検出用コイル 3 1 と可撓部 2 2 内に設けられた挿入形状検出用コイル 3 2 とから構成される。

なお、挿入形状を検出するための挿入形状検出用素子としての複数の挿入形状検出用コイル 3 2 は、例えば可撓部 2 2 の先端側部分のみに設け、超音波内視鏡 2 の挿入部の先端側部分の挿入形状を検出するようにしても良い。

【0026】

本実施例においては、挿入形状検出用素子として複数の挿入形状検出用コイル 3 2 を採用することにより、磁場を利用して挿入形状の検出を行う。これにより、挿入形状検出のために、術者及び患者（被検体）が放射線被爆を受けないようにできる。20

可撓部 2 2 の先端付近には、湾曲自在の湾曲部が設けられることが多く、この湾曲部付近のみに複数の挿入形状検出用コイル 3 2 を設けるようにしても良い。

画像位置配向検出用コイル 3 1 の位置及び配向等を検出する検出手段を構成する位置配向算出装置 5 は、送信アンテナ 6 と、A / D ユニット部 9 を構成する複数の A / D ユニット 9 a、9 b、9 c と、挿入形状作成手段、3 次元画像作成手段、合成手段、画像指標作成手段等を内蔵した画像処理装置 1 1 と信号線で接続されている。

このうち、位置配向算出装置 5 と画像処理装置 1 1 とは、例えば RS-232C 規格のケーブル 3 3 で接続されている。

送信アンテナ 6 は、巻線軸の配向の異なる複数の図示しない送信コイルにより構成され、これらの送信コイルは例えば直方体の筐体の中に一体に収納されている。複数の送信コイルは、それぞれ位置配向算出装置 5 に接続されている。30

【0027】

A / D ユニット 9 i (i = a ~ c) は、入力されるアナログ信号を増幅する図示しないアンプと、増幅された信号をサンプリングしてデジタルデータへ変換する図示しないアナログデジタル変換回路とからなる。

A / D ユニット 9 a は、画像位置配向検出用コイル 3 1 と、複数の挿入形状検出用コイル 3 2 の各々と、個別に信号線 3 4 で接続されている。

A / D ユニット 9 b は、長尺の体腔内接触プローブ 8 と信号線 3 5 で接続されている。

A / D ユニット 9 c は、複数の体表検出用コイル 7 の各々と個別に信号線 3 6 で接続されている。40

なお、図 1 及び後述する図 4 の各矢印線は以下の通りの信号、データの流れを示す。

【0028】

- (a) 第 1 : 点線は光学像に関わる信号・データの流れ、
- (b) 第 2 : 破線は超音波断層像に関わる信号・データの流れ、
- (c) 第 3 : 実線は位置に関わる信号・データやそれを加工して作成されたデータの流れ、
- (d) 第 4 : 一点鎖線は参照画像データやそれを加工して作成されたデータの流れ、
- (e) 第 5 : 太線は超音波断層像データ(後述)と、3 次元ガイド画像データ(後述)とを合成した最終的な表示画面に関わる信号・データの流れ、
- (f) 第 6 : 流曲線はそれ以外の制御に関わる信号・データの流れ。50

図 2 は被検体検出用素子を形成する体表検出用コイル 7 を示す。

【 0 0 2 9 】

体表検出用コイル 7 は、各々 1 軸方向に巻かれた 4 個のコイルからなり、各々のコイルがテープ、ベルト、バンドなどで、被検体 3 7 の体表、具体的には腹部体表の特徴のある点(以下、単に体表特徴点)に着脱可能に固定され、その体表特徴点の磁場を用いた位置検出に利用される。

通常の上部内視鏡検査では、被検体 3 7 は左側を下にしてベッド 3 8 上で横になるいわゆる左側臥位の姿勢をとって、内視鏡を口から挿入されるので、図 2 もその姿勢で描いている。

本実施例では体表特徴点を、骨格上の特徴のある箇所「剣状突起」(xiphoid process)、骨盤(pelvis)の左側の「左上前腸骨棘」(left anterior superior iliac spine)、骨盤の右側の「右上前腸骨棘」(right anterior superior iliac spine)、左右の上前腸骨棘の中間で脊椎上の「腰椎椎体棘突起」(spinous process of vertebral body)の 4 点にとって説明する。

【 0 0 3 0 】

この 4 点は術者が触診で位置を特定できる。また、この 4 点は同一平面状になく、剣状突起を原点として他の特徴点へ向かう 3 本のベクトルを基本ベクトルとする斜交座標系(u n-orthogonal reference frame)を形成する。この斜交座標系を図 2 に太い線で示す。

図 3 は体腔内接触プローブ 8 を示す。体腔内接触プローブ 8 は、可撓性のある材料で構成された外筒 4 1 を有する。この外筒 4 1 内におけるその先端には体腔内検出用コイル 4 2 が固定して設けられ、この外筒 4 1 の後端にはコネクタ 4 3 が設けてある。

図 3 に示すように、体腔内検出用コイル 4 2 は、1 軸方向に巻かれたコイルで、体腔内接触プローブ 8 の先端に固定されている。体腔内検出用コイル 4 2 は、その巻線軸方向が体腔内接触プローブ 8 の挿入軸方向と一致するように固定されている。そして、この体腔内検出用コイル 4 2 は、体腔内接触プローブ 8 の先端が接触された体腔内の関心部位等の位置検出に利用される。

【 0 0 3 1 】

図 1 に示すように、超音波内視鏡 2 は、操作部 2 3 から可撓部 2 2 を経て硬性部 2 1 にかけて、操作部 2 3 に第 1 の開口として、鉗子等を挿入する処置具挿入口(以下では、簡単化のため鉗子口と略記) 4 4 を備え、硬性部 2 1 に第 2 の開口としての突出口 4 5 を備えた、管状の処置具チャンネル 4 6 が設けてある。

この処置具チャンネル 4 6 は、体腔内接触プローブ 8 を鉗子口 4 4 から挿通し、突出口 4 5 から突出できるよう構成されている。突出口 4 5 の開口方向は、体腔内接触プローブ 8 が突出口 4 5 から突出したときに、体腔内接触プローブ 8 が光学観察窓 2 4 の光学視野範囲の内に入るよう向けられている。

図 4 は挿入形状作成手段、3 次元画像作成手段、合成手段、画像指標作成手段等を内蔵した画像処理装置 1 1 を示す。

【 0 0 3 2 】

画像処理装置 1 1 は、マッチング回路 5 1 と、画像指標作成回路 5 2 と、挿入形状作成回路 5 3 と、通信回路 5 4 と、参照画像記憶部 5 5 と、補間回路 5 6 と、3 次元人体画像作成回路 5 7 と、合成回路 5 8 と、回転変換回路 5 9 と、異なる 2 つの視線方向の 3 次元ガイド画像を作成する 3 次元画像作成回路 6 0 (以下、3 次元ガイド画像作成回路 A と 3 次元ガイド画像作成回路 B と記載)、混合回路 6 1 と、表示回路 6 2 と、制御回路 6 3 とを有する。

マッチング回路 5 1 には、挿入形状検出用素子等の位置及び配向を検出する検出手段を構成する位置配向算出装置 5 から出力される位置・配向データが入力される。

そして、このマッチング回路 5 1 は、後述するように直交座標軸 0-xyz において算出された位置・配向データを、所定の変換式に従って写像し、直交座標軸 0'-x'y'z' における新たな位置・配向データを算出する。

【 0 0 3 3 】

10

20

30

40

50

そして、マッチング回路 5 1 は、この新たな位置・配向データを、位置・配向写像データとして、画像指標データを作成する画像指標作成回路 5 2 と、挿入形状データを作成する挿入形状作成回路 5 3 とへ出力する。

通信回路 5 4 は、大容量で高速の通信モデムを内部に設けており、人体の 3 次元データを生成する X 線 3 次元ヘリカル CT 装置 1 5 と、3 次元 MRI 装置 1 6 とネットワーク 1 7 経由で接続されている。

参照画像記憶部 5 5 は、大容量のデータを保存できるハードディスクドライブ等からなる。参照画像記憶部 5 5 は、解剖学的な画像情報として、複数の参照画像データを記憶している。

【0034】

図 5 に示すように、参照画像データは、X 線 3 次元ヘリカル CT 装置 1 5 と、3 次元 MRI 装置 1 6 からネットワーク 1 7 経由で得られた被検体 3 7 の断層像のデータである。

本実施例では、以下、参照画像データを、被検体 3 7 の体軸(頭から足に抜ける軸)に垂直、0.5 mm ~ 数 mm ピッチ、一辺数十 cm の正方形の断層像のデータとする。

被検体 3 7 の断層像を得る場合、X 線 3 次元ヘリカル CT 装置 1 5 よりも 3 次元 MRI 装置 1 6 を多用することにより、被検体 3 7 が受ける X 線の被爆を低減ないしは解消できる。

図 5 の参照画像記憶部 5 5 内の参照画像データには説明の都合上、1 番から N 番までの番号が付されている。

ここで、図 5 のように、複数の参照画像データに対して固定した直交座標軸 $0' -x' y' z'$ とその正規直交基底(各軸方向の単位ベクトル) i', j', k' を、原点 $0'$ を 1 番の参照画像データの最も左下に定義して、参照画像データ上に定義する。

【0035】

図 4 に示すように補間回路 5 6 と合成回路 5 8 とは、それぞれボリュームメモリ VM を内蔵している。説明の都合上、以下、補間回路 5 6 に設けられたボリュームメモリ VM を補間メモリ 5 6 a、合成回路 5 8 に設けられたボリュームメモリを合成メモリ 5 8 a と呼ぶ。

ボリュームメモリ VM は、大容量のデータを格納することができるよう構成されている。ボリュームメモリ VM の一部の記憶領域にはボクセル空間が割り当てられている。図 6 に示すように、ボクセル空間は、直交座標軸 $0' -x' y' z'$ に対応したアドレスを持つメモリセル(以下、ボクセル)からなっている。

図 4 に示す 3 次元人体画像を作成する 3 次元人体画像作成回路 5 7 と回転変換を行う回転変換回路 5 9 は、輝度によるボクセルや画素の抽出、回転変換、相似変換、平行移動等の画像処理を高速に行う図示しない高速プロセッサを内蔵している。

【0036】

表示回路 6 2 は、その入力を切り替えるスイッチ 6 2 a を有する。スイッチ 6 2 a は、入力端子 と、入力端子 と、入力端子 と、1 個の出力端子を有する。入力端子 は、参照画像記憶部 5 5 と接続されている。入力端子 は、光学観察装置 3 の図示しない出力端子と接続している。入力端子 は、混合回路 6 1 と接続している。出力端子は、光学像、超音波断層像及び 3 次元ガイド画像等を表示する表示装置 1 4 と接続されている。

制御回路 6 3 は、画像処理装置 1 1 内の各部、各回路に指令が出力できるよう、各部、各回路とは図示しない信号線で接続されている。制御回路 6 3 は、超音波観測装置 4、マウス 1 2、キーボード 1 3 と制御線で直接接続されている。

図 1 に示すように、キーボード 1 3 は、体腔内特徴点指定キー 6 5 と、走査制御キー 6 6 と、表示切換キー 1 3 と、表示切換キー 1 3 と、表示切換キー 1 3 とが設けてある。

【0037】

表示切換キー 1 3 もしくは 1 3 もしくは 1 3 が押されると、制御回路 6 3 は、表示回路 6 2 へスイッチ 6 2 a を入力端子 もしくは もしくは へ切り換えるよう指令を出力する。スイッチ 6 2 a は、表示切換キー 1 3 が押されたときには入力端子 へ、表

10

20

30

40

50

示切換キー 13 が押されたときには入力端子 へ、表示切換キー 13 が押されたときには入力端子 へ切り換える。

上述した (a) 第 1 : から (f) 第 6 : までの信号、データに関して、順次説明する。(a) 点線で示す第 1 の光学像に関わる信号・データの流れに沿って、本実施例の作用を説明する。

硬性部 21 の図示しない照明光照射窓は、光学視野範囲側に照明光を照射する。CCD カメラ 26 は、光学視野範囲の物体を撮像し、光電変換して CCD 信号を光学観察装置 3 に出力する。

【0038】

光学観察装置 3 は、入力された CCD 信号を基にして光学視野範囲のリアルタイム画像のデータを作成し、このデータを光学像データとして画像処理装置 11 内の表示回路 62 のスイッチ 62a の入力端子 へ出力する。

(b) 第 2 の超音波断層像に関わる信号・データの流れに沿って、本実施例の作用を説明する。

術者が走査制御キー 66 を押すと、制御回路 63 は後述するラジアル走査の ON/OFF 制御を指令するための走査制御信号を超音波観測装置 4 へ出力する。

超音波観測装置 4 は、超音波振動子アレイ 29 を構成する超音波振動子 29a のうち、一部かつ複数の超音波振動子 29a を選択して、パルス電圧状の励起信号を送信する。

この一部かつ複数の超音波振動子 29a は、励起信号を受け取って媒体の疎密波である超音波に変換する。

【0039】

この際、超音波観測装置 4 は、各励起信号が各超音波振動子 29a に到着する時刻が異なるよう、各励起信号に遅延をかけている。この遅延は、各超音波振動子 29a が励起する超音波が被検体 37 内で重ね合わせられたときに一本の超音波ビームを形成するようにその値 (遅延量) が調整されている。

超音波ビームは、超音波内視鏡 2 外部へと照射され、被検体 37 内からの反射波が超音波ビームとは逆の経路を辿って各超音波振動子 29a へ戻る。

各超音波振動子 29a は反射波を電気的なエコー信号に変換して励起信号とは逆の経路で超音波観測装置 4 へ伝達する。

超音波観測装置 4 は、超音波ビームが、超音波振動子アレイ 29 の環の中心を含み、硬性部 21 および可撓部 22 に垂直な平面 (以下、ラジアル走査面) 内で旋回するよう、超音波ビームの形成に関与する複数の超音波振動子 29a を選択し直し、再び励起信号を送信する。このようにして超音波ビームの送信角度が変わっていく。これを反復的に繰り返すことにより、いわゆるラジアル走査が実現する。

【0040】

この際、超音波観測装置 4 は、超音波振動子 29a が反射波から変換したエコー信号から、超音波振動子アレイ 29 の 1 回のラジアル走査に対し、硬性部 21 の挿入軸に垂直な 1 枚のデジタル化した超音波断層像データをリアルタイム画像として作成し、画像処理装置 11 の混合回路 61 へ出力する。この際、超音波観測装置 4 は、超音波断層像データを正方形に加工して作成する。

このように本実施例においては、超音波観測装置 4 が超音波ビームの形成に関与する複数の超音波振動子 29a を選択し直し、再び励起信号を送信するため、正方形の超音波断層像の例えば 12 時方向は、超音波観測装置 4 が 12 時方向としてどの超音波振動子 29a を選択して励起信号を送信するかで決定される。

こうして、超音波断層像の法線方向ベクトル V 、3 時方向ベクトル V_3 、12 時方向ベクトル V_{12} が定義される。さらに、超音波観測装置 4 は、超音波断層像データを、法線方向ベクトル V の反対方向 $-V$ から観察した方向で作成する。

【0041】

超音波振動子アレイ 29 によるラジアル走査と、超音波観測装置 4 による超音波断層像データの作成と混合回路 61 への出力はリアルタイムに行われる。本実施例では、超音波

10

20

30

40

50

断層像がリアルタイム画像として生成される。

(c) 次に、第3の位置に関わる信号・データやそれを加工して作成されたデータの流に沿って、本実施例の作用を説明する。

位置配向算出装置5は、送信アンテナ6の図示しない送信コイルを励磁する。送信アンテナ6は、空間に交番磁場を張る。超音波による画像信号取得手段の位置及び配向(方向)を検出する画像位置配向検出用コイル31を構成するベクトル V と V_3 との方向に巻かれた巻線軸が互いに直交する2個のコイル及び可撓部22の挿入形状を検出する複数個の挿入形状検出用コイル32と、被検体検出用素子としての体腔内検出用コイル42及び体表検出用コイル7とは、それぞれ交番磁場を検出し、交番磁場を各々の位置電気信号に変換してA/Dユニット9a、9b、9cへ出力する。

10

【0042】

A/Dユニット9a、9b、9cは、位置電気信号をアンプで増幅し、アナログデジタル変換回路でサンプリングしてデジタルデータへ変換し、デジタルデータを位置配向算出装置5へ出力する。

次に、位置配向算出装置5は、A/Dユニット9aからのデジタルデータを基にして、画像位置配向検出用コイル31の位置とその直交する巻線軸の方向、つまりベクトル V と V_3 とを算出する。次に、位置配向算出装置5は、直交する巻線軸の方向のベクトル V と V_3 の外積 $V \times V_3$ を算出することで、残りの直交方向である12時方向のベクトル V_{12} を算出する。このようにして、位置配向算出装置5は直交する3方向、つまりベクトル V 、 V_3 、 V_{12} を算出する。

20

次に、位置配向算出装置5は、A/Dユニット9a~9cからのデジタルデータを基にして、複数個の挿入形状検出用コイル32の各々の位置と、体表検出用コイル7の各々の位置と、体腔内検出用コイル42の位置とを算出する。

【0043】

次に、位置配向算出装置5は、画像位置配向検出用コイル31の位置及び配向と、複数個の挿入形状検出用コイル32の各々の位置と、4個の体表検出用コイル7の各々の位置と、体腔内検出用コイル42の位置と、を位置・配向データとして画像処理装置11のマッチング回路51へ出力する。

次に位置・配向データの詳細を以下に述べる。

本実施例では図7のように原点0を送信アンテナ6上に定義して、術者が被検体37を検査する実際の空間上に直交座標軸0-xyzとその正規直交基底(各軸方向の単位ベクトル) i 、 j 、 k を定義する。

30

画像位置配向検出用コイル31の位置を $0''$ とする。画像位置配向検出用コイル31は超音波振動子アレイ29の環の中心のごく近傍に固定されているので位置 $0''$ は、ラジアル走査の中心かつ超音波断層像の中心に一致する。

【0044】

ここで、位置・配向データを以下のように定義する。

直交座標軸0-xyzにおける画像位置配向検出用コイル31の位置 $0''$ の位置ベクトル $00''$ の各方向成分：

$$(x_0, y_0, z_0)$$

40

直交座標軸0-xyzに対する画像位置配向検出用コイル31の配向を示すオイラー角(後述)の各角度成分：

$$(\quad, \quad, \quad)$$

直交座標軸0-xyzにおける複数個の挿入形状検出用コイル32の各々の位置ベクトルの各方向成分：

$$(x_i, y_i, z_i) \quad (i \text{ は } 1 \text{ から挿入形状検出用コイル } 32 \text{ の総数までの自然数})$$

直交座標軸0-xyzにおける4個の体表検出用コイル7の各々の位置ベクトルの各方向成分：

$$(x_a, y_a, z_a), (x_b, y_b, z_b), (x_c, y_c, z_c), (x_d, y_d, z_d)$$

直交座標軸0-xyzにおける体腔内検出用コイル42の位置ベクトルの各方向成分：

50

(x_p, y_p, z_p)

ここで、オイラー角とは、図7の直交座標軸0-xyzに、z軸の周りの回転、y軸の周りの回転、再びz軸の周りの回転をこの順で加えて、以下の通りに各軸の方向が一致するような角度である。

【0045】

回転後の $i = V_3$ 、回転後の $j = V_{12}$ 、回転後の $k = V$

は、最初のz軸の周りの回転角度、 はy軸の周りの回転角度、 は再びのz軸の周りの回転角度である。

図7のHは、位置0"からxy平面へ下ろした垂線と、xy平面との交点である。このオイラー角の各角度成分(, ,)が画像位置配向検出用コイル31の配向、すなわち超音波断層像データの配向に相当する。 10

マッチング回路51は、以下の第1と第2と第3と第4とのデータ群から、直交座標軸0-xyz上で表現された位置・配向を、直交座標軸0'-x'y'z'上で表現されたボクセル空間内の位置・配向へ写像する変換式を算出する。

この算出の方法は後述する。また、下記第1と第2で説明する位置・配向データは、被検体37の体動によって変化が生じる。変換式も被検体37の体動の変化とともに新たに作成される。この変換式の新たな作成も後述する。

【0046】

第1のデータ群は、位置・配向データのうち、被検体37の剣状突起、左上前腸骨棘、右上前腸骨棘、腰椎椎体棘突起の各々に取り付けられた体表検出用コイル7の直交座標軸0-xyz 20 zにおける位置ベクトルの各方向成分(x_a, y_a, z_a)、(x_b, y_b, z_b)、(x_c, y_c, z_c)、(x_d, y_d, z_d)。

図8は、これらに取り付けられた体表検出用コイル7を示す。

第2のデータ群は、位置・配向データのうち、直交座標軸0-xyzにおける体腔内検出用コイル42の位置ベクトルの各方向成分(x_p, y_p, z_p)。

図9において体腔内検出用コイル42を先端に固定して内蔵した体腔内接触プローブ8を太い点線で示す。

第3のデータ群は、1~N番までの参照画像データのいずれかの上の、剣状突起、左上前腸骨棘、右上前腸骨棘、腰椎椎体棘突起の各々について、これら各々から最も体表に近い画素の直交座標軸0'-x'y'z'における座標(x_a', y_a', z_a')、(x_b', y_b', z_b')、(x_c', y_c', z_c')、(x_d', y_d', z_d')。 30

【0047】

これらの画素は、予め術者が1~N番までの参照画像データのいずれかの上で指定する。この指定の方法は後述する。

図9は、これらの画素を黒丸 と白丸 とで示す。(x_a', y_a', z_a')、(x_b', y_b', z_b')、(x_c', y_c', z_c')、(x_d', y_d', z_d')は、図4に示すように体表特徴点座標として、参照画像記憶部55からマッチング回路51へ読み出される。

第4のデータ群は、1~N番までの参照画像データのいずれかの上の、十二指腸乳頭に相当する画素の直交座標軸0'-x'y'z'における座標(x_p'', y_p'', z_p'')。

これらの画素は、予め術者が1~N番までの参照画像データのいずれかの上で指定する 40

【0048】

この指定の方法は後述する。図9において、この画素をP"で示す。第4の画素の座標(x_p'', y_p'', z_p'')は、図4に示すように体腔内特徴点座標として、参照画像記憶部55からマッチング回路51へ読み出される。

次に、マッチング回路51は、直交座標軸0-xyzにおいて算出された位置・配向データを、上記変換式に従って写像し、直交座標軸0'-x'y'z'における新たな位置・配向データを算出する。

次に、マッチング回路51は、この新たな位置・配向データを、位置・配向写像データとして、画像指標作成回路52と挿入形状作成回路53とへ出力する。 50

画像指標作成回路 5 2 は、直交座標軸 0-xyz における画像位置配向検出用コイル 3 1 の位置 0" の位置ベクトル 00" の各方向成分 (x_0, y_0, z_0) と、直交座標軸 0-xyz に対する画像位置配向検出用コイル 3 1 の配向を示すオイラー角の各角度成分 (α, β, γ) との計 6 自由度の位置・配向写像データから画像指標データを作成し、合成回路 5 8 へ出力する。

【 0 0 4 9 】

この様子を図 1 0 に示す。つまり、図 1 0 の上側の位置・配向写像データから、図 1 0 の下側に示すように画像指標データが作成される。

この画像指標データは、平行四辺形の超音波断層像マーカ M u に、例えば青色の先端方向マーカ M d (図 1 0 中で青と表記) と黄緑色の矢印状の 6 時方向マーカ M t (図 1 0 中に黄緑と表記) とを合成した直交座標軸 0'-x'y'z' 上における画像データである。

10

挿入形状作成回路 5 3 は、画像位置配向検出用コイル 3 1 の位置 0" の位置ベクトル 00" の各方向成分 (x_0, y_0, z_0) と、直交座標軸 0-xyz における複数個の挿入形状検出用コイル 3 2 の各々の位置ベクトルの各方向成分 (x_i, y_i, z_i) との位置・配向写像データから、(補間及びマーカ作成処理により) 挿入形状データを作成し、合成回路 5 8 へ出力する。

この様子を図 1 1 に示す。挿入形状データは、画像位置配向検出用コイル 3 1 と複数個の挿入形状検出用コイル 3 2 の各々の位置を順につないで補間したひも状の挿入形状マーカ M s と、各コイル位置を示すコイル位置マーカ M c とを合成した直交座標軸 0'-x'y'z' 上における画像データである。

【 0 0 5 0 】

(d) 次に第 4 の参照画像データやそれを加工して作成されたデータの流れに沿って、本実施例の作用を説明する。

20

術者は事前に被検体 3 7 に X 線 3 次元ヘリカル C T 装置 1 5 や 3 次元 M R I 装置 1 6 で、被検体 3 7 の腹部全体にわたる参照画像データを取得する。

術者は、キーボード 1 3 の所定のキーを押すか、画面上のメニューをマウス 1 2 で選択して、参照画像データの取得を指示する。このとき同時に術者は、入手先も指示する。この指示により、制御回路 6 3 は、通信回路 5 4 に対して参照画像データの取り込みとその入手先を指令する。

例えば、入手先が X 線 3 次元ヘリカル C T 装置 1 5 であった場合には、通信回路 5 4 は、参照画像データとしてネットワーク 1 7 から複数枚の 2 次元 C T 画像を取り込み、参照画像記憶部 5 5 へ記憶させる。

30

【 0 0 5 1 】

X 線 3 次元ヘリカル C T 装置 1 5 で撮像する際には撮像前に X 線造影剤を被検体 3 7 の血管から注入し、大動脈 (aorta)、上腸間膜静脈 (superior mesenteric vein) 等の血管 (広義には脈管) や、血管を多く含む器官が 2 次元 C T 画像上、高輝度や中輝度で表示されるようにし、周囲の組織とは輝度差がつきやすくしておく。

また、例えば、入手先が 3 次元 M R I 装置 1 6 であった場合には、通信回路 5 4 は、参照画像データとしてネットワーク 1 7 から複数枚の 2 次元 M R I 画像を取り込み、参照画像記憶部 5 5 へ記憶させる。

3 次元 M R I 装置 1 6 で撮像する際には撮像前に核磁気共鳴の感度の高い M R I 用造影剤を被検体 3 7 の血管から注入し、大動脈、上腸間膜静脈等の血管や、血管を多く含む器官が 2 次元 M R I 画像上、高輝度や中輝度で表示されるようにし、周囲の組織とは輝度差がつきやすくしておく。

40

【 0 0 5 2 】

以下、術者が入手先として X 線 3 次元ヘリカル C T 装置 1 5 を選択した場合と 3 次元 M R I 装置 1 6 を選択した場合とは作用が同様であるので、入手先として X 線 3 次元ヘリカル C T 装置 1 5 を選択し、通信回路 5 4 が参照画像データとして複数枚の 2 次元 C T 画像を取り込んだ場合についてのみの作用を説明する。

図 5 は参照画像記憶部 5 5 へ記憶された参照画像データの例を示す。X 線造影剤の作用により、大動脈、上腸間膜静脈等の血管は高輝度に、膵臓 (pancreas) 等の末梢血管を多く含む器官は中輝度に、十二指腸 (duodenum) 等は低輝度に造影されている。

50

補間回路56は、参照画像記憶部55より1番からN番までの全ての参照画像データを読み出す。次に補間回路56は、読み出した参照画像データを補間メモリ56aのボクセル空間へ埋めていく。

【0053】

具体的には、参照画像データの各画素の輝度を、画素に対応するアドレスを持つボクセルへ出力していく。次に補間回路56は、隣接する参照画像データの輝度値を基に補間して、空いているボクセルをデータで埋めていく。このようにして、ボクセル空間内の全てのボクセルが参照画像データを基にしたデータ(以下、ボクセルデータ)で満たされる。

3次元人体画像作成回路57は、補間回路56から高輝度値のボクセル(主に血管)、中輝度値のボクセル(主に膵臓など末梢血管を多く含む器官)をそれぞれ輝度値域別に抽出し、輝度別に分類して着色する。

次に、3次元人体画像作成回路57は、抽出したボクセルを3次元人体画像データとして合成回路58の合成メモリ58aのボクセル空間へ埋めていく。このとき、3次元人体画像作成回路57は、抽出したボクセルの補間メモリ56a内のボクセル空間のアドレスと、合成メモリ58a内のボクセル空間のアドレスとが同じになるように埋めていく。

【0054】

図12は3次元人体画像データの例を示す。図12に示す例では3次元人体画像データは、高輝度の血管である大動脈と上腸間膜静脈、中輝度の器官である膵臓とが抽出されたものであり、血管は赤、膵臓は緑で着色され、被検体37の頭側を右側に足側を左側にし、腹側から観察した3次元データとして示されている。

3次元人体画像作成回路57は、臓器や血管等を抽出する抽出手段の機能も持つ。なお、この抽出手段を3次元ガイド画像作成回路A、B側に設けるようにしても良い。そして、3次元ガイド画像作成回路A、B側においても3次元ガイド画像を作成する際、臓器や血管を選択できるようにしても良い。

【0055】

合成回路58は、画像指標データと、挿入形状データとを合成メモリ58a内のボクセル空間に埋めていく。この様子は図13に示してある。

図13においては説明の都合上、ボクセル空間に存在する3次元人体画像データを省略している(3次元人体画像データを省略しない場合は図14等で示す)。このようにして、合成回路58は、同じボクセル空間内に3次元人体画像データと、画像指標データと、挿入形状データとを同じ合成メモリ内に埋めていくことで、これらを一組のデータ(以下、合成3次元データ)として合成する。

【0056】

回転変換回路59は、合成3次元データを読み出し、制御回路63からの回転指示信号に従って、合成3次元データに対して回転処理を施す。

3次元ガイド画像作成回路Aは、合成3次元データに陰面消去、陰影付け等のレンダリング処理を施し、画面に出力可能な画像データ(以下、3次元ガイド画像データ)を作成する。

3次元ガイド画像データのデフォルトの向きは、人体の腹側からの向きとする。従って、3次元ガイド画像作成回路Aは、被検体37の腹側からの方向で観察した3次元ガイド画像データを作成する。なお、3次元ガイド画像データのデフォルトの向きとしては、人体の腹側からの向きとしているが、背側からの向きの3次元ガイド画像データを作成するようにしても良い。また、その他の方向からの3次元ガイド画像データを作成するようにしても良い。

この3次元ガイド画像作成回路Aは、被検体腹側から観察した3次元ガイド画像データを混合回路61へ出力する。この3次元ガイド画像データを図14に示す。図14の右側が被検体頭側、左側が被検体足側である。

【0057】

図14の3次元ガイド画像データでは、画像指標データのうちの超音波断層像マーカMuを半透明にして、画像指標データの6時方向マーカMtと先端方向マーカMdと、挿入

10

20

30

40

50

形状データの挿入形状マーカ M_s とコイル位置マーカ M_c とが透けて見えるようにしている。

その他の臓器に対しては超音波断層像マーカ M_u を不透明にして超音波断層像マーカ M_u の裏側の部分は見えないようにしている。図 14 では、超音波断層像マーカ M_u の裏側にあり、かつ超音波断層像マーカ M_u と重なる各マーカは破線で示してある。

3次元ガイド画像作成回路 B は、回転処理を加えられた合成3次元データに陰面消去、陰影付け等のレンダリング処理を施し、画面に出力可能な3次元ガイド画像データを作成する。

【0058】

本実施例では1例として、術者のマウス12、キーボード13からの入力により、制御回路63からの回転指示信号が3次元ガイド画像データを90度回転させ、足側から観察する指示内容になっていたものとする。 10

従って、3次元ガイド画像作成回路 B は被検体足側からの方向で観察した3次元ガイド画像データを作成する。

3次元ガイド画像作成回路 B は、被検体足側から観察した3次元ガイド画像データを混合回路61へ出力する。この3次元ガイド画像データを図15に示す。図15の右側が被検体右側、左側が被検体左側である。

図15の3次元ガイド画像データでは、画像指標データのうちの超音波断層像マーカ M_u を半透明にして、画像指標データの6時方向マーカ M_t と先端方向マーカ M_d と、挿入形状データの挿入形状マーカ M_s とコイル位置マーカ M_c とが透けて見えるようにしている。 20

【0059】

その他の臓器に対しては超音波断層像マーカ M_u を不透明にして超音波断層像マーカ M_u の裏側の部分は見えないようにしている。図15では、超音波断層像マーカ M_u の裏側にあり、かつ超音波断層像マーカ M_u と重なる各マーカは破線で示してある。

なお、図15における超音波断層像マーカ M_u の表示は、超音波断層像マーカ M_u の法線が観察視線すなわち表示装置14の画面法線と一致するように正対させる場合でない、つまり非正対の表示である。

(e)次に第5の超音波断層像データと、3次元ガイド画像データとを合成した最終的な表示画面に関わる信号・データの流れに沿って、本実施例の作用を説明する。 30

図4の混合回路61は、超音波観測装置4からの超音波断層像データと、3次元ガイド画像作成回路Aからの被検体37を腹側から観察した3次元ガイド画像データと、3次元ガイド画像作成回路Bからの被検体37を足側から観察した3次元ガイド画像データとを並べて表示用の混合データを作成する。

【0060】

表示回路62は、この混合データをアナログビデオ信号に変換して、表示装置14に出力する。

表示装置14は、このアナログビデオ信号を基に超音波断層像と被検体37を足側から観察した3次元ガイド画像と腹側から観察した3次元ガイド画像とを並べて対比可能に表示する。 40

図16に示すように、表示装置14は、3次元ガイド画像上で表現される各器官を、もとも参照画像データ上の輝度値に応じた色で器官別に色分けして表示する。

図16の表示例では、脾臓は緑、大動脈、上腸間膜静脈は赤で表示されている。図16では、超音波断層像マーカ M_u の裏側にあり、かつ超音波断層像マーカ M_u と重なる各マーカは破線で示してある。

また、図16で白抜きの矢印で示すように2つの3次元ガイド画像は、ラジアル走査面の移動に連動して移動する。

【0061】

(f)次に第6に制御に関わる信号・データの流れに沿って、本実施例の作用を説明する。

図4の画像処理装置11内のマッチング回路51と、画像指標作成回路52と、挿入形状作成回路53と、通信回路54と、参照画像記憶部55と、補間回路56と、3次元人体画像作成回路57と、合成回路58と、回転変換回路59と、3次元ガイド画像作成回路Aと、3次元ガイド画像作成回路Bと、混合回路61と、表示回路62とは、制御回路63からの指令により制御される。

制御の詳細は後述する。

以下、術者の使用形態に沿って、本実施例の画像処理装置11、キーボード13、マウス12、表示装置14の作用の全体を説明する。図17はその全体のフローチャートであり、ステップS1～S4の各処理はこの順序で実行される。

【0062】

最初のステップS1は参照画像データ上での体表特徴点、体腔内特徴点指定処理である。つまり、このステップS1において参照画像データ上で、体表特徴点と体腔内特徴点とを指定する処理が行われる。

次のステップS2において術者は、被検体37に体表検出用コイル7を固定する。術者は、被検体37をその左側を臥せた体位、所謂、左側臥位にする。術者は、被検体37を触診し、4つの体表特徴点である剣状突起、左上前腸骨棘、右上前腸骨棘、腰椎椎体棘突起に最も近い体表上の位置に体表検出用コイル7を固定する。

次のステップS3は補正值算出処理である。

このステップS3において画像処理装置11は、体腔内特徴点の位置・配向データを取得し、直交座標軸0-xyz上で表現された位置・配向データを直交座標軸0'-x'y'z'上で表現されたボクセル空間内の位置・配向写像データへ写像する変換式を算出し、さらに体腔内特徴点の位置・配向データから変換式の補正值を算出する処理を行う。

【0063】

次のステップS4において超音波断層像・3次元ガイド画像作成/表示処理が行われる。このステップS4は、超音波断層像と3次元ガイド画像を作成し、表示する処理である。

次に図17のステップS1の処理、つまり参照画像データ上での体表特徴点、体腔内特徴点指定処理を具体的に説明する。

図18は、図17のステップS1の参照画像データ上で、体表特徴点と体腔内特徴点とを指定する処理の詳細を示す。

最初のステップS1-1において、術者は表示切換キー13を押す。制御回路63は表示回路62に指令を出す。表示回路62のスイッチ62aは指令により入力端子に切り換わる。

次のステップS1-2において、術者は、マウス12、キーボード13を用い、1～N番までのいずれかの参照画像データを指定する。

【0064】

次のステップS1-3において、制御回路63は、表示回路62に参照画像記憶部55に記憶された1～N番までのいずれかの参照画像データのうち、指定された参照画像データを読み出させる。

表示回路62は、参照画像記憶部55からの参照画像データをアナログビデオ信号に変換し、参照画像データを表示装置14に出力する。表示装置14は参照画像データを表示する。

次のステップS1-4において、術者は、マウス12、キーボード13を用い、参照画像データ上で体表特徴点を指定する。具体的には以下の通りである。

術者は表示された参照画像データに被検体37の4つの体表特徴点である剣状突起、左上前腸骨棘、右上前腸骨棘、腰椎椎体棘突起のいずれかが写っているようにする。いずれも写っていなければステップS1-2へ戻り、術者は他の参照画像データを指定し直し、ステップS1-3で写っている参照画像データを表示させるまで、異なる参照画像データの表示を繰り返す。

【0065】

10

20

30

40

50

術者は、マウス 1 2、キーボード 1 3 を用い、表示された参照画像データ上で被検体 3 7 の体表面上の 4 点である剣状突起、左上前腸骨棘、右上前腸骨棘、腰椎椎体棘突起に最も近い体表上の点に相当する画素を指定する。

指定した点を図 8 と図 9 の黒丸 と白丸 とで示す。本実施例では説明の都合上、剣状突起 が n1 番 (1 ~ n1 ~ N) の参照画像データ上に写っており、左上前腸骨棘、右上前腸骨棘、腰椎椎体棘突起 が n2 番 (1 ~ n2 ~ N) の参照画像データ上に写っているものとして説明する。

図 8 と図 9 では説明の都合上、n2 番の参照画像データ上の剣状突起に相当する位置にで剣状突起を示している。

【 0 0 6 6 】

次のステップ S 1 - 5 において、術者は、マウス 1 2、キーボード 1 3 を用い、体腔内特徴点 P" を指定する。本実施例では体腔内特徴点 P" として十二指腸乳頭 (総胆管の十二指腸への開口部 : duodenal papilla) を例にあげて説明する。具体的には以下の通りである。

術者は、マウス 1 2、キーボード 1 3 を用い、1 ~ N 番までのいずれかの参照画像データを指定する。

制御回路 6 3 は、表示回路 6 2 に図示しない信号線を経由して参照画像記憶部 5 5 に記憶された 1 ~ N 番までのいずれかの参照画像データのうち、指定された参照画像データを読み出させる。

表示回路 6 2 は、読み出した参照画像データを表示装置 1 4 へ出力する。表示装置 1 4 はこの参照画像データを表示する。術者は表示された参照画像データに被検体 3 7 の体腔内特徴点である十二指腸乳頭が写っていなければ、他の参照画像データを指定し直し、写っている参照画像データを表示させるまで、異なる参照画像データの表示を繰り返す。

【 0 0 6 7 】

術者は、マウス 1 2、キーボード 1 3 を用い、表示された参照画像データ上で被検体 3 7 の体腔内の点である十二指腸乳頭に相当する画素を指定する。

指定した点を図 9 の P" で示す。本実施例では説明の都合上、十二指腸乳頭 P" が n2 番 (1 ~ n2 ~ N) の参照画像データ上に写っているものとして説明する。

次のステップ S 1 - 6 において、制御回路 6 3 は、ステップ S 1 - 4 で指定された各体表特徴点に相当する各画素とステップ S 1 - 5 で指定された体腔内特徴点 P" に相当する画素とについて、参照画像データ上でのアドレスからボクセル空間に張られた直交座標軸 0' - x' y' z' での座標を算出し、マッチング回路 5 1 へ出力する。

【 0 0 6 8 】

ステップ S 1 - 4 で指定された各体表特徴点に相当する各画素の直交座標軸 0' - x' y' z' での座標の算出値を (xa', ya', za')、(xb', yb', zb')、(xc', yc', zc')、(xd', yd', zd') とする。

ステップ S 1 - 5 で指定された体腔内特徴点に相当する画素直交座標軸 0' - x' y' z' での各座標の算出値を (xp", yp", zp") とする。

マッチング回路 5 1 はこの座標を記憶する。このステップ S 1 - 6 の終了後、図 1 7 のステップ S 2 に進む。そして、このステップ S 2 の処理の後、図 1 7 のステップ S 3 の補正值算出処理に進む。

図 1 9 は、ステップ S 3 の補正值算出処理の詳細を示す。上述したようにこのステップ S 3 は、体腔内特徴点の位置・配向データを取得し、直交座標軸 0-xyz 上で表現された位置・配向データを直交座標軸 0' - x' y' z' 上で表現されたボクセル空間内の位置・配向写像データへ写像する変換式を算出し、さらに体腔内特徴点の位置・配向データから変換式の補正值を算出する処理である。

【 0 0 6 9 】

ステップ S 3 の補正值算出処理が開始すると、最初のステップ S 3 - 1 において、術者は、表示切換キー 1 3 を押す。この指示に対応して制御回路 6 3 は表示回路 6 2 に指令を出す。表示回路 6 2 のスイッチ 6 2 a は指令により入力端子 に切り換わる。

10

20

30

40

50

次にステップ S 3 - 2 において、表示回路 6 2 は、光学観察装置 3 からの光学像データをアナログビデオ信号に変換し、光学像を表示装置 1 4 に出力する。表示装置 1 4 は、光学像を表示する。

次のステップ S 3 - 3 において、術者は、被検体 3 7 に超音波内視鏡 2 の硬性部 2 1 と可撓部 2 2 とを体腔内へ挿入する。

次のステップ S 3 - 4 において、術者は、光学像を観察しながら硬性部 2 1 を動かして体腔内特徴点を探す。術者は、体腔内特徴点が見つかった後、硬性部 2 1 を体腔内特徴点近傍へ移動する。

【 0 0 7 0 】

次のステップ S 3 - 5 において、術者は、光学像を観察しながら、体腔内接触プローブ 8 を鉗子口 4 4 から挿入し、突出口 4 5 から突出させる。そして、術者は、光学像視野下で体腔内接触プローブ 8 の先端を体腔内特徴点に接触させる。 10

この様子を図 2 0 に示す。図 2 0 では表示画面に光学像が表示されている。光学像には体腔内特徴点の例として十二指腸乳頭 P と体腔内接触プローブ 8 とが表示されている。

次のステップ S 3 - 6 において、術者は、体腔内特徴点指定キー 6 5 を押す。

次のステップ S 3 - 7 において、制御回路 6 3 は、マッチング回路 5 1 に指令を出す。マッチング回路 5 1 は、指令により位置配向算出装置 5 から位置・配向データを取り込み、記憶する。この位置・配向データには、前述の通り以下の 2 種類のデータが含まれている。

【 0 0 7 1 】

直交座標軸 0-xyz における 4 個の体表検出用コイル 7 の各々の位置ベクトルの各方向成分、すなわち、この場合は 4 個の体表特徴点の直交座標軸 0-xyz での座標： (x_a, y_a, z_a) 、 (x_b, y_b, z_b) 、 (x_c, y_c, z_c) 、 (x_d, y_d, z_d) 。 20

直交座標軸 0-xyz における体腔内検出用コイル 4 2 の位置ベクトルの各方向成分、すなわち、この場合は体腔内特徴点の直交座標軸 0-xyz での座標： (x_p, y_p, z_p) 。

次のステップ S 3 - 8 において、マッチング回路 5 1 は体表特徴点の座標から第 1 の写像を表現する第 1 変換式を作成する。具体的には以下の通りである。

まず、マッチング回路 5 1 は、以下の内容を記憶している。

【 0 0 7 2 】

第 1 にステップ S 1 で指定された各体表特徴点に相当する各画素のボクセル空間内の直交座標軸 0' -x' y' z' での各座標： 30

(x_a', y_a', z_a') 、 (x_b', y_b', z_b') 、 (x_c', y_c', z_c') 、 (x_d', y_d', z_d')

第 2 にステップ S 1) で指定された体腔内特徴点に相当する画素のボクセル空間内の直交座標軸 0' -x' y' z' での座標：

(x_p'', y_p'', z_p'')

第 3 にステップ S 3 - 7 で取り込まれた体表特徴点の直交座標軸 0-xyz での各座標：

(x_a, y_a, z_a) 、 (x_b, y_b, z_b) 、 (x_c, y_c, z_c) 、 (x_d, y_d, z_d)

第 4 にステップ S 3 - 7 で取り込まれた体腔内特徴点の直交座標軸 0-xyz での座標：

(x_p, y_p, z_p)

マッチング回路 5 1 は、このうち、第 3 の各座標 (x_a, y_a, z_a) 、 (x_b, y_b, z_b) 、 (x_c, y_c, z_c) 、 (x_d, y_d, z_d) と第 1 の各座標 (x_a', y_a', z_a') 、 (x_b', y_b', z_b') 、 (x_c', y_c', z_c') 、 (x_d', y_d', z_d') とから、直交座標軸 0-xyz 上の任意の点をボクセル空間内の直交座標軸 0' -x' y' z' の点への第 1 の写像を表現する第 1 変換式を作成する。この第 1 の写像と第 1 変換式とは以下の通り定義される。 40

【 0 0 7 3 】

図 8 に示すように、体表特徴点である剣状突起、左上前腸骨棘、右上前腸骨棘、腰椎椎体棘突起を用い、剣状突起から他の点へ向かう 3 本のベクトルを基本ベクトルとする、2 つの斜交座標系を被検体 3 7 上とボクセル空間内(図 8 では参照画像データとして表現されているが、これを補間して得たデータ空間内)とを仮想(設定)する。

第 1 の写像とは、「直交座標軸 0-xyz における任意点の、被検体 3 7 上の斜交座標系で 50

表現される座標」と、「直交座標軸 $0'-x'y'z'$ におけるこの任意点の写像後の点の、ボクセル空間内の斜交座標系で表現される座標」とが同じになるような、被検体37からボクセル空間への写像である。

また、第1変換式とは「任意点の直交座標軸 $0-xyz$ における座標」を「ボクセル空間内の第1の写像後の点の直交座標軸 $0'-x'y'z'$ における座標」へ変換する式である。

【0074】

例えば、図8に示すように、画像位置配向検出用コイル31の位置、すなわちラジアル走査の中心かつ超音波断層像の中心 $0''$ の第1の写像による写像後の点を Q' とする。

点 Q' の直交座標軸 $0'-x'y'z'$ における座標を $(x0',y0',z0')$ とする。第1変換式を用いると、点 $0''$ の直交座標軸 $0-xyz$ における座標 $(x0,y0,z0)$ は、点 Q' の直交座標軸 $0'-x'y'z'$ における座標 $(x0',y0',z0')$ へ変換される。 10

次のステップS3-9において、マッチング回路51は、図9に示すように、第1変換式により、体腔内特徴点 P をボクセル空間内の点 P' へ写像する。体腔内特徴点 P の直交座標軸 $0-xyz$ での座標は (xp,yp,zp) である。第1の写像後の点 P' の直交座標軸 $0'-x'y'z'$ での座標を (xp',yp',zp') と定義する。

次のステップS3-10において、マッチング回路51は、点 P' のボクセル空間内の直交座標軸 $0'-x'y'z'$ での座標を (xp',yp',zp') と、ステップS1で指定された体腔内特徴点に相当する点 P'' のボクセル空間内の直交座標軸 $0'-x'y'z'$ での座標 (xp'',yp'',zp'') とから、以下のようにベクトル $P'P''$ を算出する。

【0075】

$$P'P'' = (xp'',yp'',zp'') - (xp',yp',zp') = (xp'' - xp',yp'' - yp',zp'' - zp')$$

次のステップS3-11において、マッチング回路51は、ベクトル $P'P''$ を記憶する。

ベクトル $P'P''$ は後述する処理で第1変換式を補正して第2の変換式を作成するための補正值として作用する。このステップS3-11の終了後、次のステップS4に進む。

次にこのステップS4の超音波断層像・3次元ガイド画像作成/表示処理を説明する。

図21は、ステップS4の被検体37の実際の超音波断層像・3次元ガイド画像を作成し、表示する処理の詳細を示す。

ステップS4の処理が開始すると、最初のステップS4-1において、術者は表示切換キー13を押す。制御回路63は表示回路62に指令を出す。表示回路62のスイッチ62aは、この指令により入力端子に切り換わる。 30

次のステップS4-2において、術者は走査制御キー66を押す。

【0076】

次のステップS4-3において、制御回路63は走査制御信号を超音波観測装置4へ出力する。そして、超音波振動子アレイ29は、ラジアル走査を開始する。

次のステップS4-4において、制御回路63は混合回路61に指令を出す。混合回路61は、この指令により超音波観測装置4からのラジアル走査に応じて入力される超音波断層像データを逐次、取り込む。

次のステップS4-5において、制御回路63はマッチング回路51に指令を出す。マッチング回路51は、指令により位置配向算出装置5から位置・配向データを取り込み、記憶する。この取り込みは、瞬時に行われる。そのため、マッチング回路51は、ステップS4-4で混合回路61が超音波断層像データを取り込んだ瞬間の、以下のデータを含む、位置・配向データを取り込むことになる。 40

【0077】

直交座標軸 $0-xyz$ における画像位置配向検出用コイル31の位置、すなわちラジアル走査の中心かつ超音波断層像の中心 $0''$ の位置ベクトル $00''$ の各方向成分：

$$(x0,y0,z0)$$

直交座標軸 $0-xyz$ に対する画像位置配向検出用コイル31の配向、すなわち超音波断層像の配向を示すオイラー角の各角度成分：

$$(\quad , \quad , \quad)$$

直交座標軸 $0-xyz$ における複数個の挿入形状検出用コイル32の各々の位置ベクトルの 50

各方向成分：

(x_i, y_i, z_i) (i は1から挿入形状検出用コイル32の総数までの自然数)

直交座標軸0-xyzにおける4個の体表検出用コイル7の各々の位置ベクトルの各方向成分

：
 (x_a, y_a, z_a) 、 (x_b, y_b, z_b) 、 (x_c, y_c, z_c) 、 (x_d, y_d, z_d)

次のステップS4-6において、マッチング回路51は、ステップS4-5で取り込んだ位置・配向データのうち、直交座標軸0-xyzにおける4個の体表検出用コイル7の各々の位置ベクトルの各方向成分 (x_a, y_a, z_a) 、 (x_b, y_b, z_b) 、 (x_c, y_c, z_c) 、 (x_d, y_d, z_d) を用い、ステップS3)で記憶した第1変換式を更新する。

【0078】

次にマッチング回路51は、更新した第1変換式にステップS3で記憶したベクトル $P'P''$ による平行移動とを合わせて、第2の写像を表現する第2変換式を新たに作成する。

マッチング回路51は、第1変換式とベクトル $P'P''$ による平行移動とを合わせて第2の写像を表現する第2変換式を作成する。第2の写像の概念は、以下の通りである。

第2の写像 = 第1の写像 + ベクトル $P'P''$ による平行移動

ベクトル $P'P''$ による平行移動には以下に示す補正効果がある。ベクトル $P'P''$ は補正值として作用する。

第1の写像を「直交座標軸0-xyzにおける任意点の、被検体37上の斜交座標系で表現される座標」と、「直交座標軸0'-x'y'z'におけるこの任意点の写像後の点の、ボクセル空間内の斜交座標系で表現される座標」とが同じになるような、被検体37からボクセル空間への写像とした。

【0079】

理想的には、体腔内特徴点Pのボクセル空間内への第1の写像による写像点 P' と、ステップS1)で指定された体腔内特徴点に相当する点 P'' とは一致することが望ましい。しかし、実際には正確に一致させることが難しい。

この理由は、「直交座標軸0-xyzにおける任意点と、被検体37上の斜交座標系との空間的な位置関係」と「任意点に解剖学的に相当する直交座標軸0'-x'y'z'における点と、ボクセル空間内の斜交座標系との空間的な位置関係」とが種々の要因で完全に一致しないことにある。

本実施例で説明すると、第1の写像と第1変換式とを骨格上の特徴のある体表特徴点の各座標から求めたが、体腔内特徴点である十二指腸乳頭Pは骨格上の体表特徴点と常に同じ位置関係にあるとは限らないためである。

【0080】

この原因は主に、X線3次元ヘリカルCT装置15と3次元MRI装置16とは、通常仰臥位で撮像され、左側臥位での超音波内視鏡2検査の時とは体位が異なるため、被検体37内の諸器官は重力に従って変位することがあげられる。

そのため、第1の写像に補正值としてのベクトル $P'P''$ による平行移動を合わせて第2の写像とすることにより、体腔内特徴点Pの写像点はボクセル空間内で体腔内特徴点に相当する点 P'' に一致する。さらに、被検体37の他の点、例えば超音波断層像の中心 O'' も第2の写像により解剖学的に一層正確な一致をするのである。

次のステップS4-7において、マッチング回路51は、ステップS4-5で取り込んだ位置・配向データのうち、直交座標軸0-xyzにおける超音波断層像の中心 O'' の位置ベクトル $O''O''$ の各方向成分 (x_0, y_0, z_0) と、直交座標軸0-xyzに対する画像位置配向検出用コイル31の配向を示すオイラー角の各角度成分 (α, β, γ) と、直交座標軸0-xyzにおける複数個の挿入形状検出用コイル32の各々の位置ベクトルの各方向成分 (x_i, y_i, z_i) (i は1から挿入形状検出用コイル32の総数までの自然数)とを新たに作成した第2変換式を用いて、位置・配向写像データへ変換する。

【0081】

図8に示すように第1変換式では超音波断層像の中心 O'' はボクセル空間上の点 Q' へ写像されるが、本ステップで新たに作成した第2変換式を用いることにより、図9に示すよう

10

20

30

40

50

に超音波断層像の中心 $0''$ はボクセル空間上の点 Q'' へ写像される。 Q' と Q'' との差異を示すベクトル $Q'Q''$ は第2の写像における平行移動による補正分と一致するのでベクトル $P'P''$ と同じである。すなわち、以下の式が成立する。

$$Q'Q'' = P'P''$$

次のステップS 4 - 8において、画像指標作成回路5 2は、画像指標データを作成する。挿入形状作成回路5 3は、挿入形状データを作成する。

合成回路5 8は、3次元人体画像データと、画像指標データと、挿入形状データを合成し、合成3次元データを作成する。

回転変換回路5 9は合成3次元データに回転処理を施す。

【0082】

3次元ガイド画像作成回路Aと3次元ガイド画像作成回路Bとは、それぞれ3次元ガイド画像データを作成する。

上記それぞれの処理は前述の通りである。

次のステップS 4 - 9において、混合回路6 1は、超音波断層像データと3次元ガイド画像データとを並べて表示用の混合データを作成する。

表示回路6 2はこの混合データをアナログビデオ信号に変換する。

表示装置1 4は、このアナログビデオ信号を基に超音波断層像と被検体3 7を腹側から観察した3次元ガイド画像と足側から観察した3次元ガイド画像とを並べて図1 6のように表示する。

上記それぞれの処理は前述の通りである。

次のステップS 4 - 1 0において、制御回路6 3は、ステップS 4 - 4からステップS 4 - 9の間、術者が再び走査制御キー6 6を押すか否かを確認している。

【0083】

術者が再び走査制御キー6 6を押していた場合には、制御回路6 3は、ここで上記の処理を終了させ、ラジアル走査の制御OFFを指令するための走査制御信号を超音波観測装置4へ出力する。超音波振動子アレイ2 9はラジアル走査を終了する。

術者が再び走査制御キー6 6を押していなかった場合には、処理はステップS 4 - 4へジャンプする。

このようにして、ステップS 4 - 4からステップS 4 - 9で述べた処理を繰り返すことで、超音波振動子アレイ2 9が1回のラジアル走査をして超音波観測装置4が超音波断層像データを作成し、超音波断層像データが超音波観測装置4から混合回路6 1に入力するたびに、2つの新たな3次元ガイド画像が作成され、新たな超音波断層像とともに表示装置1 4の表示画面にリアルタイムに更新されつつ表示される。

【0084】

すなわち、図1 6に示すように、術者の可撓部2 2、硬性部2 1の用手的な操作に伴うラジアル走査面の移動に連動して、画像指標データ上の超音波断層像マーカ M_u と先端方向マーカ M_d と6時方向マーカ M_t と、挿入形状データ上の挿入形状マーカ M_s とコイル位置マーカ M_c とが3次元人体画像データ上を移動もしくは変形していく。

本実施例は以下の効果を有する。

本実施例は、超音波内視鏡2が、体腔内への挿入側に被検体3 7内の超音波断層像を作成するための信号を取得する超音波振動子アレイ2 9を固定して設けた硬性部2 1と、硬性部2 1より手前側に可撓部2 2とを設け、超音波振動子2 9 aが取得したエコー信号から被検体3 7内の超音波断層像を作成する超音波観測装置4を設け、画像位置配向検出用コイル3 1を硬性部2 1に対して空間的に位置を固定して設け、挿入形状検出用コイル3 2を可撓部2 2に沿って複数個設け、被検体3 7に接触可能な体表検出用コイル7を複数個設け、画像位置配向検出用コイル3 1の位置及び配向との6自由度と、複数個の挿入形状検出用コイル3 2の各位置と、体表検出用コイル7の位置もしくは配向とを検出し、位置・配向データとして出力する送信アンテナ6と位置配向算出装置5とを設け、超音波観測装置4が作成した被検体3 7内の超音波断層像の位置と配向とを示す超音波断層像マーカ M_u を作成する画像指標作成回路5 2を設け、合成回路5 8が、位置配向算出装置5が

10

20

30

40

50

出力した位置・配向データを基に、可撓部 2 2 の先端側の挿入形状と超音波断層像マーカ M u と 3 次元人体画像データとを合成し、被検体 3 7 に対する可撓部 2 2 と超音波断層像の位置および配向をガイドする 3 次元ガイド画像作成回路 A , B を設けた。

【 0 0 8 5 】

そのため、本実施例は、超音波内視鏡 2 の硬性部 2 1 と可撓部 2 2 の挿入形状と超音波断層像の方向とを放射線被曝の侵襲を少なく検出でき、両者を含んだ 3 次元ガイド画像を作成することができる。

また、本実施例においては、画像指標作成回路 5 2 が、超音波断層像マーカ M u に青色の先端方向マーカ M d と黄緑色の矢印状の 6 時方向マーカ M t とを合成した画像指標データを作成し、合成回路 5 8 が、同じボクセル空間内に 3 次元人体画像データと、画像指標データと、挿入形状データとを合成し、混合回路 6 1 が超音波観測装置 4 からの超音波断層像データと、3次元ガイド画像データとを並べて表示するための表示用の混合データを作成し、表示回路 6 2 はこの混合データをアナログビデオ信号に変換し、表示装置 1 4 はこのアナログビデオ信号を基に超音波断層像と 3 次元ガイド画像とを並べて表示するような構成及び作用をする。

【 0 0 8 6 】

そのため、本実施例は、超音波断層像と脾臓などの関心領域との位置関係をガイドすることができるとともに、消化管等の体腔壁に対して超音波内視鏡 2 のラジアル走査面と可撓部 2 2 と硬性部 2 1 とがどのような配向や形状になっているのかをガイドすることができる。

従って、術者はこれらの関係を視覚的に把握でき、関心領域に対する診断、処置等を容易に行うことが可能となる。

また、本実施例においては、マッチング回路 5 1 がステップ S 4 - 4 からステップ S 4 - 9 で述べた処理を繰り返し、混合回路 6 1 が超音波断層像データを取り込んだ瞬間の、位置・配向データを取り込み、第 1 変換式とベクトル P'P" による平行移動とを合わせて第 2 の写像を表現する第 2 変換式を新たに作成し、直交座標軸 0-xyz における超音波断層像の中心 0" の位置ベクトル 00" の各方向成分 (x0, y0, z0) と、直交座標軸 0-xyz に対する画像位置配向検出用コイル 3 1 の配向を示すオイラー角の各角度成分 (, ,) と、直交座標軸 0-xyz における複数個の挿入形状検出用コイル 3 2 の各々の位置ベクトルの各方向成分 (xi, yi, zi) (i は 1 から挿入形状検出用コイル 3 2 の総数までの自然数) とを、位置・配向写像データへ変換する処理を繰り返すような構成及び作用する。

【 0 0 8 7 】

そのため、本実施例は、超音波内視鏡 2 での検査中に被検体 3 7 の体位に変化が生じても、体表特徴点と臓器との位置関係が変化しない限り、超音波断層像、可撓部 2 2、硬性部 2 1 と、3次元ガイド画像上の超音波断層像マーカ M u、先端方向マーカ M d、6時方向マーカ M t、挿入形状マーカ M s とはそれぞれ解剖学的により正確に一致をするという効果がある。

また、X線 3次元ヘリカル CT 装置 1 5 と 3次元 MRI 装置 1 6 とは、通常仰臥位で撮像され、左側臥位での超音波内視鏡検査の時とは体位が異なるが、本実施例は、マッチング回路 5 1 が、第 1 の写像に補正值としてのベクトル P'P" による平行移動を合わせて第 2 の写像を表現する第 2 変換式を作成するような構成及び作用する。

従って、本実施例は、被検体 3 7 内の諸器官が X線 3次元ヘリカル CT 装置 1 5 と 3次元 MRI 装置 1 6 に比して左側臥位での超音波内視鏡検査の時に重力に従って変位しても、被検体 3 7 の点、例えば超音波断層像の中心 0" に第 2 の写像により解剖学的に一層正確な一致をする。そのため、3次元ガイド画像が超音波断層像を一層正確にガイドすることができる。

【 0 0 8 8 】

また、本実施例においては、3次元ガイド画像作成回路 A が、右側が被検体頭側、左側が被検体足側で、被検体 3 7 の腹側からの方向で観察した 3次元ガイド画像データを作成するよう構成、作用する。被検体 3 7 は、超音波内視鏡検査では通常左側臥位での体位で

10

20

30

40

50

検査される。

【0089】

本実施例では3次元ガイド画像も左側臥位で表示されるので、被検体37と3次元ガイド画像とを対比しやすく、術者は3次元ガイド画像がわかりやすい。従って、本実施例は術者による診断、処置等際の操作性を向上或いは適切に支援することができる。

【0090】

また、本実施例によれば、3次元ガイド画像作成回路Aと3次元ガイド画像作成回路Bとが互いに異なる方向に視線を設定した3次元ガイド画像を作成したため、超音波断層像と臓器などの関心領域との位置関係を複数の方向から、ガイドすることができるとともに、消化管等の体腔壁に対して、超音波断層像と超音波内視鏡2の可撓部22と硬性部21とがどのような配向や形状になっているのかを複数の方向からガイドすることができ、術者にはわかりやすい。

10

【0091】

(変形例)

本実施例では、処置具チャンネル46を備えた超音波内視鏡2と、処置具チャンネル46に挿通する体腔内接触プローブ8を設けて構成したが、構成はこれに限定されるものではない。

体腔内特徴点に対して光学観察窓24を経由して対物レンズ25の焦点が合い、体腔内接触プローブ8を用いずに硬性部21自体を体腔内特徴点に正確に接触できれば、硬性部21に固定して設けた画像位置配向検出用コイル31を体腔内接触プローブ8の体腔内検出用コイル42の代用にしても良い。

20

このとき、画像位置配向検出用コイル31は画像位置配向検出用素子としてだけでなく体腔内検出用素子としても作用する。

また、本実施例では、超音波プローブとして電子ラジアル走査型超音波内視鏡2を用いたが、従来技術の特開2004-113629号公報で開示されている体腔内プローブ装置のように、機械走査型超音波内視鏡でも、挿入軸の一方に超音波振動子群を扇状に設けた電子コンベックス走査型超音波内視鏡でも、カプセル型の超音波ゾンデでも良く、超音波の走査方式には限定されない。また光学観察窓24の無い超音波プローブでも良い。

【0092】

また、本実施例では、超音波内視鏡2の硬性部21において超音波振動子を短冊状に細かく切断し、挿入軸の周囲に環状アレイとして配列させたが、超音波振動子アレイ29は、360°全周に設けても、それより一部が欠けても良い。例えば270°や180°にわたる部分に超音波振動子アレイ29が形成されるようにしても良い。

30

また、本実施例では位置検出手段として送信アンテナ6と受信コイルとを用い、磁場で位置と配向とを検出するよう構成、作用させたが、送受は逆でも良い。磁場を利用して位置及び配向を検出することにより、簡単な構成で位置(配向)検出手段を形成できると共に、低コスト化、小型化することができる。

しかし、位置(配向)検出手段は、磁場を利用したものに限られるものでなく、加速度や他の手段で位置と配向とを検出するような構成及び作用をさせても良い。

また、本実施例では、原点0を送信アンテナ6上の特定の位置に設定するよう構成したが、送信アンテナ6と位置関係の変わらない他の場所に設定するよう構成しても良い。

40

【0093】

また、本実施例では、画像位置配向検出用コイル31を硬性部21に固定して設けているが、硬性部21と位置が固定(確定)されるのであれば、硬性部21の内部でなくとも良い。

また、本実施例では、3次元ガイド画像データ上の各器官を、器官別に色分けして表示されるよう構成したが、色分け(表示色の変更)の態様に限らず、輝度、明度、彩度等、他の態様を採用しても良い。例えば、器官別に輝度の値を変化させる等しても良い。

また、本実施例では、参照画像データとして、X線3次元ヘリカルCT装置15、3次元MRI装置16で撮像された複数枚の2次元CT画像や2次元MRI画像を用いるよう

50

構成、作用させたが、PET(Positron Emission Tomography)のような他のモダリティーを用いて事前取得した3次元画像データを用いても良い。また、体外から超音波を照射する方式の所謂、体外式の体腔内プローブ装置で事前取得した3次元画像データを用いても良い。

また、本実施例では、参照画像データとして、被検体37からX線3次元ヘリカルCT装置15等により撮像した画像データを用いるよう構成・作用したが、あらかじめ体格の似た性別の同じ他人の画像データを用いても良い。

【0094】

また、本実施例では、1軸方向に巻かれた4個のコイルからなる体表検出用コイル7を設け、各々を被検体体表にテープ、ベルト、バンドなどで、複数の体表特徴点に着脱可能に固定し、体表特徴点の位置・配向データを同時に得るよう構成したが、1個のコイル、例えば体腔内検出用コイル42に代えて、超音波内視鏡2による検査に先立ち、被検体37を左側臥位にした後、体腔内接触プローブ8の先端を複数の体表特徴点に順次接触させて体表特徴点の位置・配向データを順次に得るような構成及び作用にしても良い。

また、本実施例では、位置配向算出手段が、位置・配向データとして、体表検出用コイル7に関してはその位置を算出したが、位置の代わりに巻線軸の方向を算出してもよい。また、位置と巻線軸の方向との両方を算出しても良い。1個の体表検出用コイル7に関して位置配向算出装置5が算出する自由度が増えることで、体表検出用コイル7の個数を減らすことができ、被検体37に体表検出用コイル7を固定する際や超音波内視鏡検査中の術者や被検体37の負担を減らすことができる。

【0095】

また、本実施例では、体表特徴点を腹部体表の剣状突起、左上前腸骨棘、右上前腸骨棘、腰椎椎体棘突起とし、体腔内特徴点を十二指腸乳頭として説明したが、この例に限らず、胸部体表や胸部体腔内の特徴点や他の例でも良い。一般に、体表特徴点は骨格と関連のある点にとった方が、超音波断層像マーカMuの配向についての精度が良い。

また、本実施例では、術者のマウス12、キーボード13からの入力により、制御回路63からの回転指示信号が3次元ガイド画像データを90度回転させ、足側から観察する指示内容になっており、3次元ガイド画像作成回路Bは被検体足側からの方向で観察した3次元ガイド画像データを作成したが、この例に限らず、術者によるマウス12、キーボード13からの入力により、任意の軸、任意の角度で入力に対し3次元ガイド画像をリアルタイムに回転できるようにしても良い。

【実施例2】

【0096】

次に本発明の実施例2を説明する。本実施例の構成は実施例1と同じである。但し、実施例1とは3次元ガイド画像作成回路Bの作用のみが異なる。

次に本実施例の作用を説明する。

上述のように本実施例は、実施例1と3次元ガイド画像作成回路Bの作用のみが異なる。

実施例1では、図15に示すように、3次元ガイド画像作成回路Bは被検体足側からの方向で観察した3次元ガイド画像データを作成し、混合回路61へ出力した。

そして、術者による可撓部22、硬性部21の用手的な操作に伴うラジアル走査面の移動とともに、画像指標データ上の超音波断層像マーカMuと先端方向マーカMdと6時方向マーカMtと、挿入形状データ上の挿入形状マーカMsとコイル位置マーカMcとが3次元人体画像データ上を移動もしくは変形していった。

【0097】

本実施例では、図22に示すように、3次元ガイド画像作成回路Bは、位置・配向写像データを基にして、超音波断層像マーカMuの法線を観察視線すなわち表示装置14の画面法線と一致するよう画面に正対させ、かつ6時方向マーカMtが表示装置14の画面の下方向に向くように設定されたガイド画像を作成する。

図22の3次元ガイド画像データは、術者の可撓部22、硬性部21の用手的な操作に

伴うラジアル走査面の移動とともに、画像指標データ上の超音波断層像マーカM_uと先端方向マーカM_dと6時方向マーカM_tと、挿入形状データ上の挿入形状マーカM_sとコイル位置マーカM_cとは表示装置14の画面上で固定され、3次元人体画像データが表示装置14の画面上を移動していく。

図22の3次元ガイド画像データでは、画像指標データのうちの超音波断層像マーカM_uを半透明にして、画像指標データの6時方向マーカM_tと先端方向マーカM_dと、挿入形状データの挿入形状マーカM_sとコイル位置マーカM_cとが透けて見えるようにしている。

【0098】

その他の臓器に対しては超音波断層像マーカM_uを不透明にして超音波断層像マーカM_uの裏側の部分は見えないようにしている。 10

その他の作用は実施例1と同じである。

本実施例は以下の効果を有する。

本実施例によれば、3次元ガイド画像作成回路Bが、位置・配向写像データを基にして、超音波断層像マーカM_uの法線を観察視線すなわち表示装置14の画面法線と一致するよう画面に正対させ、かつ6時方向マーカM_tが表示装置14の画面の下方方向に向くように設定された3次元ガイド画像を作成するよう構成、作用させたため、この3次元ガイド画像と表示装置14の画面に並べてリアルタイムに表示される超音波断層像との方向が一致する。そのため術者は両者を対比しやすく、超音波断層像の解剖学的な解釈をしやすいく。 20

その他の効果は実施例1と同じである。

(変形例)

本実施例の変形例として、実施例1で説明した変形例を適用できる。

【実施例3】

【0099】

次に本発明の実施例3を説明する。

本実施例の構成は実施例2と同じである。本実施例は、実施例2とは3次元ガイド画像作成回路Bの作用のみが異なる。

次に本実施例の作用を説明する。

【0100】

上述のように本実施例の作用は、実施例2とは3次元ガイド画像作成回路Bの作用のみが異なる。 30

実施例2では、図22に示すように、3次元ガイド画像作成回路Bは、画像指標データのうちの超音波断層像マーカM_uを半透明にし、画像指標データの6時方向マーカM_tと先端方向マーカM_dと、挿入形状データの挿入形状マーカM_sとコイル位置マーカM_cとが透けて見えるようにし、その他の臓器に対しては超音波断層像マーカM_uを不透明にして超音波断層像マーカM_uの裏側の部分は見えないようにした3次元ガイド画像データを作成し、混合回路61へ出力した。

【0101】

本実施例では、図23に示すように、3次元ガイド画像作成回路Bは、画像指標データのうちの超音波断層像マーカM_uを半透明にする。また、3次元ガイド画像作成回路Bは、画像指標データの6時方向マーカM_tと先端方向マーカM_dと、挿入形状データの挿入形状マーカM_sとコイル位置マーカM_cとだけでなく、その他の臓器の超音波断層像マーカM_uの裏側の部分も透けて見えるようにし、それぞれ、超音波断層像マーカM_uの表側と裏側にある部分の輝度を変化させて3次元ガイド画像データを作成し、混合回路61へ出力する。 40

膵臓であれば、超音波断層像マーカM_uより表側(手前側)にある部分は濃緑、裏側にある部分は薄緑で作成する。血管であれば、超音波断層像マーカM_uより表側(手前側)にある部分は濃赤、裏側にある部分は薄赤で作成する。

図23では、超音波断層像マーカM_uの裏側にあり、かつ超音波断層像マーカM_uと重 50

なる各マーカと各器官とは破線で示してある。

その他の作用は実施例 2 と同じである。

【0102】

本実施例は以下の効果を有する。

本実施例によれば、3次元ガイド画像作成回路 B が、画像指標データのうちの超音波断層像マーカ M u を半透明にし、画像指標データの 6 時方向マーカ M t と先端方向マーカ M d と、挿入形状データの挿入形状マーカ M s とコイル位置マーカ M c とだけでなく、その他の臓器の超音波断層像マーカ M u の裏側の部分も透けて見えるようにし、それぞれ、超音波断層像マーカ M u の表側と裏側にある部分の輝度を变化させて 3 次元ガイド画像データを作成するような構成及び作用する。

10

そのため、術者には、可撓部 2 2 と硬性部 2 1 とをさらにどう動かしたら、患部等の関心領域を超音波断層像上に表示できるかわかりやすく、術者には、超音波内視鏡 2 の可撓部 2 2 と硬性部 2 1 との操作をしやすい。

【0103】

特に、胆嚢のように被検体 3 7 内部で柔らかく動きやすい臓器は超音波断層像マーカ M u 上には写っていないが、超音波断層像上には写らない可能性がある。本実施例の 3 次元ガイド画像は、術者がもう少し硬性部 2 1 と可撓部 2 2 とを動かせば胆嚢の超音波断層像上での描出ができるという目印になるため、術者には、超音波内視鏡 2 硬性部 2 1 と可撓部 2 2 との操作がしやすい。

その他の効果は実施例 2 と同じである。

20

(変形例)

本実施例では、画像指標データのうちの超音波断層像マーカ M u を半透明にし、画像指標データの 6 時方向マーカ M t と先端方向マーカ M d と、挿入形状データの挿入形状マーカ M s とコイル位置マーカ M c とだけでなく、その他の臓器の超音波断層像マーカ M u の裏側の部分も透けて見えるように構成及び作用させたが、その変形例として術者は、透明度をマウス 1 2 やキーボード 1 3 からの選択入力で自由に変更させることができるようにしても良い。

その他の変形例として、実施例 2 の変形例を適用できる。

【実施例 4】

【0104】

次に本発明の実施例 4 を説明する。本実施例は実施例 3 と同じ構成である。本実施例は、実施例 3 とは 3 次元ガイド画像作成回路 B の作用のみが異なる。

30

次に本実施例の作用を説明する。

上述のように本実施例の作用は、実施例 3 とは 3 次元ガイド画像作成回路 B の作用のみが異なる。

実施例 3 では、図 2 3 に示すように、3次元ガイド画像作成回路 B は、画像指標データのうちの超音波断層像マーカ M u を半透明にし、画像指標データの 6 時方向マーカ M t と先端方向マーカ M d と、挿入形状データの挿入形状マーカ M s とコイル位置マーカ M c とだけでなく、その他の臓器の超音波断層像マーカ M u の裏側の部分も透けて見えるようにし、それぞれ、超音波断層像マーカ M u の表側と裏側にある部分の輝度を变化させて 3 次元ガイド画像データを作成し、混合回路 6 1 へ出力した。

40

【0105】

膵臓であれば、超音波断層像マーカ M u より表側(手前側)にある部分は濃緑、裏側にある部分は薄緑で作成した。血管であれば、超音波断層像マーカ M u より表側(手前側)にある部分は濃赤、裏側にある部分は薄赤で作成した。

本実施例では、図 2 4 に示すように、3次元ガイド画像作成回路 B は、画像指標データのうちの超音波断層像マーカ M u によって分けられる 2 つの領域のうち、可撓部 2 2 の先端側すなわち表示装置 1 4 の画面手前側を非表示にし、超音波断層像マーカ M u 上の部分と、裏側の部分の輝度を变化させた 3 次元ガイド画像データを作成して、混合回路 6 1 へ出力する。

50

臓器であれば、超音波断層像マーカ M u 上にある部分は濃緑、裏側にある部分は薄緑で作成する。血管であれば、超音波断層像マーカ M u 上にある部分は濃赤、裏側にある部分は薄赤で作成する。

【0106】

その他の作用は実施例 3 と同じである。

本実施例は以下の効果を有する。

本実施例においては、3次元ガイド画像作成回路 B が、画像指標データのうちの超音波断層像マーカ M u によって分けられる 2 つの領域のうち、可撓部 22 の先端側すなわち表示装置 14 の画面手前側を非表示にし、超音波断層像マーカ M u 上の部分と、裏側の部分の輝度を変化させた 3次元ガイド画像データを作成するよう構成、作用させた。

10

そのため、本実施例によれば、手前側の臓器が術者の 3次元ガイド画像の観察の邪魔になることなく、この 3次元ガイド画像と表示装置 14 の画面に並べてリアルタイムに表示される超音波断層像との対比を一層しやすく、超音波断層像の解剖学的な解釈をしやすい。

その他の効果は、実施例 3 と同じである。

(変形例)

本実施例の変形例は、実施例 3 の変形例を適用できる。

【実施例 5】

【0107】

次に本発明の実施例 5 を説明する。本実施例の構成は実施例 1 と同じである。本実施例は、実施例 1 とは 3次元ガイド画像作成回路 B の作用のみが異なる。

20

次に本実施例の作用を説明する。

本実施例の作用は、上述したように実施例 1 とは 3次元ガイド画像作成回路 B の作用のみが異なる。

実施例 1 では、図 15 に示すように、3次元ガイド画像作成回路 B は、画像指標データのうちの超音波断層像マーカ M u を半透明にして、画像指標データの 6 時方向マーカ M t と先端方向マーカ M d と、挿入形状データの挿入形状マーカ M s とコイル位置マーカ M c とが透けて見えるようにし、その他の臓器に対しては超音波断層像マーカ M u を不透明にして超音波断層像マーカ M u の裏側の部分は見えないようにした 3次元ガイド画像データを作成し、混合回路 61 へ出力した。

30

【0108】

本実施例では、図 25 に示すように、3次元ガイド画像作成回路 B は、画像指標データのうちの超音波断層像マーカ M u を半透明にし、画像指標データの 6 時方向マーカ M t と先端方向マーカ M d と、挿入形状データの挿入形状マーカ M s とコイル位置マーカ M c とだけでなく、その他の臓器の超音波断層像マーカ M u の裏側の部分も透けて見えるようにし、それぞれ、超音波断層像マーカ M u の表側と裏側にある部分の輝度を変化させて 3次元ガイド画像データを作成し、混合回路 61 へ出力する。

臓器であれば、超音波断層像マーカ M u より先端方向マーカ M d 側にある部分は濃緑、反対側にある部分は薄緑で作成する。血管であれば、超音波断層像マーカ M u より先端方向マーカ M d 側にある部分は濃赤、反対側にある部分は薄赤で作成する。

40

その他の作用は実施例 1 と同じである。

本実施例は以下の効果を有する。

【0109】

本実施例によれば、3次元ガイド画像作成回路 B が、画像指標データのうちの超音波断層像マーカ M u を半透明にし、画像指標データの 6 時方向マーカ M t と先端方向マーカ M d と、挿入形状データの挿入形状マーカ M s とコイル位置マーカ M c とだけでなく、その他の臓器の超音波断層像マーカ M u の裏側の部分も透けて見えるようにし、それぞれ、超音波断層像マーカ M u の表側と裏側にある部分の輝度を変化させて 3次元ガイド画像データを作成するよう構成、作用させた。

そのため、術者には、可撓部 22 と硬性部 21 とをさらにどう動かしたら、患部等の関

50

心領域を超音波断層像上に表示できるかわかりやすく、超音波内視鏡 2 の操作をしやすい。

特に、胆嚢のように被検体 37 内部で柔らかく動きやすい臓器は超音波断層像マーカ M u 上には写っていないが、超音波断層像上には写らない可能性がある。本実施例の 3 次元ガイド画像は、術者がもう少し硬性部 21 と可撓部 22 とを動かせば胆嚢の超音波断層像上での描出ができる目印になるため、術者には、超音波内視鏡 2 の操作をしやすい。

その他の効果は実施例 1 と同じである。

【0110】

(変形例)

本実施例では、画像指標データのうちの超音波断層像マーカ M u を半透明にし、画像指標データの 6 時方向マーカ M t と先端方向マーカ M d と、挿入形状データの挿入形状マーカ M s とコイル位置マーカ M c とだけでなく、その他の臓器の超音波断層像マーカ M u の裏側の部分も透けて見えるように構成、作用させたが、その変形例として術者は、透明度をマウス 12 やキーボード 13 で自由に変更させることができるようにしても良い。

その他の変形例として実施例 1 の変形例を適用できる。

【実施例 6】

【0111】

次に本発明の実施例 6 を説明する。実施例 1 と異なる箇所のみ説明する。

実施例 1 の画像処理装置 11 では、硬性部 21 は、画像位置配向検出用コイル 31 を超音波振動子アレイ 29 の環の中心のごく近傍に固定して設けていた。

本実施例においては、硬性部 21 には、画像位置配向検出用コイル 31 が CCD カメラ 26 のごく近傍に固定して設けている。

画像位置配向検出用コイル 31 の固定されている向きは、実施例 1 と同じである。CCD カメラ 26 の光軸は、図 1 の V と V₁₂ とを含む平面内で、V に対し既知の角度に向いている。

図 26 は本実施例の画像処理装置 11 を示す。実施例 1 の画像処理装置 11 では、混合回路 61 は超音波観測装置 4 と接続されていた。本実施例では、混合回路 61 は、超音波観測装置 4 の代わりに、光学観察装置 3 と接続されている。

【0112】

その他の構成は実施例 1 と同じである。

次に本実施例の作用を説明する。

実施例 1 の画像処理装置 11 では、術者が入手先として X 線 3 次元ヘリカル CT 装置 15 を選択し、通信回路 54 が参照画像データとして複数枚の 2 次元 CT 画像を取り込み、図 5 に示すような参照画像データが参照画像記憶部 55 へ記憶された場合についての作用を説明した。例として X 線造影剤の作用により、大動脈、上腸間膜静脈等の血管は高輝度に、膵臓 (pancreas) 等の末梢血管を多く含む器官は中輝度に、十二指腸 (duodenum) 等は低輝度に造影されていた。

本実施例では、X 線 3 次元ヘリカル CT 装置 15 で胸部、特に気管、気管支、気管分枝を非造影で撮像した例で、気管支が 2 本の気管分枝、気管分枝 a と気管分枝 b とに分岐する箇所で超音波内視鏡 2 を気管分枝 a へ挿入する例を説明する。

【0113】

光学観察装置 3 は、光学像の 12 時方向 (上方向) を図 1 の V と V₁₂ とを含む平面へ V₁₂ の射影した方向と反対の方向にして光学像データを作成する。

3 次元人体画像作成回路 57 は、補間回路 56 から高輝度値のボクセル (主に気管、気管支、気管分枝の壁)、を抽出して着色する。次に、3 次元人体画像作成回路 57 は、抽出したボクセルを 3 次元人体画像データとして合成回路 58 の合成メモリ 58 a のボクセル空間へ埋めていく。

このとき、3 次元人体画像作成回路 57 は、抽出したボクセルの補間メモリ 56 a 内のボクセル空間のアドレスと、合成メモリ内のボクセル空間のアドレスとが同じになるように埋めていく。3 次元人体画像データは、高輝度の気管壁と気管支壁と気管分枝壁とが抽

10

20

30

40

50

出され、各壁は肌色で着色され、被検体頭側を右側に足側を左側にして腹側から観察した3次元データである。

【0114】

画像指標作成回路52は、直交座標軸0-xyzにおける画像位置配向検出用コイル31の位置0"の位置ベクトル00"の各方向成分(x0,y0,z0)と、直交座標軸0-xyzに対する画像位置配向検出用コイル31の配向を示すオイラー角の各角度成分(, ,)との計6自由度の位置・配向写像データから画像指標データを作成し、合成回路58へ出力する。

画像指標データは、光軸の方向を示すオレンジ色の光学像視野方向マーカと、光学像の12時方向を示す黄緑色の光学像up方向マーカとを合成した直交座標軸0'-x'y'z'上における画像データである。

10

挿入形状作成回路53は、実施例1と同様に、画像位置配向検出用コイル31の位置0"の位置ベクトル00"の各方向成分(x0,y0,z0)と、直交座標軸0-xyzにおける複数の挿入形状検出用コイル32の各々の位置ベクトルの各方向成分(xi,yi,zi)との位置・配向写像データから、挿入形状データを作成し、合成回路58へ出力する。

【0115】

この様子を図11に示す。挿入形状データは、画像位置配向検出用コイル31と複数の挿入形状検出用コイル32の各々の位置を順につないで補間したひも状の挿入形状マーカMsと各コイル位置を示すコイル位置マーカMcとを合成した直交座標軸0'-x'y'z'上における画像データである。

合成回路58は、画像指標データと、挿入形状データとを合成メモリ58a内のボクセル空間に埋めていく。このようにして、合成回路58は、同じボクセル空間内に3次元人体画像データと、画像指標データと、挿入形状データとを同じ合成メモリ58a内に埋めていくことで、これらを一組の合成3次元データとして合成する。

20

回転変換回路59は、合成3次元データを読み出し、制御回路63からの回転指示信号に従って、合成3次元データに回転処理を施す。

【0116】

3次元ガイド画像作成回路Aは、合成3次元データに陰面消去、陰影付け等のレンダリング処理を施し、画面に出力可能な3次元ガイド画像データを作成する。3次元ガイド画像データのデフォルトの向きは人体の腹側からの向きとする。

従って、3次元ガイド画像作成回路Aは、被検体37の腹側からの方向で観察した3次元ガイド画像データを作成する。3次元ガイド画像作成回路Aは、被検体腹側から観察した3次元ガイド画像データを混合回路61へ出力する。この3次元ガイド画像データを図27に示す。図27の右側が被検体頭側、左側が被検体足側である。

30

図27の3次元ガイド画像データでは、気管支の壁と、その先の気管分枝aと気管分枝bとの壁とを半透明にして、画像指標データの光学像視野方向マーカと光学像up方向マーカと、挿入形状データの挿入形状マーカMsとコイル位置マーカMcとが見えるようにしている。

【0117】

3次元ガイド画像作成回路Bは、回転処理を加えられた合成3次元データに陰面消去、陰影付け等のレンダリング処理を施し、画面に出力可能な3次元ガイド画像データを作成する。

40

本実施例では1例として、術者によるマウス12、キーボード13からの入力により、制御回路63からの回転指示信号が3次元ガイド画像データを90度回転させ、足側から観察する指示内容になっていたものとする。

従って、3次元ガイド画像作成回路Bは、被検体足側からの方向で観察した3次元ガイド画像データを作成する。3次元ガイド画像作成回路Bは被検体足側から観察した3次元ガイド画像データを混合回路61へ出力する。この3次元ガイド画像データを図28に示す。図28の右側が被検体右側、左側が被検体左側である。

【0118】

図28の3次元ガイド画像データでは、気管支の壁と、その先の気管分枝aと気管分枝b

50

との壁とを半透明にして、画像指標データの光学像視野方向マーカと光学像up方向マーカと、挿入形状データの挿入形状マーカM_sとコイル位置マーカM_cとが見えるようにしている。

混合回路61は、光学観察装置3からの光学像データと、3次元ガイド画像作成回路Aからの被検体37を腹側から観察した3次元ガイド画像データと、3次元ガイド画像作成回路Bからの被検体37を足側から観察した3次元ガイド画像データとを並べて表示用の混合データを作成する。

表示回路62はこの混合データをアナログビデオ信号に変換する。

表示装置14は、このアナログビデオ信号を基に光学像と被検体37を足側から観察した3次元ガイド画像と腹側から観察した3次元ガイド画像とを並べて表示する。

10

【0119】

図29に示すように、表示装置14は、3次元ガイド画像上で表現される気管支の壁と、気管分枝の壁とを肌色で表示する。

本実施例では、光学像がリアルタイム画像として処理される。

実施例1と同様、本実施例では、2つの新たな3次元ガイド画像が作成され、新たな光学像とともに表示装置14の表示画面にリアルタイムに更新されつつ表示される。すなわち、図29に示すように術者の可撓部22、硬性部21の用手的な操作に伴う光軸の移動に連動して、画像指標データの光学像視野方向マーカと光学像up方向マーカと、挿入形状データの挿入形状マーカM_sとコイル位置マーカM_cとが3次元人体画像データ上を移動もしくは変形していく。

20

その他の作用は実施例1と同じである。

本実施例は以下の効果を有する。

【0120】

本実施例によれば、気管支の壁と、その先の気管分枝aと気管分枝bとの壁とを半透明にして、画像指標データの光学像視野方向マーカと光学像up方向マーカと、挿入形状データの挿入形状マーカM_sとコイル位置マーカM_cとが見えるようにした3次元ガイド画像データを作成し、混合回路61と表示装置14とが、光学像と被検体37を腹側から観察した3次元ガイド画像と足側から観察した3次元ガイド画像とを並べて表示するよう構成、作用させた。

そのため、本実施例は、超音波内視鏡2（或いは以下の変形例で説明するように内視鏡）を気管分枝aへ挿入する際に誤って気管分枝bへ挿入することを防ぐことができる。

30

その他の効果は実施例1と同じである。

【0121】

ここでは、気管支の深部側に挿入する場合で説明したが、他の場合においても画像指標データの光学像視野方向マーカと光学像up方向マーカと、挿入形状データの挿入形状マーカM_sとコイル位置マーカM_cとが見えるように合成された3次元ガイド画像データを作成しているので、術者は体腔内プローブを体腔内に挿入して円滑な診断、処置を行うことができる。従って、術者が診断、処置を円滑に行い易い体腔内プローブ装置を実現できる。

【0122】

(変形例)

本実施例によれば、実施例1と同じく体腔内プローブとして光学観察系(光学観察窓24と、対物レンズ25と、CCDカメラ26と、図示しない照明光照射窓)を設けた電子ラジアル走査型の超音波内視鏡2を用いたが、体腔内プローブとして、超音波内視鏡2ではなく単に光学観察系を設けた内視鏡を用いても良い。

40

その他の変形例は実施例1における変形例を適用することができる。

なお、上述した各実施例等を部分的に組み合わせる等して構成される実施例等も本発明に属する。また、図4等において示した画像処理装置11のブロック構成を変更しても良い。

【0123】

50

[付記]

1. 被検体の体腔内へ挿入される体腔内プローブと、
 前記体腔内プローブの挿入形状を作成する挿入形状作成手段と、
 人体の3次元データから前記人体の3次元画像を作成する3次元画像作成手段と、
 前記挿入形状と、前記3次元画像とを合成する合成手段と、
 を備えた体腔内プローブ装置において、
 前記体腔内プローブは、前記体腔内への挿入側に前記被検体内の画像を作成するための
 信号を取得する画像信号取得手段を固定して設けた硬性部と、前記硬性部より手前側の可
 撓部とを具備し、
 前記画像信号取得手段が取得した信号から前記被検体内のリアルタイム画像を作成する 10
 画像作成手段と、
 前記硬性部に対して位置が固定された画像位置配向検出用素子と、
 前記可撓部に沿って複数個設けられた挿入形状検出用素子と、
 前記被検体に接触可能な被検体検出用素子と、
 前記画像位置配向検出用素子の位置と配向との6自由度と、前記複数個の挿入形状検出
 用素子の各位置と、前記被検体検出用素子の位置もしくは配向とを検出し、検出値として
 出力する検出手段と、
 前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像の位置と配向とを示
 す画像指標を作成する画像指標作成手段と、
 を具備し、 20
 前記合成手段が、前記検出手段が出力した検出値を基に、前記挿入形状と前記画像指標
 と前記3次元画像とを合成し、前記被検体に対する前記可撓部と前記リアルタイム画像の
 位置および配向をガイドする3次元ガイド画像を作成することを特徴とする体腔内プロ
 ーブ装置。

【 0 1 2 4 】

(付記 1 の効果)

体腔内プローブの挿入形状とリアルタイム画像の方向とを侵襲を少なく検出でき、両者
 を含んだガイド画像を作成することができる。
 また、リアルタイム画像と臓器などの関心領域との位置関係をガイドすることができる 30
 とともに、消化管や気管等の体腔壁に対して、リアルタイム画像と体腔内プローブと可撓
 部 2 2 と硬性部 2 1 とがどのような配向や形状になっているのかをガイドすることができ
 る。
 また、被検体に接触可能な被検体検出用素子を設けたため、体腔内プローブでの検査中
 に被検体の体位に変化が生じても、体表特徴点と臓器との位置関係が変化しない限り、リ
 アルタイム画像もしくは可撓部もしくは硬性部と、人体の3次元画像上の画像指標もしく
 は挿入形状とは解剖学的により正確に一致するようにできる。

【 0 1 2 5 】

8. 被検体の体腔内へ挿入され、前記体腔内への挿入側先端に前記被検体内の画像を作成
 するための信号を取得する画像信号取得手段を設けた体腔内プローブと、
 人体の3次元データから前記被検体内の前記リアルタイム画像の前記被検体に対する位 40
 置もしくは配向をガイドするガイド画像を作成するガイド画像作成手段と、
 を備えた体腔内プローブ装置において、
 前記画像信号取得手段が取得した信号から前記被検体内のリアルタイム画像を作成する
 画像作成手段と、
 前記画像信号取得手段に対して位置が固定された画像位置配向検出用素子と、
 前記被検体体表に接触可能な体表検出用素子と、前記被検体体腔内に接触可能な体腔内
 検出用素子と、からなる被検体検出用素子と、
 前記画像位置配向検出用素子の位置及び配向と、前記体表検出用素子の位置もしくは配
 向と、前記体腔内検出用素子の位置と、を検出し、検出値として出力する検出手段と、
 前記ガイド画像作成手段が、前記検出手段が出力した前記画像位置配向検出用素子の位 50

置及び配向と、前記体表検出用素子の位置もしくは配向の検出値を基に前記ガイド画像を作成する際、前記体腔内検出用素子の位置の検出値により前記ガイド画像に補正処理を施す補正手段と、

を具備することを特徴とする体腔内プローブ装置。

【0126】

(付記8の効果)

補正X線3次元ヘリカルCT装置と3次元MRI装置とは、通常仰臥位で撮像するように設定され、左側臥位での内視鏡検査の時とは体位が異なる。ガイド画像に体表検出用素子の位置もしくは配向の検出値を基にガイド画像を作成する際、体腔内検出用素子の位置の検出値によりガイド画像に補正処理を施したため、被検体内の諸器官がX線3次元ヘリカルCT装置と3次元MRI装置に比して左側臥位での内視鏡検査の時に重力に従って変位しても、被検体内の点の写像も解剖学的に一層正確な一致をする。そのため、ガイド画像は、リアルタイム画像を一層正確にガイドすることができる。

また、被検体に接触可能な被検体検出用素子を設けたため、体腔内プローブでの検査中に被検体の体位に変化が生じて、体表特徴点と臓器との位置関係が変化しない限り、リアルタイム画像もしくは可撓部もしくは硬性部と、人体の3次元画像上の画像指標もしくは挿入形状とは解剖学的により正確に一致するようにできる。

【0127】

9. 前記補正手段による前記補正処理は、前記3次元データ内での平行移動処理であることを特徴とする付記8に記載の体腔内プローブ装置。

10. 前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像の位置及び配向を示す画像指標を作成する画像指標作成手段を有し、

前記ガイド画像作成手段は、前記検出手段が出力した前記画像位置配向検出用素子の位置及び配向と、前記体表検出用素子の位置もしくは配向の検出値を基に、前記画像指標を合成したガイド画像を作成し、

前記補正手段による前記補正処理が、前記体腔内検出用素子の位置の検出値により前記画像指標を前記3次元データ内もしくは前記ガイド画像内で平行移動した位置で合成することで前記ガイド画像を作成する処理であることを特徴とする付記8に記載の体腔内プローブ装置。

【0128】

11. 前記体腔内プローブは管状のチャンネルを有し、

前記体腔内検出用素子を固定して内蔵した接触手段を有し、

前記接触手段は、前記チャンネルに挿通して前記被検体の前記体腔内の所定の位置に接触することを特徴とする付記8に記載の体腔内プローブ装置。

【0129】

12. 前記画像位置配向検出用素子は、前記体腔内検出用素子を兼ね、

前記補正手段は、前記画像位置配向検出用素子の位置もしくは配向の検出値により前記ガイド画像に補正処理を施すことを特徴とする付記8に記載の体腔内プローブ装置。

【0130】

13. 前記ガイド画像作成手段は、前記被検体から撮像された3次元データから臓器もしくは脈管を抽出する抽出手段を有し、

前記ガイド画像作成手段は、前記抽出手段が抽出した前記被検体の前記臓器もしくは前記脈管から、前記臓器もしくは前記脈管の形状と配置とを表現する3次元画像を作成し、前記3次元画像を基に前記ガイド画像を作成することを特徴とする付記8に記載の体腔内プローブ装置。

【0131】

14. 前記画像信号取得手段は、前記被検体内を撮像して映像信号を出力する撮像素子であり、

前記画像作成手段は、前記映像信号から前記リアルタイム画像として光学像を作成することを特徴とする付記8に記載の体腔内プローブ装置。

10

20

30

40

50

【 0 1 3 2 】

15. 前記画像信号取得手段は、前記被検体内に超音波を送受信してエコー信号を出力する超音波振動子であり、

前記画像作成手段は、前記エコー信号から前記リアルタイム画像として超音波断層像を作成することを特徴とする付記8に記載の体腔内プローブ装置。

【 0 1 3 3 】

16. 前記画像位置配向検出用素子と前記被検体検出用素子とは磁場発生器もしくは磁場検出器であり、

前記検出手段は、磁場を用いて前記検出を行うことを特徴とする付記8に記載の体腔内プローブ装置。

【 0 1 3 4 】

17. 被検体の体腔内へ挿入され、前記体腔内への挿入側先端に前記被検体内の画像を作成するための信号を取得する画像信号取得手段を設けた体腔内プローブと、

人体の3次元データから前記人体の3次元画像を作成する3次元画像作成手段と、

前記3次元画像を基に前記被検体内の前記リアルタイム画像の前記被検体に対する位置もしくは配向をガイドするガイド画像を作成するガイド画像作成手段と、
を備えた体腔内プローブ装置において、

前記画像信号取得手段が取得した信号から前記被検体内のリアルタイム画像を作成する画像作成手段と、

前記画像信号取得手段と位置関係を固定された画像位置配向検出用素子と、

前記被検体に接触可能な被検体検出用素子と、

前記画像位置配向検出用素子の位置と配向と、前記被検体検出用素子の位置もしくは配向とを検出し、検出値として出力する検出手段と、

前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像の位置と配向とを示す画像指標を作成する画像指標作成手段と、

前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像と、前記ガイド画像作成手段が作成した前記ガイド画像とを、対比可能に表示する表示手段と、

を具備し、

前記表示手段は、前記人体の前記3次元画像の頭側が右に、足側が左に、腹側が前記表示手段の画面手前の法線方向になるよう、前記ガイド画像を表示することを特徴とする体腔内プローブ装置。

【 0 1 3 5 】

(付記17の効果)

被検体は内視鏡検査では通常左側臥位での体位で検査される。ガイド画像も左側臥位で表示されるので、被検体とガイド画像とを対比しやすく、術者はガイド画像がわかりやすい。

また、被検体に接触可能な被検体検出用素子を設けたため、体腔内プローブでの検査中に被検体の体位に変化が生じても、体表特徴点と臓器との位置関係が変化しない限り、リアルタイム画像もしくは可撓部もしくは硬性部と、人体の3次元画像上の画像指標もしくは挿入形状とは解剖学的により正確に一致するようにできる。

【 0 1 3 6 】

18. 前記ガイド画像作成手段は、前記被検体から撮像された3次元データから臓器もしくは脈管を抽出する抽出手段を有し、

前記ガイド画像作成手段は、前記抽出手段が抽出した前記被検体の前記臓器もしくは前記脈管から、前記臓器もしくは前記脈管の形状と配置とを表現する3次元画像を作成し、前記3次元画像を基に前記ガイド画像を作成することを特徴とする付記17に記載の体腔内プローブ装置。

【 0 1 3 7 】

19. 前記画像信号取得手段は、前記被検体内を撮像して映像信号を出力する撮像素子であり、

10

20

30

40

50

前記画像作成手段は、前記映像信号から前記リアルタイム画像として光学像を作成することを特徴とする付記 17 に記載の体腔内プローブ装置。

【0138】

20. 前記画像信号取得手段は、前記被検体内に超音波を送受信してエコー信号を出力する超音波振動子であり、

前記画像作成手段は、前記エコー信号から前記リアルタイム画像として超音波断層像を作成することを特徴とする付記 17 に記載の体腔内プローブ装置。

【0139】

21. 前記画像位置配向検出用素子と前記被検体検出用素子とは磁場発生器もしくは磁場検出器であり、

前記検出手段は、磁場を用いて前記検出を行うことを特徴とする付記 17 に記載の体腔内プローブ装置。

【0140】

22. 被検体の体腔内へ挿入され、前記体腔内への挿入側先端に前記被検体内の画像を作成するための信号を取得する画像信号取得手段を設けた体腔内プローブと、

人体の 3 次元データから前記人体の 3 次元画像を作成する 3 次元画像作成手段と、

前記 3 次元画像を基に前記被検体内の前記リアルタイム画像の前記被検体に対する位置もしくは配向をガイドするガイド画像を作成するガイド画像作成手段と、

を備えた体腔内プローブ装置において、

前記画像信号取得手段が取得した信号から前記被検体内のリアルタイム画像を作成する画像作成手段と、

前記画像信号取得手段と位置関係を固定された画像位置配向検出用素子と、

前記被検体に接触可能な被検体検出用素子と、

前記画像位置配向検出用素子の位置と配向と、前記被検体検出用素子の位置もしくは配向とを検出し、検出値として出力する検出手段と、

前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像の位置と配向とを示す画像指標を作成する画像指標作成手段と、

を具備し、

前記ガイド画像作成手段は、前記検出手段が出力した検出値を基に、前記 3 次元画像と前記画像指標とを合成し、少なくとも 2 つの互いに異なる方向に視線を設定したガイド画像を作成することを特徴とする体腔内プローブ装置。

【0141】

(付記 22 の効果)

2 つの互いに異なる方向に視線を設定したガイド画像を作成したため、リアルタイム画像と臓器などの関心領域との位置関係を複数の方向から、ガイドすることができるとともに、消化管等の体腔壁に対して、リアルタイム画像と体腔内プローブの可撓部と硬性部とがどのような配向や形状になっているのかを複数の方向からガイドすることができ、術者にはわかりやすい。

また、被検体に接触可能な被検体検出用素子を設けたため、体腔内プローブでの検査中に被検体の体位に変化が生じて、体表特徴点と臓器との位置関係が変化しない限り、リアルタイム画像もしくは可撓部もしくは硬性部と、人体の 3 次元画像上の画像指標もしくは挿入形状とは解剖学的により正確に一致するようにできる。

【0142】

23. 前記ガイド画像作成手段は、少なくとも 2 つの互いに異なる方向に視線を設定したガイド画像を作成し、

かつ、少なくとも前記 2 つのガイド画像のうち 1 つの視線を被検体の腹側もしくは背側からの方向に設定し、

かつ、少なくとも前記 2 つのガイド画像のうち 1 つの視線を被検体の頭側もしくは足側からの方向に設定することを特徴とする付記 22 に記載の体腔内プローブ装置。

【0143】

10

20

30

40

50

24. 前記ガイド画像作成手段は、少なくとも2つの互いに異なる方向に視線を設定したガイド画像を作成し、

かつ、少なくとも2つの前記ガイド画像のうち、少なくとも1つのガイド画像の視線方向を変更するガイド画像回転手段を設けたことを特徴とする付記22に記載の体腔内プローブ装置。

【0144】

25. 前記ガイド画像作成手段は、前記被検体から撮像された3次元データから臓器もしくは脈管を抽出する抽出手段を有し、

前記ガイド画像作成手段は、前記抽出手段が抽出した前記被検体の前記臓器もしくは前記脈管から、前記臓器もしくは前記脈管の形状と配置とを表現する3次元画像を作成し、前記3次元画像を基に前記ガイド画像を作成することを特徴とする付記22ないし付記24のいずれか1つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0145】

26. 前記画像信号取得手段は、前記被検体内を撮像して映像信号を出力する撮像素子であり、

前記画像作成手段は、前記映像信号から前記リアルタイム画像として光学像を作成することを特徴とする付記22ないし24のいずれか1つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0146】

27. 前記画像信号取得手段は、前記被検体内に超音波を送受信してエコー信号を出力する超音波振動子であり、

前記画像作成手段は、前記エコー信号から前記リアルタイム画像として超音波断層像を作成することを特徴とする付記22ないし24のいずれか1つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0147】

28. 前記画像位置配向検出用素子と前記被検体検出用素子とは磁場発生器もしくは磁場検出器であり、

前記検出手段は、磁場を用いて前記検出を行うことを特徴とする付記22ないし24のいずれか1つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0148】

29. 被検体の体腔内へ挿入され、前記体腔内への挿入側先端に前記被検体内の画像を作成するための信号を取得する画像信号取得手段を設けた体腔内プローブと、

人体の3次元データから前記人体の3次元画像を作成する3次元画像作成手段と、

前記3次元画像を基に前記被検体内の前記リアルタイム画像の前記被検体に対する位置もしくは配向をガイドするガイド画像を作成するガイド画像作成手段と、

を備えた体腔内プローブ装置において、

前記画像信号取得手段が取得した信号から前記被検体内のリアルタイム画像を作成する画像作成手段と、

前記画像信号取得手段と位置関係を固定された画像位置配向検出用素子と、

前記被検体に接触可能な被検体検出用素子と、

前記画像位置配向検出用素子の位置と配向と、前記被検体検出用素子の位置もしくは配向とを検出し、検出値として出力する検出手段と、

前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像の位置と配向とを示す画像指標を作成する画像指標作成手段と、

を具備し、

前記ガイド画像作成手段は、前記検出手段が出力した検出値を基に前記3次元画像と前記画像指標とを合成し、視線を前記画像指標の法線と一致する方向になるよう設定された第1のガイド画像を作成することを特徴とする体腔内プローブ装置。

(付記29の効果)

第1のガイド画像とリアルタイム画像との方向が一致するため、術者は両者を対比しや

10

20

30

40

50

すく、リアルタイム画像の解剖学的な解釈をしやすい。

また、被検体に接触可能な被検体検出用素子を設けたため、体腔内プローブでの検査中に被検体の体位に変化が生じて、体表特徴点と臓器との位置関係が変化しない限り、リアルタイム画像もしくは可撓部もしくは硬性部と、人体の3次元画像上の画像指標もしくは挿入形状とは解剖学的により正確に一致するようにできる。

【0149】

30．前記ガイド画像作成手段は、前記第1のガイド画像の他に、視線を被検体の腹側もしくは背側からの方向、または、

被検体の頭側もしくは足側からの方向に設定された第2のガイド画像を作成することを特徴とする付記29に記載の体腔内プローブ装置。

【0150】

31．前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像と、前記ガイド画像作成手段が作成した前記第1のガイド画像とを、対比可能に表示する表示手段を有し

、
前記表示手段は、画面の法線と前記第1のガイド画像に合成された前記画像指標の法線とを一致させ、前記第1のガイド画像と前記被検体内の前記リアルタイム画像とを対比可能に表示することを特徴とする付記29に記載の体腔内プローブ装置。

【0151】

32．前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像と、前記ガイド画像作成手段が作成した前記第1のガイド画像とを、対比可能に表示する表示手段を有し

、
前記表示手段は、前記被検体内の前記リアルタイム画像と、前記ガイド画像作成手段が作成した前記第1のガイド画像の向きを一致させて対比可能に表示することを特徴とする付記31に記載の体腔内プローブ装置。

【0152】

33．前記ガイド画像作成手段は、前記3次元画像が前記画像指標によって分けられる2つの領域のうち、一方を非表示にして前記ガイド画像を作成することを特徴とする付記31又は32に記載の体腔内プローブ装置。

【0153】

34．前記ガイド画像作成手段は、前記3次元画像のうち前記画像指標上の部分の輝度もしくは明度もしくは彩度もしくは表示色をそれ以外の表示部分とは変化させて前記ガイド画像を作成することを特徴とする付記31又は32に記載の体腔内プローブ装置。

【0154】

35．前記ガイド画像作成手段は、前記第1のガイド画像の他に、視線を被検体の腹側もしくは背側からの方向、または、

被検体の頭側もしくは足側からの方向に設定された第2のガイド画像を作成し、

前記表示手段は、前記第1のガイド画像と前記第2のガイド画像とを同時もしくは順次もしくは切り替えて表示することを特徴とする付記31又は32に記載の体腔内プローブ装置。

【0155】

36．前記ガイド画像作成手段は、前記被検体から撮像された3次元データから臓器もしくは脈管を抽出する抽出手段を有し、

前記ガイド画像作成手段は、前記抽出手段が抽出した前記被検体の前記臓器もしくは前記脈管から、前記臓器もしくは前記脈管の形状と配置とを表現する3次元画像を作成し、前記3次元画像を基に前記ガイド画像を作成したことを特徴とする付記29ないし35のいずれか1つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0156】

37．前記画像信号取得手段は、前記被検体内を撮像して映像信号を出力する撮像素子であり、

前記画像作成手段は、前記映像信号から前記リアルタイム画像として光学像を作成する

10

20

30

40

50

ことを特徴とする付記 29 ないし 35 のいずれか 1 つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0157】

38. 前記画像信号取得手段は、前記被検体内に超音波を送受信してエコー信号を出力する超音波振動子であり、

前記画像作成手段は、前記エコー信号から前記リアルタイム画像として超音波断層像を作成することを特徴とする付記 29 ないし 35 のいずれか 1 つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0158】

39. 前記画像位置配向検出用素子と前記被検体検出用素子とは磁場発生器もしくは磁場検出器であり、

前記検出手段は、磁場を用いて前記検出を行うことを特徴とする付記 29 ないし 35 のいずれか 1 つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0159】

40. 被検体の体腔内へ挿入され、前記体腔内への挿入側先端に前記被検体内の画像を作成するための信号を取得する画像信号取得手段を設けた体腔内プローブと、

人体の 3 次元データから前記人体の 3 次元画像を作成する 3 次元画像作成手段と、

前記 3 次元画像を基に前記被検体内の前記リアルタイム画像の前記被検体に対する位置もしくは配向をガイドするガイド画像を作成するガイド画像作成手段と、

を備えた体腔内プローブ装置において、

前記画像信号取得手段が取得した信号から前記被検体内のリアルタイム画像を作成する画像作成手段と、

前記画像信号取得手段と位置関係を固定された画像位置配向検出用素子と、

前記被検体に接触可能な被検体検出用素子と、

前記画像位置配向検出用素子の位置と配向と、前記被検体検出用素子の位置もしくは配向とを検出し、検出値として出力する検出手段と、

前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像の位置と配向とを示す画像指標を作成する画像指標作成手段と、

を具備し、

前記ガイド画像作成手段は、前記検出手段が出力した検出値を基に前記 3 次元画像と前記画像指標とを合成し、前記 3 次元画像が前記画像指標によって分けられる 2 つの領域を、互いに表示態様を変化させて前記ガイド画像を作成することを特徴とする体腔内プローブ装置。

【0160】

(付記 40 の効果)

表示態様を変化させてガイド画像を作成するため、術者は、可撓部と硬性部とをさらにどう動かしたら、患部等の関心領域をリアルタイム画像上に表示できるかわかりやすく、体腔内プローブの可撓部と硬性部との操作をしやすい。

特に、胆嚢のように被検体内部で柔らかく動きやすい臓器は画像指標上には写っていないが、リアルタイム画像上には写らない可能性があるが、本構成によってガイド画像は、術者がもう少し硬性部と可撓部とを動かせば胆嚢のリアルタイム画像上での描出ができるという目印になるため、術者には、体腔内プローブの硬性部と可撓部との操作がしやすい。

また、被検体に接触可能な被検体検出用素子を設けたため、体腔内プローブでの検査中に被検体の体位に変化が生じてても、体表特徴点と臓器との位置関係が変化しない限り、リアルタイム画像もしくは可撓部もしくは硬性部と、人体の 3 次元画像上の画像指標もしくは挿入形状とは解剖学的により正確に一致するようにできる。

【0161】

41. 前記画像指標作成手段は、前記画像指標を透過可能にして作成することを特徴とする付記 40 に記載の体腔内プローブ装置。

10

20

30

40

50

42. 前記ガイド画像作成手段は、前記3次元画像が前記画像指標によって分けられる前記2つの領域を、互いに輝度もしくは明度もしくは彩度もしくは表示色を変化させて前記ガイド画像を作成することを特徴とする付記40又は41に記載の体腔内プローブ装置。

43. 前記ガイド画像作成手段は、前記被検体から撮像された3次元データから臓器もしくは脈管を抽出する抽出手段を有し、

前記ガイド画像作成手段は、前記抽出手段が抽出した前記被検体の前記臓器もしくは前記脈管から、前記臓器もしくは前記脈管の形状と配置とを表現する3次元画像を作成し、前記3次元画像を基に前記ガイド画像を作成することを特徴とする付記40ないし42のいずれか1つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0162】

44. 前記画像信号取得手段は、前記被検体内を撮像して映像信号を出力する撮像素子であり、

前記画像作成手段は、前記映像信号から前記リアルタイム画像として光学像を作成することを特徴とする付記40ないし42のいずれか1つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0163】

45. 前記画像信号取得手段は、前記被検体内に超音波を送受信してエコー信号を出力する超音波振動子であり、

前記画像作成手段は、前記エコー信号から前記リアルタイム画像として超音波断層像を作成することを特徴とする付記40ないし42のいずれか1つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0164】

46. 前記画像位置配向検出用素子と前記被検体検出用素子とは磁場発生器もしくは磁場検出器であり、

前記検出手段は磁場を用いて前記検出を行うことを特徴とする付記40ないし42のいずれか1つの付記に記載の体腔内プローブ装置。

【0165】

47. 被検体の体腔内へ挿入され、前記体腔内への挿入側先端に前記被検体内の画像を作成するための信号を取得する画像信号取得手段を設けた体腔内プローブと、

人体の3次元データから前記人体の3次元画像を作成する3次元画像作成手段と、

前記3次元画像を基に前記被検体内の前記リアルタイム画像の前記被検体に対する位置もしくは配向をガイドするガイド画像を作成するガイド画像作成手段と、

を備えた体腔内プローブ装置において、

前記画像信号取得手段が取得した信号から前記被検体内のリアルタイム画像を作成する画像作成手段と、

前記画像信号取得手段と位置関係を固定された画像位置配向検出用素子と、

前記被検体に接触可能な被検体検出用素子と、

前記画像位置配向検出用素子の位置と配向と、前記被検体検出用素子の位置もしくは配向とを検出し、検出値として出力する検出手段と、

前記画像作成手段が作成した前記被検体内の前記リアルタイム画像の位置と配向とを示す画像指標を作成する画像指標作成手段と、

を具備し、

前記ガイド画像作成手段は、前記検出手段が出力した検出値を基に前記3次元画像と前記画像指標とを合成し、前記3次元画像が前記画像指標によって分けられる2つの領域のうち、一方を非表示にして前記ガイド画像を作成することを特徴とする体腔内プローブ装置。

(付記47の効果)

画像指標によって分けられる2つの領域のうち、一方を非表示にしてガイド画像を作成したため、臓器が術者のガイド画像の観察の邪魔になることなく、このガイド画像とリアルタイム画像との対比を一層しやすい。

10

20

30

40

50

また、被検体に接触可能な被検体検出用素子を設けたため、体腔内プローブでの検査中に被検体の体位に変化が生じて、体表特徴点と臓器との位置関係が変化しない限り、リアルタイム画像もしくは可撓部もしくは硬性部と、人体の3次元画像上の画像指標もしくは挿入形状とは解剖学的により正確に一致するようにできる。

【0166】

48. 前記ガイド画像作成手段は、前記3次元画像のうち前記画像指標上の部分の輝度もしくは明度もしくは彩度もしくは表示色をそれ以外の表示部分とは変化させて前記ガイド画像を作成することを特徴とする付記47に記載の体腔内プローブ装置。

49. 前記ガイド画像作成手段は、前記被検体から撮像された3次元データから臓器もしくは脈管を抽出する抽出手段を有し、

前記ガイド画像作成手段は、前記抽出手段が抽出した前記被検体の前記臓器もしくは前記脈管から、前記臓器もしくは前記脈管の形状と配置とを表現する3次元画像を作成し、前記3次元画像を基に前記ガイド画像を作成することを特徴とする付記47に記載の体腔内プローブ装置。

【0167】

50. 前記画像信号取得手段は、前記被検体内を撮像して映像信号を出力する撮像素子であり、

前記画像作成手段は、前記映像信号から前記リアルタイム画像として光学像を作成することを特徴とする付記47に記載の体腔内プローブ装置。

51. 前記画像信号取得手段は、前記被検体内に超音波を送受信してエコー信号を出力する超音波振動子であり、

前記画像作成手段は、前記エコー信号から前記リアルタイム画像として超音波断層像を作成することを特徴とする付記47に記載の体腔内プローブ装置。

【0168】

52. 前記画像位置配向検出用素子と前記被検体検出用素子とは磁場発生器もしくは磁場検出器であり、

前記検出手段は磁場を用いて前記検出を行うことを特徴とする付記47に記載の体腔内プローブ装置。

【産業上の利用可能性】

【0169】

体腔内に屈曲自在に挿入される超音波内視鏡等の体腔内プローブにおける先端の硬性部に設けた画像信号取得手段により取得した画像をリアルタイム画像として表示する場合、そのリアルタイム画像の位置及び配向を表す3次元ガイド画像を、挿入形状と共に表示するようにして、術者が診断、治療を行い易くする。

【図面の簡単な説明】

【0170】

【図1】図1は本発明の実施例1の体腔内プローブ装置の全体構成図。

【図2】図2は体表検出用コイルを使用例で模式的に示す図。

【図3】図3は体腔内接触プローブを示す側面図。

【図4】図4は画像処理装置の構成を示すブロック図。

【図5】図5は参照画像記憶部内に記憶される参照画像データを示す説明図。

【図6】図6は、ボクセル空間を示す説明図。

【図7】図7は位置・配向データを表すために送信アンテナ上に原点を設定した直交基底を示す図。

【図8】図8は被検体側の超音波断層像の中心をボクセル空間へ写像する様子等を示す説明図。

【図9】図9は被検体側の体腔内特徴点をボクセル空間へ写像する様子等を示す説明図。

【図10】図10は画像指標作成回路により画像指標データが作成される様子を示す説明図。

【図11】図11は挿入形状作成回路により作成される挿入形状データが作成される様子

10

20

30

40

50

を示す説明図。

【図 1 2】図 1 2 は 3 次元人体画像データを示す説明図。

【図 1 3】図 1 3 は合成回路により画像指標データと挿入形状データとが合成メモリ内のボクセル空間に埋められていく様子を示す説明図。

【図 1 4】図 1 4 は被検体の腹側から観察した場合の 3 次元ガイド画像データを示す説明図。

【図 1 5】図 1 5 は被検体の足側から観察した場合の 3 次元ガイド画像データを示す説明図。

【図 1 6】図 1 6 は表示装置に表示される 3 次元ガイド画像及び超音波断層像を示す図。

【図 1 7】図 1 7 は本実施例の全体的な処理内容を示すフローチャート。

【図 1 8】図 1 8 は図 1 7 における参照画像上での体表特徴点、体腔内特徴点指定処理の具体的な処理内容を示すフローチャート。

【図 1 9】図 1 9 は図 1 7 における補正值算出処理の具体的な処理内容を示すフローチャート。

【図 2 0】図 2 0 は図 1 9 における処理の説明図。

【図 2 1】図 2 1 は図 1 7 における超音波断層像・3次元ガイド画像作成/表示処理の具体的な処理内容を示すフローチャート。

【図 2 2】図 2 2 は本発明の実施例 2 における 3 次元ガイド画像データを示す説明図。

【図 2 3】図 2 3 は本発明の実施例 3 における 3 次元ガイド画像データを示す説明図。

【図 2 4】図 2 4 は本発明の実施例 4 における 3 次元ガイド画像データを示す説明図。

【図 2 5】図 2 5 は本発明の実施例 5 における 3 次元ガイド画像データを示す説明図。

【図 2 6】図 2 6 は本発明の実施例 6 における画像処理装置の構成を示すブロック図。

【図 2 7】図 2 7 は 3 次元ガイド画像作成回路 A が生成する 3 次元ガイド画像データを示す説明図。

【図 2 8】図 2 8 は 3 次元ガイド画像作成回路 B が生成する 3 次元ガイド画像データを示す説明図。

【図 2 9】図 2 9 は表示装置に表示される 3 次元ガイド画像及び光学像を示す図。

【符号の説明】

【0 1 7 1】

1 ... 体腔内プローブ装置

2 ... 超音波内視鏡

3 ... 光学観察装置

4 ... 超音波観測装置

5 ... 位置配向算出装置

6 ... 送信アンテナ

7 ... 体表検出用コイル

8 ... 体腔内接触プローブ

9 ... A / D 変換ユニット部

1 1 ... 画像処理装置

1 4 ... 表示装置

1 5 ... X 線 3 次元ヘリカル CT 装置

2 1 ... 硬性部

2 2 ... 可撓部

2 6 ... CCD カメラ

2 9 ... 超音波振動子アレイ

3 1 ... 画像位置配向検出用コイル

3 2 ... 挿入形状検出用コイル

4 2 ... 体腔内検出用コイル

5 1 ... マッチング回路

5 2 ... 画像指標作成回路

10

20


30

40


50

- 5 3 ... 挿入形状作成回路
- 5 5 ... 参照画像記憶部
- 5 6 ... 補間回路
- 5 7 ... 3次元人体画像作成回路
- 5 8 ... 合成回路
- 5 9 ... 回転変換回路
- 6 0 ... 3次元ガイド画像作成回路 A , B
- 6 1 ... 混合回路
- 6 2 ... 表示回路
- 6 5 ... 体腔内特徴点指定キー
- 6 6 ... 走査制御キー


【 図 1 】

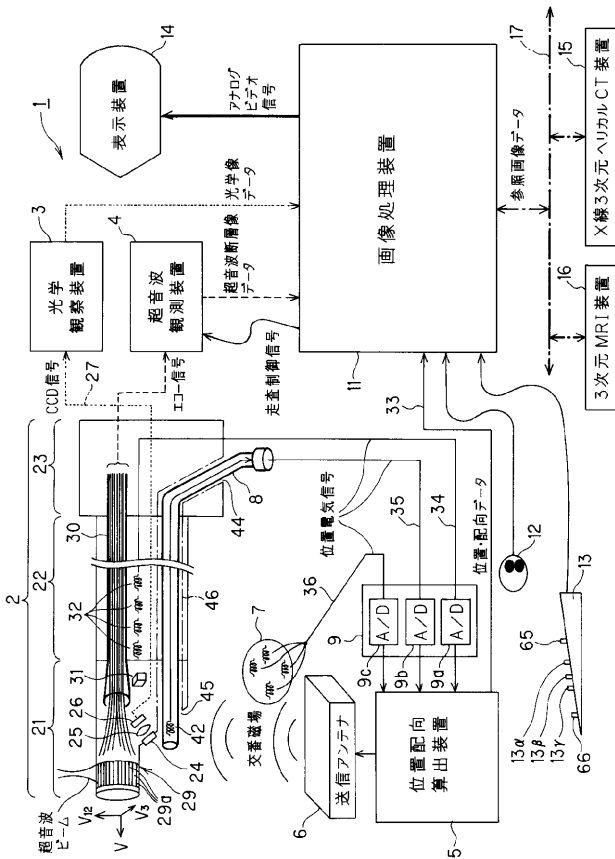


【 図 2 】

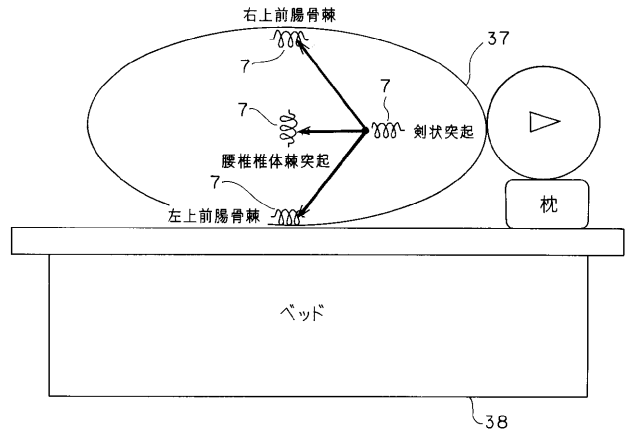


【 図 3 】

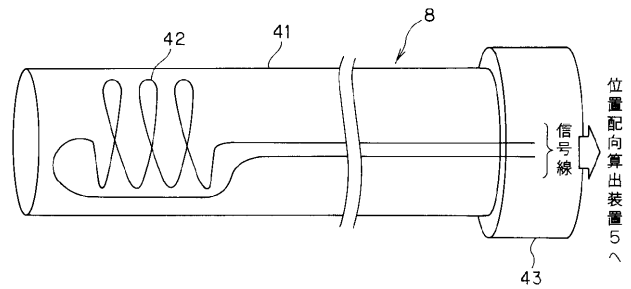


【 図 4 】

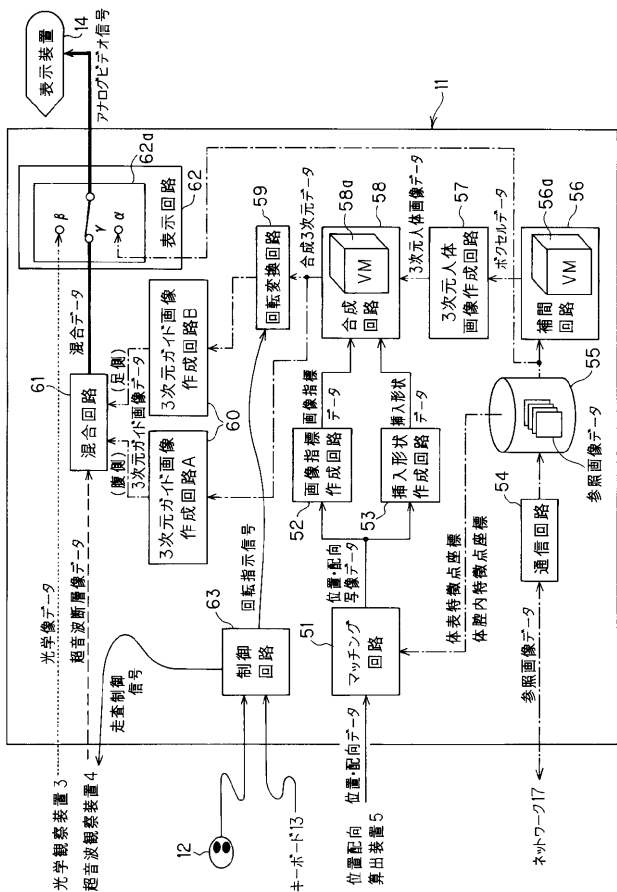


【 図 5 】

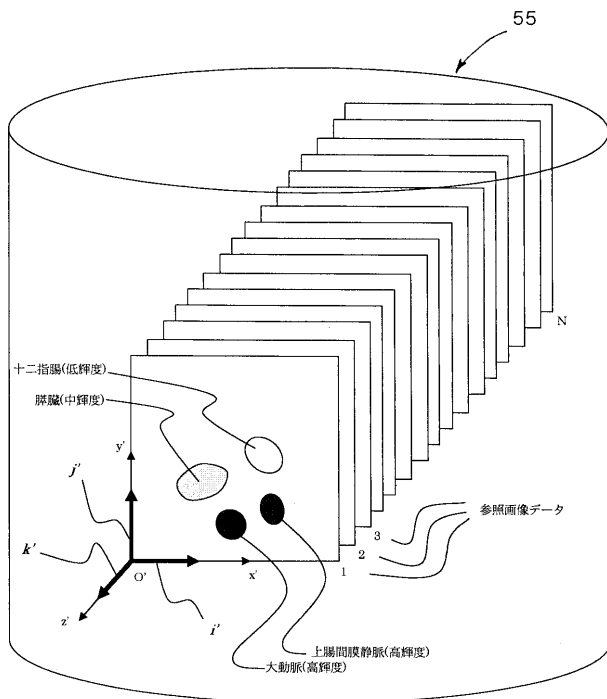


【 図 6 】

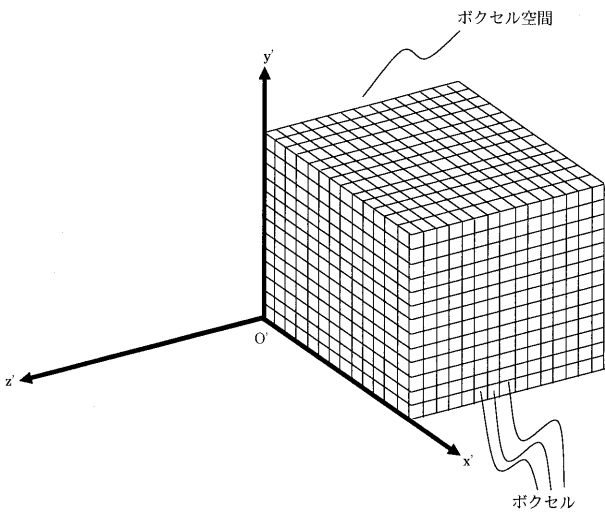


【 図 8 】

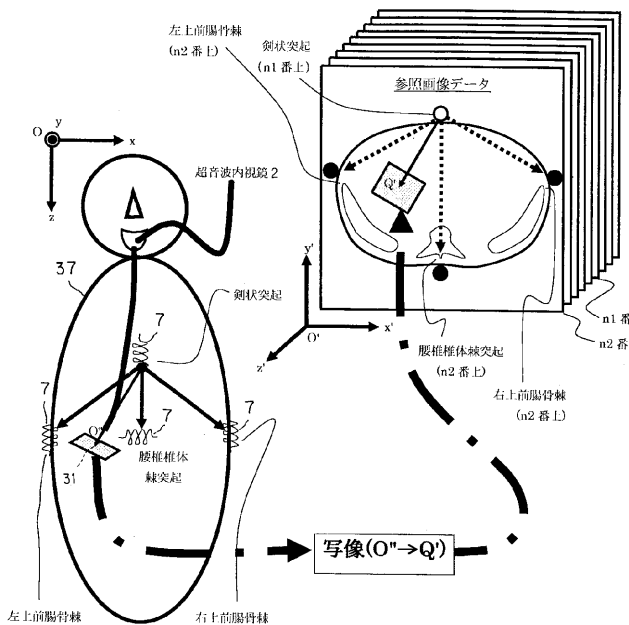


【 図 7 】

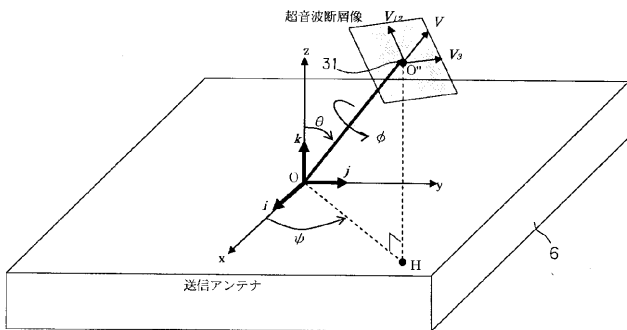


【 図 9 】

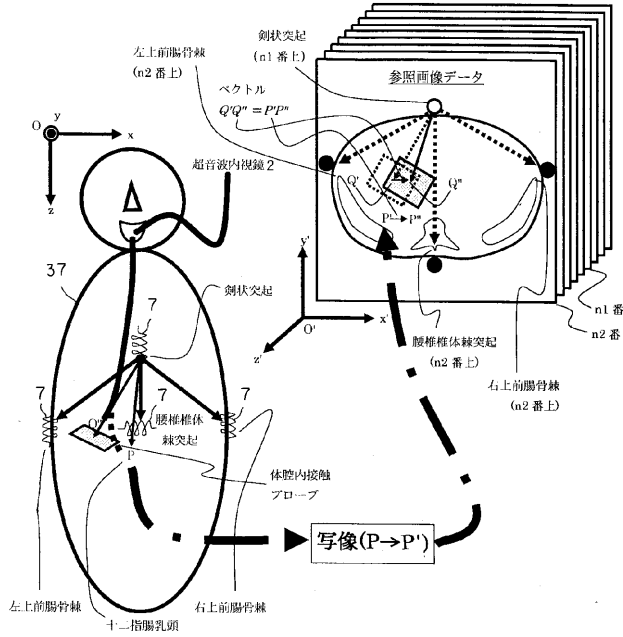


【 図 10 】

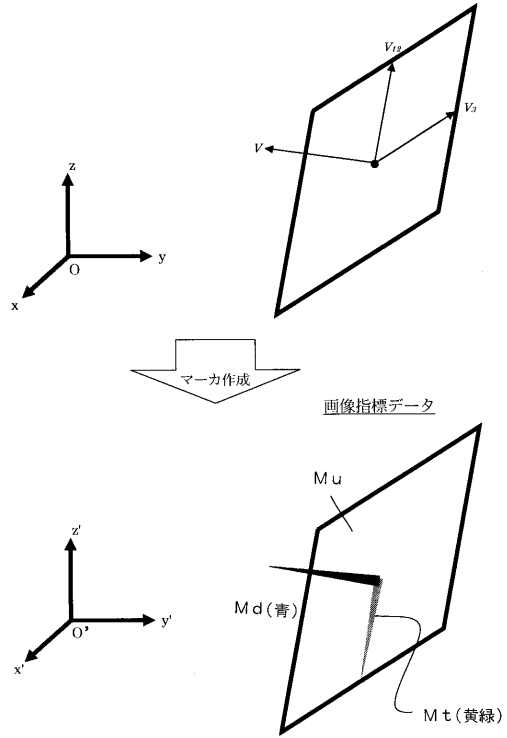


【 図 11 】

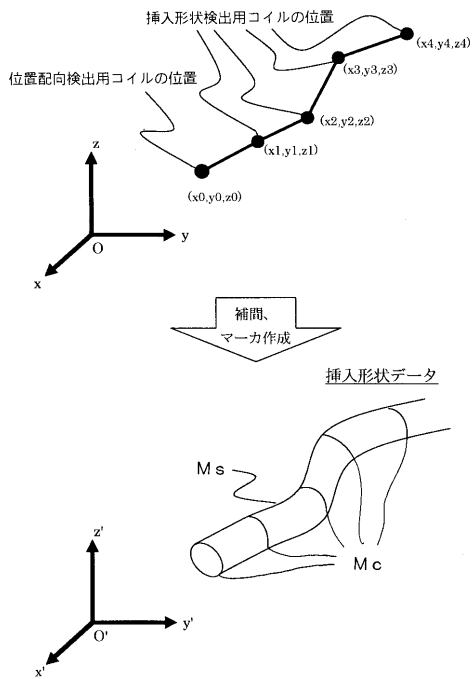


【 図 12 】

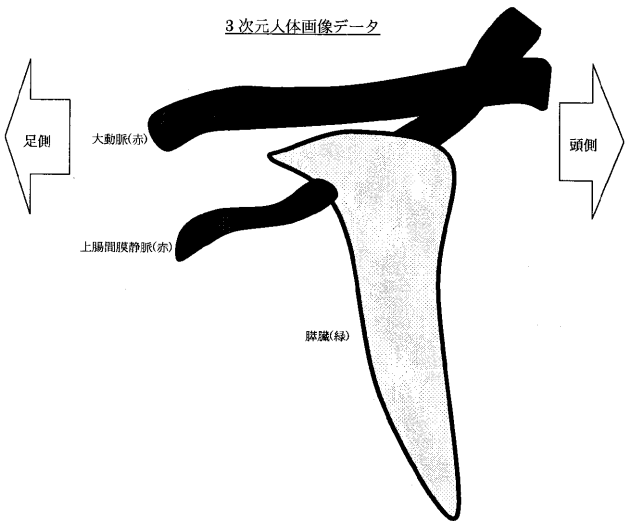


【 図 1 3 】

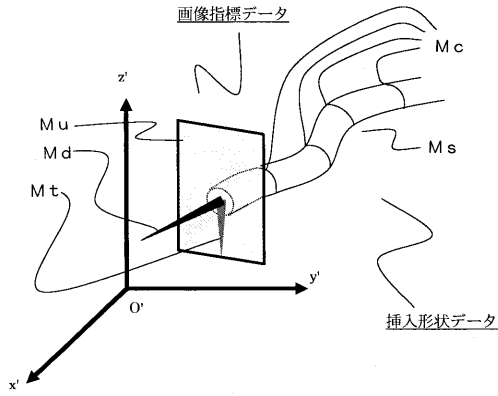


【 図 1 4 】

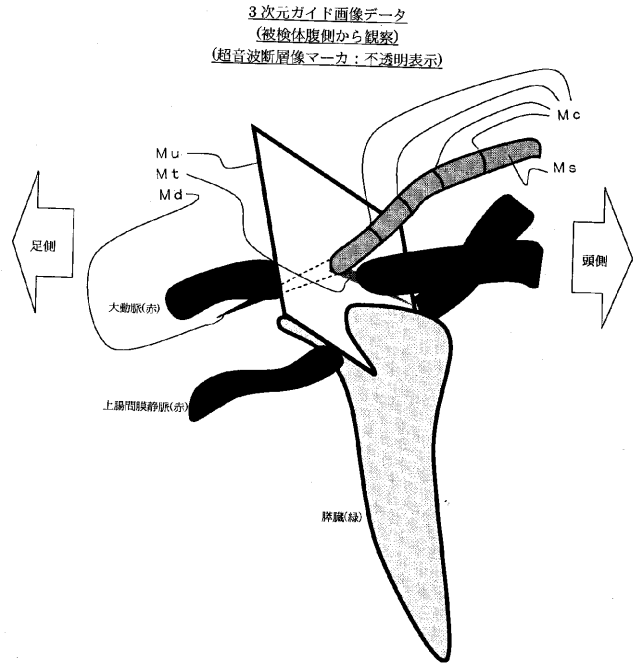


【 図 1 5 】

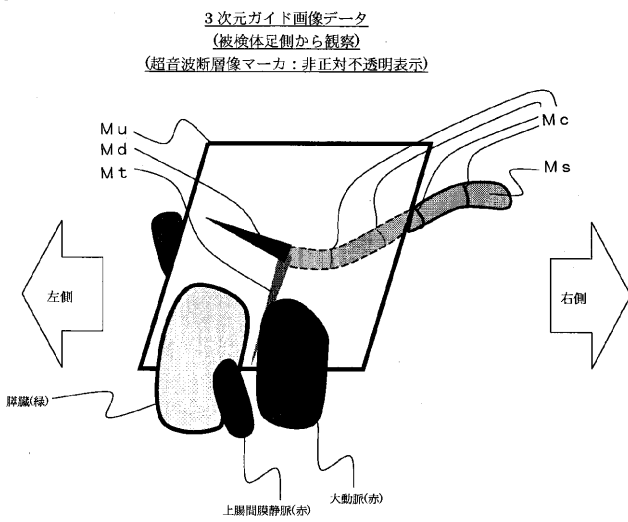


【 図 1 6 】

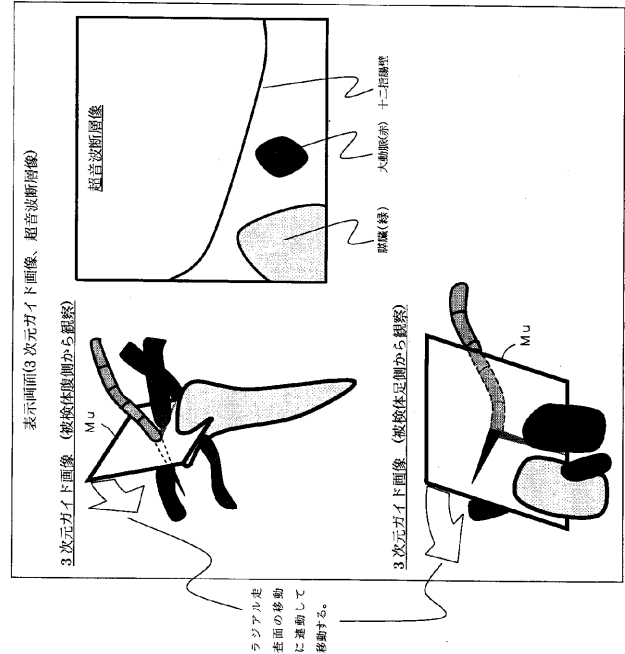


【 図 17 】

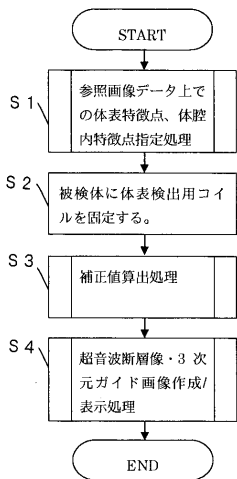


【 図 18 】

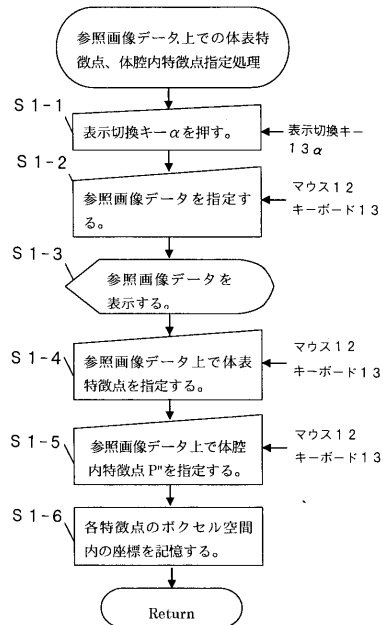


【 図 19 】

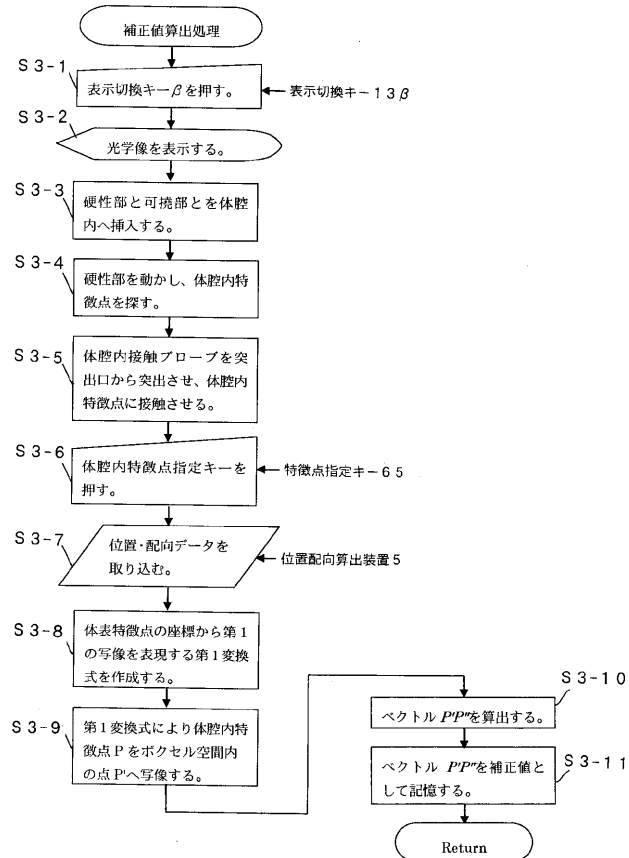


【 図 20 】

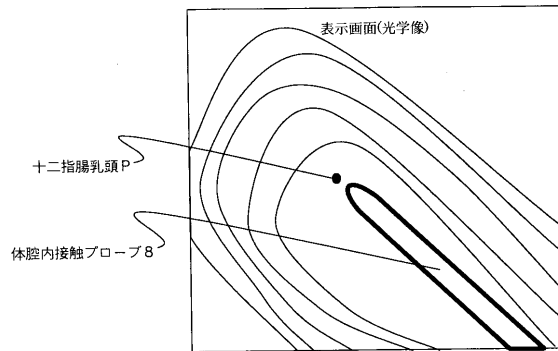


【 図 2 1 】

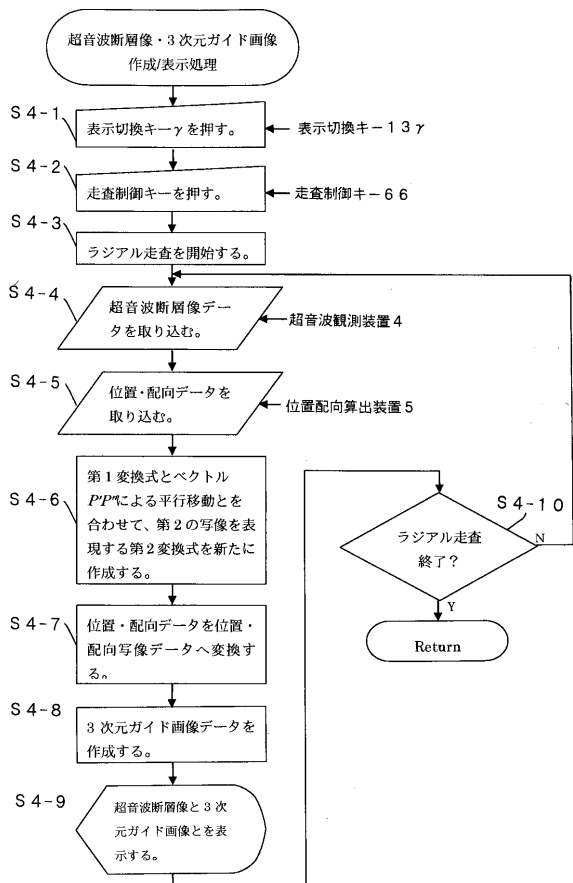


【 図 2 2 】

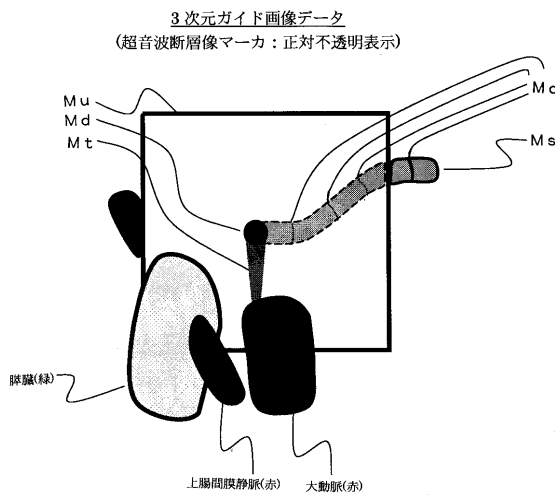


【 図 2 3 】

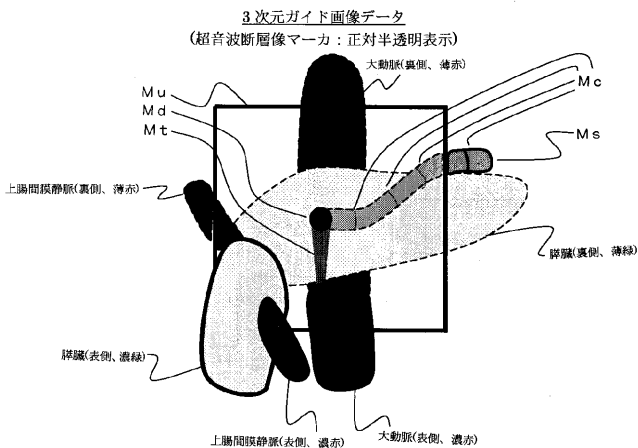


【 図 2 5 】

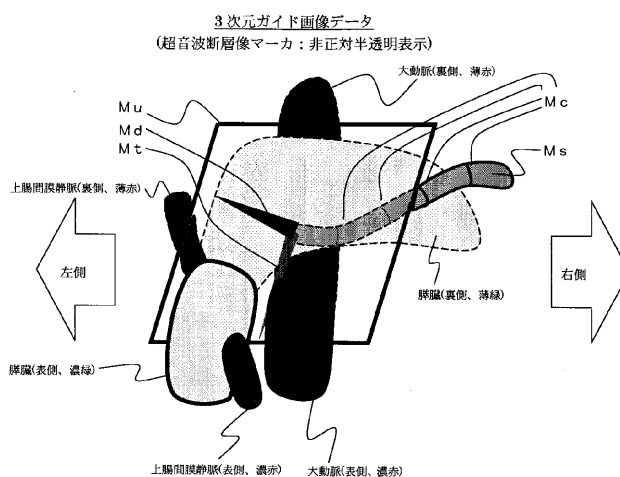


【 図 2 4 】

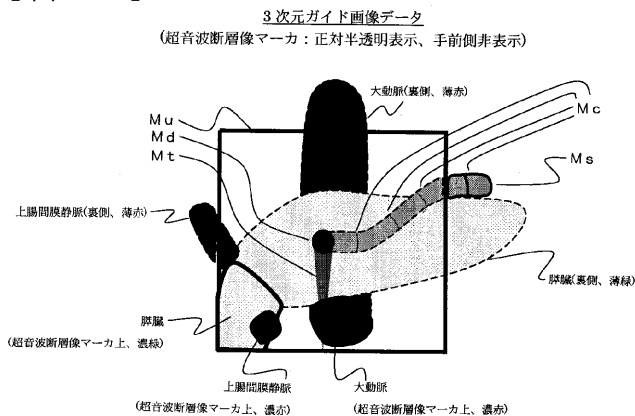


【 図 2 6 】

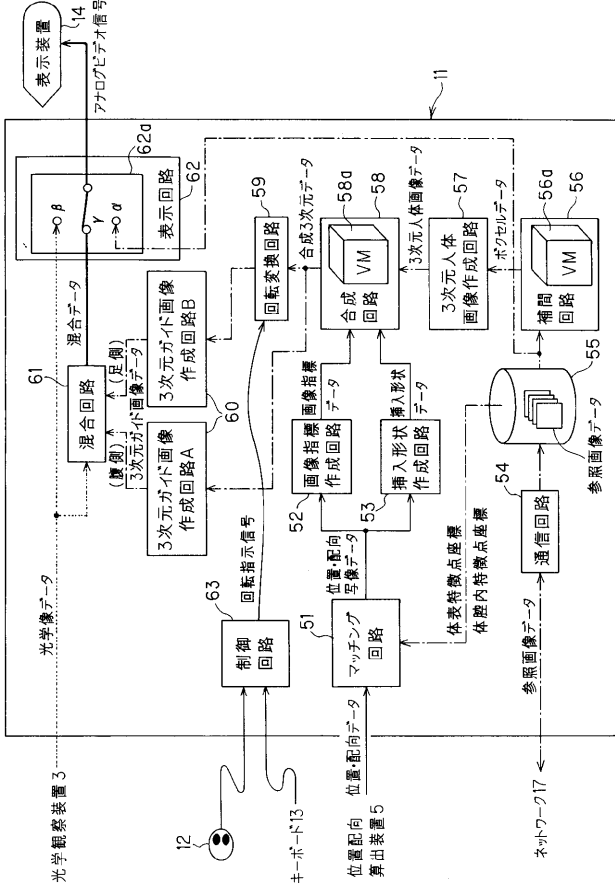


【 図 2 7 】

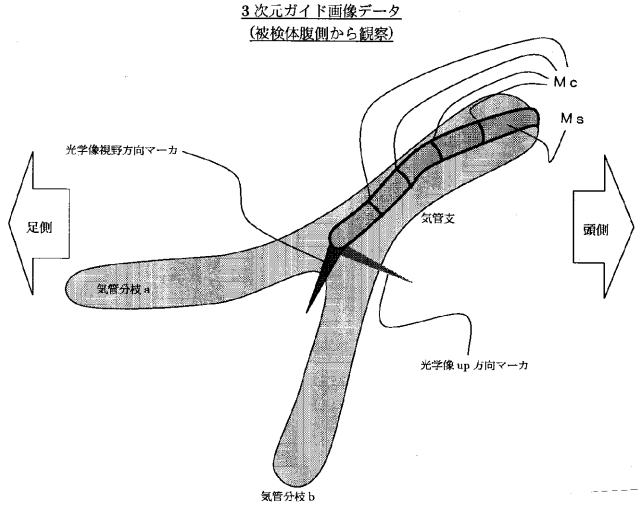

【 図 2 8 】

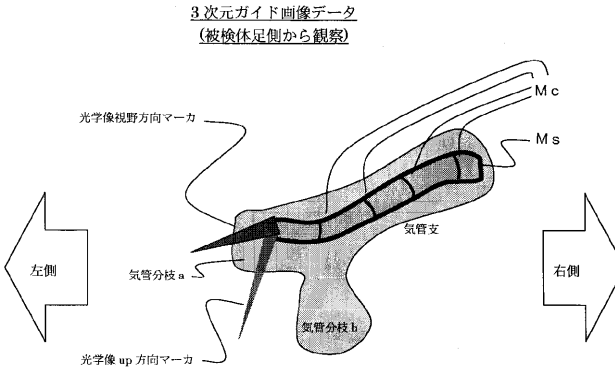

【 図 2 9 】

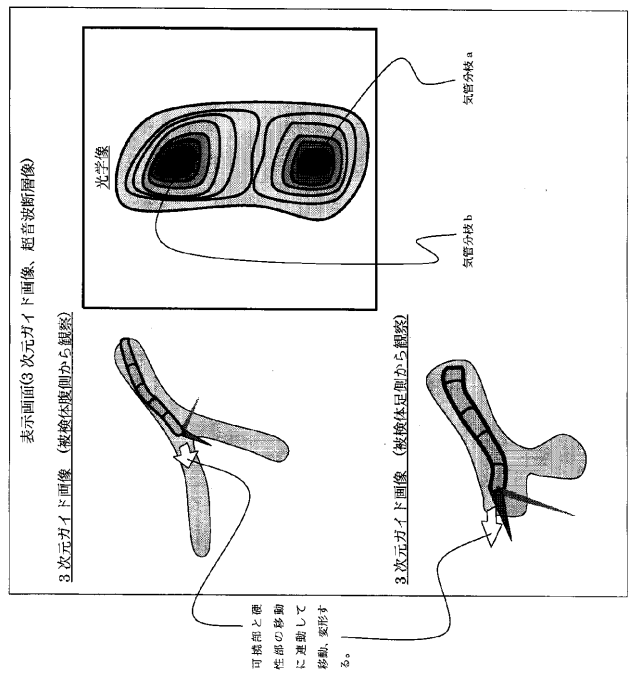

フロントページの続き

(72)発明者 小室 雅彦

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号 オリンパスメディカルシステムズ株式会社内

Fターム(参考) 4C601 BB03 BB16 BB24 EE11 FE02 GB05 KK21 KK31

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2008006108A5	公开(公告)日	2009-05-21
申请号	JP2006180435	申请日	2006-06-29
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯医疗株式会社		
申请(专利权)人(译)	オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
[标]发明人	川島知直 生熊聡一 小幡里織 小室雅彦		
发明人	川島 知直 生熊 聡一 小幡 里織 小室 雅彦		
IPC分类号	A61B8/12		
CPC分类号	A61B8/4488 A61B1/0051 A61B1/042 A61B5/055 A61B5/06 A61B5/065 A61B6/032 A61B6/466 A61B6/5247 A61B8/12 A61B8/4254 A61B8/4444 A61B8/463 A61B8/466 A61B8/467 A61B8/5238		
FI分类号	A61B8/12		
F-TERM分类号	4C601/BB03 4C601/BB16 4C601/BB24 4C601/EE11 4C601/FE02 4C601/GB05 4C601/KK21 4C601/KK31		
代理人(译)	伊藤 进		
其他公开文献	JP4868959B2 JP2008006108A		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种腔内探针装置，其以较少侵入性的方式检测腔内探针的插入形状和实时图像的方向，并产生包括腔内探针的插入形状和引导图像的引导图像。实时图像的方向。解决方案：通过提供用于获取超声回波信号的超声换能器阵列29，产生包括柔性部分22的插入形状和作为由回波信号等产生的实时图像的超声波断层图像的方向的引导图像。在作为插入体腔的腔内探针的超声波内窥镜2的前端的刚性部21中，附近的图像位置/姿势检测线圈31，以及在柔性的长度方向上的插入形状检测线圈32部分22等。Z