

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-150825

(P2013-150825A)

(43) 公開日 平成25年8月8日(2013.8.8)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 8/08 (2006.01)	A 6 1 B 8/08	4 C 0 9 6
A 6 1 B 5/055 (2006.01)	A 6 1 B 5/05 3 9 0	4 C 6 0 1
	A 6 1 B 5/05 3 8 0	

審査請求 有 請求項の数 10 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号	特願2013-59247 (P2013-59247)	(71) 出願人	300019238
(22) 出願日	平成25年3月22日 (2013.3.22)		ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー
(62) 分割の表示	特願2010-115092 (P2010-115092)の分割		アメリカ合衆国・ウィスコンシン州・53188・ワウケシャ・ノース・グランドビュー・ブルバード・ダブリュー・710・3000
原出願日	平成22年5月19日 (2010.5.19)	(74) 代理人	100106541 弁理士 伊藤 信和
		(72) 発明者	小笠原 正文 東京都日野市旭ヶ丘4丁目7番地の127 GEヘルスケア・ジャパン株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 画像表示装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】同一断面について生体組織が同一形状の超音波画像と医用画像とを表示することができる画像表示装置を提供する。

【解決手段】被検体の乳房の超音波画像データ及び医用画像データを記憶する記憶部を備え、それらは前記被検体の伏臥位、仰臥位及び立位の3つの姿勢のうち互いに異なる姿勢の画像データで、少なくとも一方の画像データは3Dデータであり、前記超音波画像データ及び前記医用画像データのうちのいずれか一方の3Dの乳房の画像データを用いて、他方の乳房の画像データの姿勢と同じにするように、前記乳房の形状を変形する変形演算を行なう変形演算部と、前記変形演算が行われた画像データをと、前記変形演算が行われなかった画像データから同一断面である2D画像のデータを抽出して、前記同一断面について画像を表示部に表示する表示画像制御部53とをさらに備える。

【選択図】図2



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

超音波診断装置で取得された被検体の乳房のデータに基づく超音波画像データ及び医用画像装置で取得された前記被検体の乳房のデータに基づく医用画像データを記憶する記憶部を備え、

前記超音波画像データ及び前記医用画像データは、前記被検体の伏臥位、仰臥位及び立位の 3 つの姿勢のうち互いに異なる姿勢の画像データであるとともに、少なくとも一方の画像データは 3 D データであり、

前記超音波画像データ及び前記医用画像データのうちいずれか一方の 3 D の乳房の画像データを用いて、他方の乳房の画像データの姿勢と同じにするように、前記乳房の形状を変形する変形演算を行なう変形演算部と、

前記変形演算が行われた画像データを第 1 の画像データとし、前記変形演算が行われなかった画像データを第 2 の画像データとするとき、前記第 1 の画像データ及び前記第 2 の画像データから同一断面である 2 D 画像のデータを抽出して、前記同一断面について前記第 1 の画像データに基づく画像及び前記第 2 の画像データに基づく画像を表示部に表示する表示画像制御部とをさらに備える画像表示装置。

10

【請求項 2】

前記記憶部は、仰臥位の姿勢になった被検体の乳房又は立位の姿勢になった被検体の乳房の前記超音波画像データを記憶するとともに、伏臥位の姿勢になった被検体の乳房の前記医用画像データを記憶することを特徴とする請求項 1 に記載の画像表示装置。

20

【請求項 3】

前記変形演算部は、前記乳房を非圧縮性超弾性体と想定して前記乳房の形状に変形することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の画像表示装置。

【請求項 4】

前記変形演算部は、前記乳房を剛体に設けられた非圧縮性超弾性体と想定して前記乳房の形状に変形することを特徴とする請求項 3 に記載の画像表示装置。

【請求項 5】

前記変形演算部は、前記一方の画像データを基準にして前記他方の画像データにおける乳房に作用する応力を想定して変形演算を行なうことを特徴とする請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載の画像表示装置。

30

【請求項 6】

前記変形演算部は、粒子法又は有限要素法を用いて変形演算を行なうことを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれか一項に記載の画像表示装置。

【請求項 7】

前記変形演算部は、前記超音波画像データにおける乳房の形状を、前記医用画像データにおける乳房の形状に変形する変形演算を行なうことを特徴とする請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の画像表示装置。

【請求項 8】

前記変形演算部は、前記医用画像データにおける乳房の形状を、前記超音波画像データにおける乳房の形状に変形する変形演算を行なうことを特徴とする請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の画像表示装置。

40

【請求項 9】

前記表示画像制御部は、前記第 1 の画像と前記第 2 の画像とを並べて前記表示部に表示することを特徴とする請求項 1 ～ 8 のいずれか一項に記載の画像表示装置。

【請求項 10】

前記表示画像制御部は、前記第 1 の画像と前記第 2 の画像とを重ねて前記表示部に表示することを特徴とする請求項 1 ～ 8 のいずれか一項に記載の画像表示装置。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

50

本発明は、超音波画像と超音波画像以外の医用画像とを表示する画像表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

超音波診断装置では、被検体の体表面に超音波プローブを当接して被検体内に超音波を送信し、得られたエコーデータに基づいて超音波画像を作成し表示する。また、超音波画像以外の医用画像としては、MRI (Magnetic Resonance Imaging) 画像、X線CT (Computed Tomography) 画像などがある。そして、特許文献1には、超音波画像とMRI画像又はCT画像とを並べて表示する超音波診断装置が開示されている。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開平10-151131号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところで、超音波診断装置において、同一断面についての超音波画像と超音波画像以外の医用画像とを表示しようとした場合、それぞれの画像における撮影時の被検体の姿勢の相違により、同一断面であっても生体組織の形状が異なる場合がある。例えば、乳房について超音波診断装置において撮影を行なう場合には、仰臥位で撮影を行なう。一方、MRI装置において乳房の撮影を行なう場合には、伏臥位で撮影を行なう。従って、超音波画像における乳房は、重力によって押しつぶされた形状になっており、一方でMRI画像における乳房は、重力によって垂下した形状になっていて、各画像における形状が異なっている。

20

【0005】

このようなことから、超音波画像と超音波画像以外の医用画像とをともに表示する場合において、同一断面について生体組織が同一形状の画像を表示することが診断上望まれている。

【課題を解決するための手段】

30

【0006】

上述の課題を解決するためになされた第1の観点の発明は、被検体に対して超音波を送信してエコーを受信する超音波プローブと、該超音波プローブの位置を検出するための位置センサと、該位置センサの位置検出情報に基づいて、所定の点を原点とする三次元空間の座標系におけるエコーデータの位置を算出する位置算出部と、前記エコーデータに基づく超音波画像及び超音波診断装置以外の医用画像装置において予め取得された医用画像のうち、何れか一方の画像における生体組織の形状を他方の画像における生体組織の形状に変形する変形演算を行なう変形演算部と、前記三次元空間の座標系である超音波画像の座標系と前記医用画像の座標系との間の座標変換を行なって、同一断面について、前記変形演算によって得られたデータに基づく形状変形済み画像と前記他方の画像とをともに表示部に表示する表示画像制御部と、を備えることを特徴とする超音波診断装置である。

40

【0007】

第2の観点の発明は、第1の観点の発明において、前記変形演算部は、粒子法又は有限要素法を用いて変形演算を行なうことを特徴とする超音波診断装置である。

【0008】

第3の観点の発明は、第2の観点の発明において、前記変形演算部は、前記一方の画像を基準にして前記他方の画像における生体組織に作用する応力を想定して変形演算を行なうことを特徴とする超音波診断装置である。

【0009】

第4の観点の発明は、第1～3のいずれか一の観点の発明において、前記生体組織は乳

50

房であることを特徴とする超音波診断装置である。

【００１０】

第５の観点の発明は、第４の観点の発明において、前記変形演算部は、剛体に設けられた非圧縮超弾性体を乳房と想定して粒子法又は有限要素法によって変形演算を行なうことを特徴とする超音波診断装置である。

【００１１】

第６の観点の発明は、第５の観点の発明において、前記変形演算部は、前記超音波画像及び前記医用画像における乳房を、水平状態の剛体の下面に設けられた非圧縮超弾性体、水平状態の剛体の上面に設けられた非圧縮超弾性体、鉛直状態の剛体の片面に設けられた非圧縮超弾性体のいずれかであるとして、粒子法又は有限要素法による変形演算を行なうことを特徴とする超音波診断装置である。

10

【００１２】

第７の観点の発明は、第６の観点の発明において、前記変形演算部は、前記超音波画像における乳房を、水平状態の剛体の上面に設けられた非圧縮超弾性体又は鉛直状態の剛体の片面に設けられた非圧縮超弾性体とし、前記医用画像における乳房を、水平状態の剛体の下面に設けられた非圧縮超弾性体として、粒子法又は有限要素法による変形演算を行なうことを特徴とする超音波診断装置である。

【００１３】

第８の観点の発明は、第１～７のいずれか一の観点の発明において、前記変形演算部は、前記超音波画像における生体組織の形状を、前記医用画像における生体組織の形状に変形する変形演算を行なうことを特徴とする超音波診断装置である。

20

【００１４】

第９の観点の発明は、第１～８のいずれか一の観点の発明において、前記表示画像制御部は、スキャンコンバータによって前記エコーデータを走査変換して超音波画像データを作成することを特徴とする超音波診断装置である。

【００１５】

第１０の観点の発明は、第９の観点の発明において、前記変形演算の対象は、前記スキャンコンバータによる走査変換前の前記エコーデータ又は前記スキャンコンバータによる走査変換後の超音波画像データのいずれかであることを特徴とする超音波診断装置である。

30

【００１６】

第１１の観点の発明は、第１～７のいずれか一の観点の発明において、前記変形演算部は、前記医用画像における生体組織の形状を、前記超音波画像における生体組織の形状に変形する変形演算を行なうことを特徴とする超音波診断装置である。

【００１７】

第１２の観点の発明は、第１～１１のいずれか一の観点の発明において、前記医用画像のデータを記憶する記憶部を備えることを特徴とする超音波診断装置である。

【００１８】

第１３の観点の発明は、第１２の観点の発明において、前記超音波画像はリアルタイムの画像であり、前記医用画像は前記記憶部に記憶されたデータに基づく画像であることを特徴とする超音波診断装置である。

40

【００１９】

第１４の観点の発明は、第１２の観点の発明において、前記超音波画像は、前記超音波プローブによる超音波の送受信を行なうことによって予め取得され記憶されたデータに基づく画像であり、前記医用画像は前記記憶部に記憶されたデータに基づく画像であることを特徴とする超音波診断装置である。

【００２０】

第１５の観点の発明は、第１～１４のいずれか一の観点の発明において、前記表示画像制御部は、前記形状変形済み画像と前記他方の画像とを並べて前記表示部に表示することを特徴とする超音波診断装置である。

50

【 0 0 2 1 】

第 1 6 の観点の発明は、第 1 ~ 1 4 のいずれか一の観点の発明において、前記表示画像制御部は、前記形状変形済み画像と前記他方の画像とを重ねて前記表示部に表示することを特徴とする超音波診断装置である。

【 発明の効果 】

【 0 0 2 2 】

上記観点の発明によれば、前記超音波画像又は前記医用画像のうち、いずれか一方の画像における生体組織の形状を他方の画像における生体組織の形状に変形する変形演算を行なって形状変形済み画像が作成される。そして、超音波画像の座標系と医用画像の座標系との間の座標変換を行なって同一断面についての形状変形済み画像と前記他方の画像とがともに表示される。これにより、同一断面について生体組織が同一形状の超音波画像と医用画像とを表示することができる。

10

【 0 0 2 3 】

また、例えば超音波画像と医用画像とで撮影時の被検体の体勢が異なっていることなどが原因で、両画像における生体組織の形状が大きく異なっている、粒子法又は有限要素法を用いて変形演算を行なうことにより、変形後の生体組織の形状を演算することができる。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 2 4 】

【 図 1 】 超音波診断装置の実施形態の概略構成の一例を示すブロック図である。

20

【 図 2 】 図 1 に示す超音波診断装置における表示制御部の構成を示すブロック図である。

【 図 3 】 図 1 に示す超音波診断装置における制御部の構成を示すブロック図である。

【 図 4 】 第一実施形態の超音波診断装置における処理を示すフローチャートである。

【 図 5 】 被検体の姿勢と乳房の形状を説明する図であり、(A) は M R I 装置において撮影を行なう場合における乳房の形状を示す図、(B) は超音波診断装置において撮影を行なう場合における乳房の形状を示す図である。

【 図 6 】 形状変形の演算を説明する図であり、(A) は非圧縮超弾性体が剛体の下面において垂下している状態を示す図、(B) は非圧縮超弾性体が自重によって剛体の上面に対して押し付けられている状態を示す図である。

【 図 7 】 同一断面についての超音波画像及び変形済み M R I 画像が並べて表示された表示部を示す図である。

30

【 図 8 】 第一実施形態の変形例における形状変形の演算を説明する図である。

【 図 9 】 第二実施形態の超音波診断装置における処理を示すフローチャートである。

【 図 1 0 】 第二実施形態における形状変形の演算を説明する図であり、(A) は非圧縮超弾性体が自重によって剛体の上面に対して押し付けられている状態を示す図、(B) は非圧縮超弾性体が剛体の下面において垂下している状態を示す図である。

【 図 1 1 】 第二実施形態において同一断面についての変形済み超音波画像及び M R I 画像が並べて表示された表示部を示す図である。

【 図 1 2 】 同一断面についての超音波画像及び変形済み M R I 画像が重ねて表示された表示部を示す図である。

40

【 図 1 3 】 同一断面についての変形済み超音波画像及び M R I 画像が重ねて表示された表示部を示す図である。

【 発明を実施するための形態 】

【 0 0 2 5 】

以下、本発明の実施形態について説明する。

< 第一実施形態 >

先ず、第一実施形態について図 1 ~ 図 7 に基づいて説明する。図 1 に示す超音波診断装置 1 は、超音波プローブ 2、送受信部 3、エコーデータ処理部 4、表示制御部 5、表示部 6、操作部 7、制御部 8、H D D (ハードディスクドライブ : H a r d D i s k D r i v e) 9、磁気発生部 1 0 及び磁気センサ 1 1 を備える。

50

【 0 0 2 6 】

前記超音波プローブ 2 は、アレイ状に配置された複数の超音波振動子（図示省略）を有して構成され、この超音波振動子によって被検体に対して超音波を送信し、そのエコー信号を受信する。

【 0 0 2 7 】

前記超音波プローブ 2 には、例えばホール素子で構成される前記磁気センサ 1 1 が設けられている。この磁気センサ 1 1 により、例えば磁気発生コイルで構成される前記磁気発生部 1 0 から発生する磁気を検出されるようになっている。前記磁気センサ 1 1 における検出信号は、前記表示制御部 5 へ入力されるようになっている。前記磁気センサ 1 1 における検出信号は、図示しないケーブルを介して前記表示制御部 5 へ入力されてもよいし、無線で前記表示制御部 5 へ入力されてもよい。

10

【 0 0 2 8 】

前記送受信部 3 は、前記超音波プローブ 2 を所定の送信条件で駆動させ、走査面を超音波ビームによって音線順次で走査させる。前記送受信部 3 は前記制御部 8 からの制御信号によって前記超音波プローブ 2 を駆動させる。

【 0 0 2 9 】

また、前記送受信部 3 は、前記超音波プローブ 2 で得られたエコー信号について、整相加算処理等の信号処理を行ない、信号処理後のエコーデータを前記エコーデータ処理部 4 へ出力する。

【 0 0 3 0 】

前記エコーデータ処理部 4 は、前記送受信部 3 から出力されたエコーデータに対し、対数圧縮処理、包絡線検波処理等の所定の処理を行う。

20

【 0 0 3 1 】

前記表示制御部 5 は、図 2 に示すように、位置算出部 5 1、メモリ 5 2、表示画像制御部 5 3 を有する。前記位置算出部 5 1 は、前記磁気センサ 1 1 からの磁気検出信号に基づいて、前記磁気発生部 1 0 を原点とする三次元空間における前記超音波プローブ 2 の位置及び傾きの情報（以下、「プローブ位置情報」と云う）を算出する。さらに、前記位置算出部 5 1 は、前記プローブ位置情報に基づいてエコーデータの前記三次元空間における位置情報を算出する。前記磁気発生部 1 0 を原点とする三次元空間の座標系は、超音波画像の座標系の実施の形態の一例である。

30

【 0 0 3 2 】

前記メモリ 5 2 は、例えば RAM (R a n d o m A c c e s s M e m o r y) や ROM (R e a d O n l y M e m o r y) 等の半導体メモリ (M e m o r y) などで構成される。このメモリ 5 2 には、例えば前記エコーデータ処理部 4 から出力されて、後述するように前記表示画像制御部 5 3 において前記超音波画像データに変換される前のエコーデータなどが記憶される。前記超音波画像データに変換される前のデータを、ローデータ (R a w D a t a) と云うものとする。ローデータは、前記 HDD 9 に記憶されるようになっていてもよい。

【 0 0 3 3 】

また、前記メモリ 5 2 又は前記 HDD 9 には、後述するように、超音波診断装置 1 以外の医用画像装置において取得された医用画像のデータが記憶される。前記メモリ 5 2 及び前記 HDD 9 は、本発明における記憶部の実施の形態の一例である。

40

【 0 0 3 4 】

前記表示画像制御部 5 3 は、前記エコーデータ処理部 4 から出力されたエコーデータを、スキャンコンバータ (S c a n C o n v e r t e r) によって超音波画像データに走査変換する。そして、前記表示画像制御部 5 2 は、この超音波画像データに基づく超音波画像 (B モード画像) を前記表示部 6 に表示する。

【 0 0 3 5 】

また、前記表示画像制御部 5 3 は、超音波画像の座標系と、超音波画像以外の医用画像

50

の座標系との間の座標変換を行なって、同一断面についての超音波画像と医用画像とをともに前記表示部 6 に表示する。本例では、後述するように超音波画像と医用画像とを並べて前記表示部 6 に表示する。

【0036】

後述するように、医用画像は本例ではMRI画像である。そして、前記表示部 6 に表示されるMRI画像は、後述の変形演算部 81 で得られた変形済みMRI画像である。詳細は後述する。前記表示画像制御部 53 は、本発明における表示画像制御部の実施の形態の一例である。

【0037】

前記表示部 6 は、LCD (Liquid Crystal Display) や CRT (Cathode Ray Tube) など構成される。前記操作部 7 は、操作者が指示や情報を入力するためのキーボード及びポインティングデバイス (図示省略) などを含んで構成されている。

【0038】

前記制御部 8 は、CPU (Central Processing Unit) を有して構成される。この制御部 8 は、前記 HDD 9 に記憶された制御プログラムを読み出し、前記超音波診断装置 1 の各部における機能を実行させる。

【0039】

また、前記制御部 8 は、図 3 に示すように変形演算部 81 を有する。この変形演算部 81 は、超音波画像又はMRI画像のうち、何れか一方の画像における生体組織の形状を他方の画像における生体組織の形状に変形する変形演算を行なう。本例では、前記変形演算部 81 は、後述するようにMRI画像における乳房の形状を、超音波画像における乳房の形状に変形する演算を行なう。前記変形演算部 81 は、本発明における変形演算部の実施の形態の一例である。

【0040】

さて、本例の超音波診断装置 1 の作用について図 4 のフローチャートに基づいて説明する。まず、ステップ S1 では、図示しないMRI装置において取得されたMRI画像データを前記超音波診断装置 1 に取り込む。前記超音波診断装置 1 に取り込まれたMRI画像データは、前記メモリ 52 又は前記 HDD 9 に記憶される。

【0041】

ここで、撮影の対象となる生体組織は乳房である。MRI装置において乳房を対象にした撮影を行なう場合、被検体 P は伏臥位の姿勢になっているため、図 5 (A) に示すように乳房 Br は垂下した形状になっている。一方、後述するように超音波診断装置において乳房を対象にした撮影を行なう場合、被検体 P は仰臥位の姿勢になっているため、図 5 (B) に示すように乳房 Br は自重によってつぶれたような形状になっている。

【0042】

次に、ステップ S2 では、前記変形演算部 81 がMRI画像データを対象にして変形演算を行ない、変形済みMRI画像データを作成する。具体的に説明すると、前記変形演算部 81 は、物体の変形解析に用いられる粒子法又は有限要素法を用いて、MRI画像における乳房の形状を、超音波画像における乳房の形状に変形する変形演算を行なう。従って、本例では、前記MRI画像が本発明における一方の画像の実施の形態の一例であり、前記超音波画像が本発明における他方の画像の実施の形態の一例である。

【0043】

ここで、人体においては大胸筋の上に乳房が載っている状態なので、粒子法又は有限要素法を用いて乳房の形状の変形演算を行なうにあたっては、大胸筋を剛体とし、乳房を非圧縮超弾性体としたモデルを想定する。すなわち、剛体に設けられた非圧縮超弾性体の形状変形を、粒子法又は有限要素法を用いて演算する。

【0044】

より詳細に説明すると、MRI装置における被検体の撮影姿勢は伏臥位である。従って、MRI画像における乳房として、図 6 (A) に示すように水平状態の剛体 X の下面に設

10

20

30

40

50

けられた非圧縮超弾性体 Y が垂下した状態を想定する。一方、超音波診断装置における被検体の撮影姿勢は仰臥位である。従って、超音波画像における乳房として、図 6 (B) に示すように水平状態の剛体 X の上面に設けられた非圧縮超弾性体 Y が自重によって剛体 X に対して押し付けられている状態を想定する。そして、非圧縮超弾性体 Y が、図 6 (A) に示すように剛体 X の下面において垂下した状態から、図 6 (B) に示すように剛体 X の上面に対して自重で押し付けられている状態に変化した場合の非圧縮超弾性体の形状変形を粒子法又は有限要素法によって演算することにより、MRI 画像における乳房の形状を、超音波画像における乳房の形状に変形する演算を行なう。

【 0 0 4 5 】

粒子法又は有限要素法による形状変形の演算により、図 6 (A) に示すように、剛体 X の下面において非圧縮超弾性体 Y が垂下している状態から、図 6 (B) に示すように剛体 X の上面に対して非圧縮超弾性体 Y が自重で押し付けられている状態に変化した場合における応力変化に伴う非圧縮超弾性体 Y の変化形状が求まる。このような粒子法又は有限要素法による変形演算の際には、図 6 (A) の状態を初期状態として図 6 (B) における非圧縮超弾性体にかかる相対的な応力の大きさと向きを考える。具体的には、図 6 (B) においては、図 6 (A) の状態を基準にして、鉛直下向きの方向 (図 6 (B) における前記剛体 X の上面に対して押し付けられる方向) の 2 倍の重力 (体積力) W を想定した応力 $F = 2W$ が作用しているものとする。ただし、ここでいう重力は、図 6 (A) の状態を基準にして考えた場合の相対的な重力である。

【 0 0 4 6 】

変形演算により得られた変形済み MRI 画像データは、前記メモリ 5 2 又は前記 HDD 9 に記憶される。

【 0 0 4 7 】

次に、ステップ S 3 では、仰臥位の体勢になっている被検体に対し、前記超音波プローブ 2 によって超音波を送信してエコーを受信し、前記表示画像制御部 5 3 が、送受信面についてリアルタイムの超音波画像 U G を前記表示部 6 に表示する。また、前記表示画像制御部 5 3 は、前記変形済み MRI 画像データに基づいて、任意断面についての変形済み MRI 画像 M G ' を、前記超音波画像 U G と並べて前記表示部 6 に表示する。ここでは、超音波画像 U G とは異なる断面の前記変形済み MRI 画像 M G ' が表示されているものとする。ちなみに、前記変形済み MRI 画像 M G ' は、被検体 P が仰臥位の姿勢になっている状態 (図 5 (B) の状態) の画像である。

【 0 0 4 8 】

次に、ステップ S 4 では、超音波画像 U G の座標系と変形済み MRI 画像 M G ' の座標系との位置合わせ処理を行なう。具体的には、操作者は前記表示部 6 に表示された前記超音波画像 U G と前記変形済み MRI 画像 M G ' とを見比べながら、いずれか一方又は両方の画像の断面を移動させ、同一断面の超音波画像 U G と変形済み MRI 画像 M G ' とを表示させる。前記超音波画像 U G の断面の移動は、前記超音波プローブ 2 の位置を変えることによって行なう。また、変形済み MRI 画像の断面の移動は、前記操作部 7 を操作して断面を変更する指示を入力することにより行なう。

【 0 0 4 9 】

同一断面が否かは、例えば操作者が特徴的な部位を参照するなどして判断する。ちなみに、前記超音波プローブ 2 による超音波の走査面は MRI 画像のスライス面と平行であるものとする。

【 0 0 5 0 】

同一断面についての超音波画像 U G 及び変形済み MRI 画像 M G ' が表示されると、操作者は同一断面の表示がなされたことを表す指示入力を行なう。これにより、超音波画像 U G の座標系と変形済み MRI 画像 M G ' の座標系との間の座標変換が可能になり、位置合わせ処理が完了する。

【 0 0 5 1 】

ステップ S 4 において位置合わせ処理が行なわれた後のステップ S 5 においては、前記

10

20

30

40

50

表示画像制御部 53 は、図 7 に示すように、前記超音波プローブ 2 による超音波の走査面と同一断面の変形済み M R I 画像 M G ' を、前記走査面についての超音波画像 U G と並べて前記表示部 6 に表示する。表示画像制御部 53 は、超音波画像の座標系と変形済み M R I 画像の座標系との間で座標変換を行なって、前記超音波画像 U G と同一断面の変形済み M R I 画像 M G ' を表示する。前記表示画像制御部 53 による座標変換について説明すると、本例では、超音波画像 U G の座標系であるエコーデータの位置情報を変形済み M R I 画像 M G ' の座標系に座標変換する。そして、前記表示画像制御部 53 は、この座標変換により得られた所定断面についての変形済み M R I 画像 M G ' を表示する。前記表示画像制御部 53 は、前記超音波プローブ 2 による超音波の走査面が変わっても、新たな断面についての変形済み M R I 画像 M G ' を表示する。従って、前記超音波プローブ 2 を動かし、超音波画像の断面が変わっても、これに追従するようにして新たな断面と同一断面の変形済み M R I 画像 M G ' が自動的に表示される。

10

【 0 0 5 2 】

本例の超音波診断装置 1 によれば、前記超音波画像 U G と前記変形済み M R I 画像 M G ' は、ともに被検体 P が仰臥位の姿勢になっている状態の画像であるため、同一断面について乳房の形状が同一の画像を表示することができる。従って、診断に有用である。

【 0 0 5 3 】

また、仰臥位の状態の乳房の形状と伏臥位の状態の乳房の形状とは大きく異なっているものの、乳房の形状の変形演算を、粒子法又は有限要素法を用いて行なっているので、変形後の乳房の形状を演算することができる。

20

【 0 0 5 4 】

次に、第一実施形態の変形例について説明する。上記実施形態においては、仰臥位の体勢になっている被検体に対して超音波の送受信を行なうが、立位の体勢になっている被検体に対して超音波の送受信を行なう場合には、乳房を、図 8 に示すように鉛直状態の剛体 X の片面に設けられた非圧縮超弾性体 Y と想定する。そして、非圧縮超弾性体 Y が図 6 (A) の状態から図 8 の状態に変化した場合の形状変形を、粒子法又は有限要素法によって演算する。この場合において、変形演算を行なう際の応力としては、図 6 (A) の状態を初期状態とした場合における図 8 の状態の応力を考える。すなわち、応力として、鉛直下向きの方向 (図 8 における剛体 X と平行な方向) の重力 (体積力) W と、剛体 X に対して垂直な方向 (図 8 における剛体 X の片面に対して押し付けられる方向) の重力 (体積力) W を考える。なお、ここでいう重力も、図 6 (A) の状態を基準にして考えた場合の相対的な重力である。

30

【 0 0 5 5 】

< 第二実施形態 >

次に、第二実施形態について説明する。上記第一実施形態においては、リアルタイムの超音波画像 U G を表示するとともに、この超音波画像 U G と同一断面の変形済み M R I 画像 M G ' を表示しているが、この第二実施形態においては、前記 H D D 9 又は前記メモリ 52 に記憶されたローデータを対象にして変形演算を行ない、変形済みエコーデータを作成する。そして、この変形済みエコーデータに基づく変形済み超音波画像 U G ' と、M R I 画像データに基づいて作成された M R I 画像 M G とが前記表示部 6 に表示される。

40

【 0 0 5 6 】

具体的に図 9 のフローチャートに基づいて説明する。図 9 において、ステップ S 11 では、第一実施形態のステップ S 1 と同様に、前記超音波診断装置 1 に M R I 画像データを取り込み、これを前記メモリ 52 又は前記 H D D 9 に記憶する。

【 0 0 5 7 】

次に、ステップ S 12 では、前記超音波プローブ 2 によって被検体に対する超音波の送受信を行ないエコーデータを取得する。このステップ S 12 では、前記超音波プローブ 2 によって三次元領域の走査を行い、3 D のエコーデータ (ボリュームデータ) を取得する。取得された 3 D のエコーデータは、ローデータとして前記メモリ 52 又は前記 H D D 9 に記憶される。

50

【 0 0 5 8 】

次に、ステップ S 1 3 では、ステップ S 1 2 で取得された 3 D のエコーデータを対象にして、前記変形演算部 8 1 が変形演算を行ない、変形済みエコーデータを作成する。変形演算は、3 D のエコーデータの各断面のエコーデータについて行なう。

【 0 0 5 9 】

このステップ S 1 3 における変形演算においても、大胸筋を剛体とし、乳房を非圧縮超弾性体としたモデルを想定し、剛体に設けられた非圧縮超弾性体の形状変形を、粒子法又は有限要素法を用いて演算する。ただし、本例では、図 1 0 (A) に示すように、非圧縮超弾性体が、剛体 X の上面に対して自重で押し付けられている状態から、図 1 0 (B) に示すように、剛体 X の下面において垂下した状態に変化した場合の非圧縮超弾性体の形状変形を粒子法又は有限要素法によって演算することにより、超音波画像における乳房の形状を M R I 画像における乳房の形状に変形する演算を行なう。本例では、変形演算の際に、図 1 0 (A) の状態を初期状態として図 1 0 (B) における非圧縮超弾性体にかかる応力の大きさと向きを考える。具体的には、図 1 0 (B) においては、図 1 0 (A) の状態を基準にして、鉛直下向きの方向 (図 1 0 (B) において前記剛体 X の下面から引っ張られる方向) の 2 倍の重力 (体積力) W を想定した応力 $F = 2 W$ が作用しているものとする。ただし、ここでいう重力も、図 1 0 (A) の状態を基準にして考えた場合の相対的な重力である。

【 0 0 6 0 】

変形演算により得られた変形済みエコーデータは、前記メモリ 5 2 又は前記 H D D 9 に記憶される。

【 0 0 6 1 】

次に、ステップ S 1 4 では、前記表示画像制御部 5 3 が、変形済みエコーデータに基づく変形済み超音波画像 U G ' と M R I 画像データに基づく M R I 画像 M G とを表示部 6 に並べて表示する。ここでは、変形済み超音波画像 U G ' と M R I 画像 M G の断面は異なる断面であるとする。ちなみに、前記変形済み超音波画像 U G ' は、被検体 P が伏臥位の姿勢になっている状態 (図 5 (A) の状態) の画像である。

【 0 0 6 2 】

次に、ステップ S 1 5 では、変形済み超音波画像 U G ' の座標系と M R I 画像 M G の座標系との位置合わせ処理を行なう。この位置合わせ処理の内容は、第一実施形態のステップ S 4 の位置合わせ処理と基本的には同一であり、前記表示部 6 に表示された変形済み超音波画像 U G ' と M R I 画像 M G とを見比べながら同一断面を表示させて行なう。ちなみに、前記変形済み超音波画像 U G ' の断面の移動は、M R I 画像の断面の移動と同様に、前記操作部 7 を操作して断面を変更する指示を入力することにより行なう。

【 0 0 6 3 】

ステップ S 1 5 において位置合わせ処理が行なわれた後のステップ S 1 6 においては、前記表示画像制御部 5 3 は、図 1 1 に示すように、同一断面についての変形済み超音波画像 U G ' 及び M R I 画像 M G を前記表示部 6 に表示する。このステップ S 1 6 では、前記操作部 7 における指示入力により、前記変形済み超音波画像 U G ' 及び M R I 画像 M G のいずれかの断面を変更しても、断面を変更した画像の座標系における座標を、断面を変更していない画像の座標系における座標に座標変換して、同一断面についての変形済み超音波画像 U G ' 及び M R I 画像 M G を表示する。例えば、変形済み超音波画像 U G ' の断面を変更した場合、変形済み超音波画像 U G ' の座標系における新たな断面の座標を、M R I 画像 M G の座標系における座標系に座標変換して、M R I 画像 M G の座標系において対応する断面を特定し、新たな断面と同一断面の M R I 画像を表示する。また、M R I 画像 M G の断面を変更した場合、M R I 画像 M G の座標系における新たな断面の座標を変形済み超音波画像 U G ' の座標系に座標変換して、変形済み超音波画像 U G ' の座標系において対応する断面を特定し、新たな断面と同一断面の変形済み超音波画像 U G ' を表示する。

【 0 0 6 4 】

以上説明した第二実施形態によれば、前記変形済み超音波画像UG'及びMRI画像MGは、ともに被検体Pが伏臥位の姿勢になっている状態の画像であるため、第一実施形態と同様に、同一断面について乳房の形状が同一の画像を表示することができる。従って、診断に有用である。

【0065】

なお、第二実施形態において、超音波画像ではなく、MRI画像における乳房の形状を超音波画像における形状に変形して得られた変形済みMRI画像を、超音波画像とともに表示するようにしてもよい。

【0066】

以上、本発明を前記実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範囲で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、医用画像はMRI画像に限られるものではなく、例えばX線CT画像やマンモグラフィ装置で得られた画像などであってもよい。

【0067】

また、第二実施形態において、ローデータ、すなわち前記表示画像制御部53におけるスキャンコンバータによる走査変換前の前記エコーデータを対象にした変形演算ではなく、走査変換後の超音波画像データを対象にした変形演算を行なってもよい。

【0068】

また、前記第一実施形態のステップS5においては、前記表示画像制御部53は、同一断面の超音波画像UGと変形済みMRI画像MG'とを並べて前記表示部6に表示するようになっているが、図12に示すように、同一断面の前記超音波画像UGと前記変形済みMRI画像MG'とを互いに透過させた状態で重ねて（合成して）前記表示部6に表示してもよい。

【0069】

また、同様に前記第二実施形態のステップS16においても、前記表示画像制御部53は、同一断面の変形済み超音波画像UG'とMRI画像MGとを並べて前記表示部6に表示するようになっているが、図13に示すように、同一断面の変形済み超音波画像UG'とMRI画像MGとを互いに透過させた状態で重ねて（合成して）前記表示部6に表示してもよい。

【符号の説明】

【0070】

- 1 超音波診断装置
- 2 超音波プローブ
- 6 表示部
- 9 HDD（記憶部）
- 10 磁気発生部（位置センサ）
- 11 磁気センサ（位置センサ）
- 51 位置算出部
- 52 メモリ（記憶部）
- 53 表示画像制御部
- 81 変形演算部
- MG MRI画像
- MG' 変形済みMRI画像
- UG 超音波画像
- UG' 変形済み超音波画像
- Br 乳房
- X 剛体
- Y 非圧縮超弾性体


10

20


30

40


【図 1】

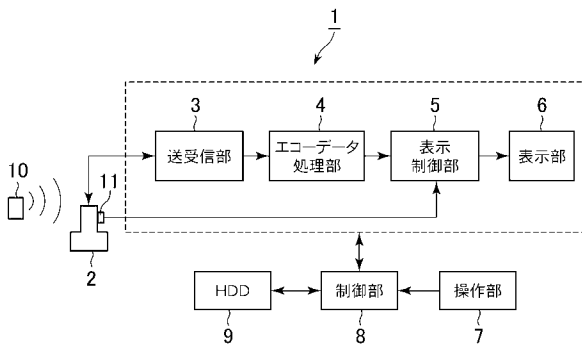


【図 2】

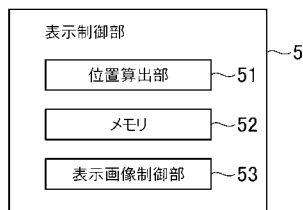


【図 3】




【図 4】

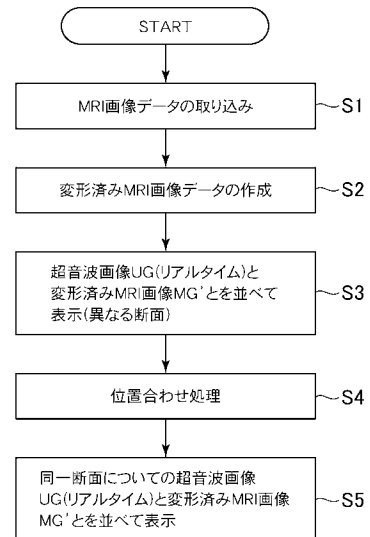


【図 5】

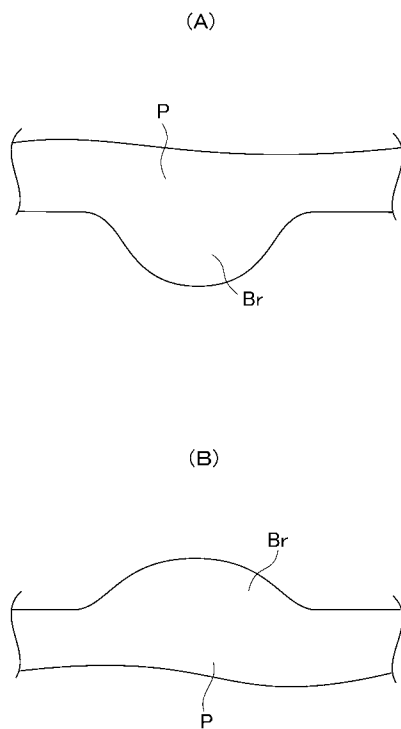


【図 6】

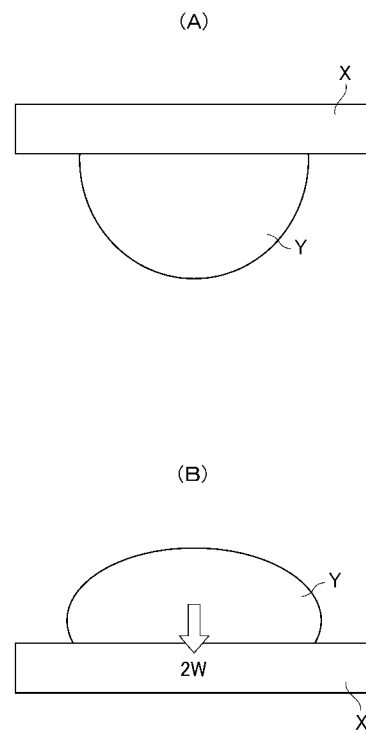



【図 7】

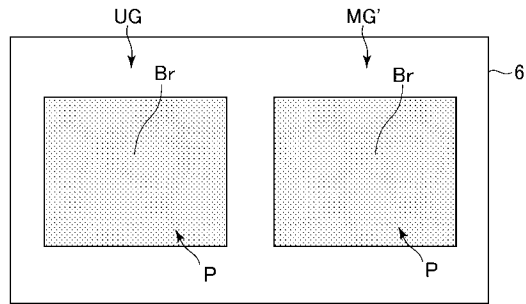


【図 8】

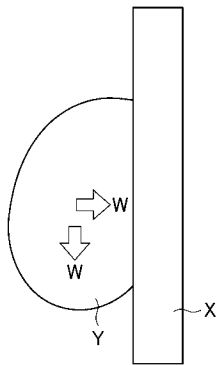


【図 10】

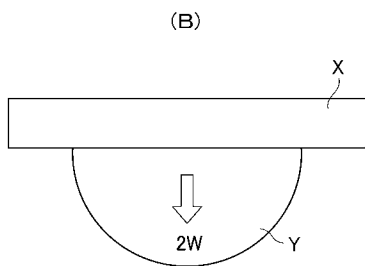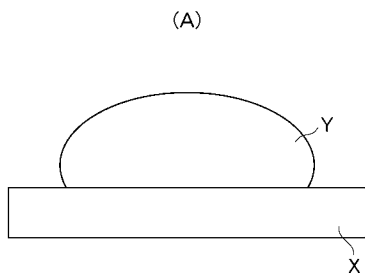


【図 9】

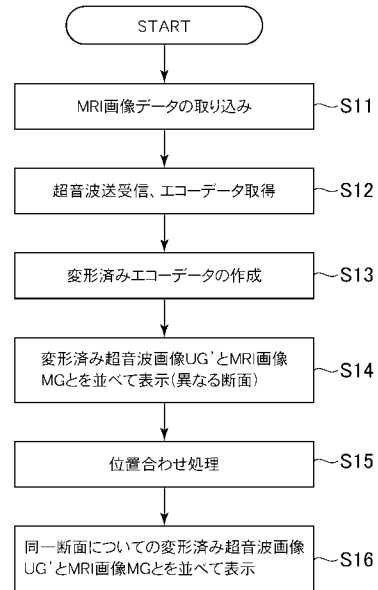


【図 11】

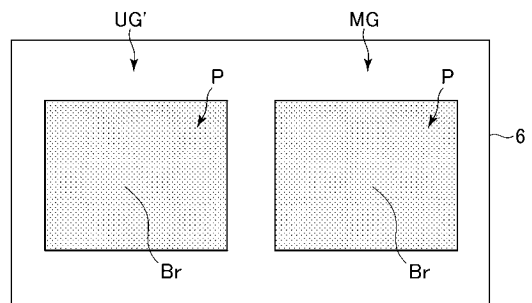

【図 12】

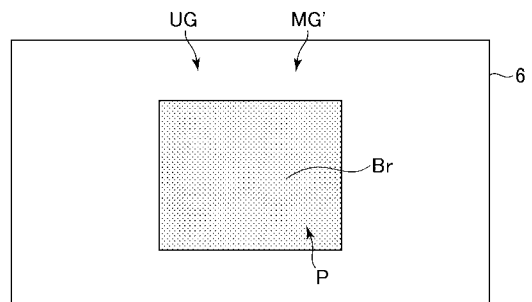

【図 13】

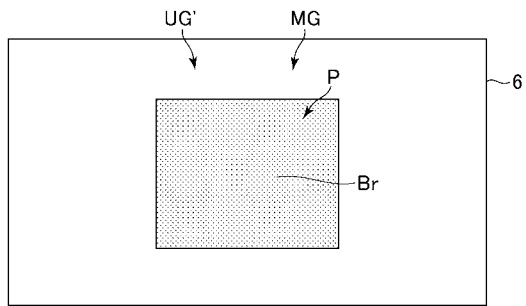

フロントページの続き

(72)発明者 阿部 弥生

東京都日野市旭ヶ丘4丁目7番地の127 GEヘルスケア・ジャパン株式会社内

Fターム(参考) 4C096 AA18 AC04 DC14 DC32 DC33 DC36 DC37

4C601 BB03 DD08 EE10 GA18 GA25 JC33 KK24 KK25 LL02 LL33

专利名称(译)	画像表示装置		
公开(公告)号	JP2013150825A	公开(公告)日	2013-08-08
申请号	JP2013059247	申请日	2013-03-22
申请(专利权)人(译)	GE医疗系统环球技术公司有限责任公司		
[标]发明人	小笠原正文 阿部弥生		
发明人	小笠原 正文 阿部 弥生		
IPC分类号	A61B8/08 A61B5/055		
FI分类号	A61B8/08 A61B5/05.390 A61B5/05.380 A61B5/055.380 A61B5/055.390		
F-TERM分类号	4C096/AA18 4C096/AC04 4C096/DC14 4C096/DC32 4C096/DC33 4C096/DC36 4C096/DC37 4C601/BB03 4C601/DD08 4C601/EE10 4C601/GA18 4C601/GA25 4C601/JC33 4C601/KK24 4C601/KK25 4C601/LL02 4C601/LL33		
代理人(译)	伊藤亲		
其他公开文献	JP5653468B2		

摘要(译)

摘要：要解决的问题：提供一种能够显示超声图像的图像显示装置和生物组织具有相同形状的医学图像，用于相同的横截面。解决方案：图像显示装置包括用于存储对象乳房的超声图像数据和医学图像数据的存储部分。它们是三种姿势彼此不同的姿势的图像数据，俯卧位，脊柱位置和对象的站立位置，并且超声图像数据和医学图像数据中的至少一个是3D数据。该图像显示装置还包括：变形计算部分，其使用超声图像数据和医学图像数据之一的3D乳房图像数据来执行变形计算，以使乳房的形状变形，使得其中一个中的姿势。乳房图像数据与其他乳房图像数据中的姿势相同；显示图像控制部分53从经过变形计算的图像数据和未经过变形计算的图像数据中提取2D图像数据，使其成为相同的横截面，并在显示部分上显示相对于同一交叉的图像-部分。

