



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101420897 B

(45) 授权公告日 2011.04.13

(21) 申请号 200780013635.3

G06T 1/00 (2006.01)

(22) 申请日 2007.02.27

G06T 7/60 (2006.01)

(30) 优先权数据

113794/2006 2006.04.17 JP

(56) 对比文件

US 5036464, 1991.07.30, 全文.

US 5018509, 1991.05.28, 全文.

(85) PCT申请进入国家阶段日

2008.10.16

CN 1713848 A, 2005.12.28, 全文.

US 4916533, 1990.04.10, 说明书摘要.

(86) PCT申请的申请数据

PCT/JP2007/053587 2007.02.27

EP 1437083 A1, 2004.07.14, 说明书第 135-136 段, 144-146 段, 150 段、附图 34.

EP 1437083 A1, 2004.07.14, 说明书第 135-136 段, 144-146 段, 150 段、附图 34.

(87) PCT申请的公布数据

WO2007/119296 JA 2007.10.25

US 4910590, 1990.03.20, 全文.

(73) 专利权人 奥林巴斯医疗株式会社

地址 日本东京都

审查员 宋含

(72) 发明人 田中秀树

(74) 专利代理机构 北京林达刘知识产权代理事

务所(普通合伙) 11277

代理人 刘新宇

(51) Int. Cl.

A61B 1/00 (2006.01)

A61B 1/04 (2006.01)


权利要求书 2 页 说明书 13 页 附图 15 页

(54) 发明名称

内窥镜插入方向检测装置以及内窥镜插入方向检测方法

(57) 摘要

根据内窥镜图像中的 R 图像的场景算出场景特征量, 使用统计或非统计的识别器将场景特征量作为特征量向量来进行辨别分析, 并分类为与内窥镜插入方向密切相关的管腔暗部、皱襞等多个特征量的类。并且, 算出主要的特征量的类, 算出与该特征量对应的插入方向, 并显示高精度的插入方向标记等, 由此实现在存在多个特征量的场景的情况下也能够进行高精度的插入方向的检测的内窥镜插入方向检测装置以及内窥镜插入方向检测方法。

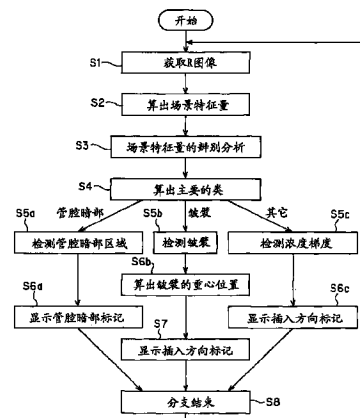

CN 101420897 B

1. 一种内窥镜插入方向检测装置，其特征在于，具备：

分类单元，其对根据由被插入到体腔内的内窥镜拍摄得到的运动图像的内窥镜图像的场景算出的多个特征量进行分类，分类为管腔暗部、皱襞、其它的类作为与上述体腔内的内窥镜插入方向的检测相关的、种类不同的多个特征量的类；

判断单元，其通过算出表示相似度的指标来从由上述分类单元分类得到的上述多个特征量的类中判断主要的特征量的类；以及

插入方向算出单元，其从与由上述分类单元分类得到的上述多个特征量的类分别相对应地设置的检测处理中，仅选择使用与由上述判断单元所判断的上述主要的特征量的类相对应的检测处理，来算出与上述主要的特征量的类相对应的上述内窥镜的插入方向。

2. 根据权利要求 1 所述的内窥镜插入方向检测装置，其特征在于，

上述分类单元具有：场景特征量算出单元，其对上述内窥镜图像的场景算出场景特征量；以及类算出单元，其根据与上述场景特征量对应的特征量向量算出上述多个特征量的类。

3. 根据权利要求 2 所述的内窥镜插入方向检测装置，其特征在于，

上述场景特征量算出单元使用多个基准图案算出上述内窥镜图像的场景的自相关系数。

4. 根据权利要求 1 所述的内窥镜插入方向检测装置，其特征在于，

上述分类单元利用直方图进行分类，分类为上述多个特征量的类。

5. 根据权利要求 1 所述的内窥镜插入方向检测装置，其特征在于，

上述分类单元根据将内窥镜图像的场景分割为多个的小区域的图像进行分类，分类为上述多个特征量的类。

6. 根据权利要求 1 所述的内窥镜插入方向检测装置，其特征在于，

上述分类单元对将内窥镜图像的场景的分辨率进行变换得到的变换图像进行分类，分类为上述多个特征量的类。

7. 一种内窥镜插入方向检测方法，其特征在于，具备：

分类步骤，对根据由被插入到体腔内的内窥镜拍摄得到的运动图像的内窥镜图像的场景算出的多个特征量进行分类，分类为管腔暗部、皱襞、其它的类作为与上述体腔内的内窥镜插入方向的检测相关的、种类不同的多个特征量的类；

判断步骤，通过算出表示相似度的指标来从由上述分类步骤分类得到的上述多个特征量的类中判断主要的特征量的类；以及

插入方向算出步骤，从与通过上述分类步骤分类得到的上述多个特征量的类分别相对应地设置的检测处理中，仅选择使用与由上述判断步骤判断得到的上述主要的特征量的类相对应的检测处理，来算出与上述主要的特征量的类相对应的上述内窥镜的插入方向。

8. 根据权利要求 7 所述的内窥镜插入方向检测方法，其特征在于，

在上述插入方向算出步骤中，仅与在上述判断步骤所判断出的前述主要的特征量的类相对应地算出上述内窥镜的插入方向。

9. 根据权利要求 7 所述的内窥镜插入方向检测方法，其特征在于，

在上述插入方向算出步骤中，具有显示所算出的插入方向的信息的插入方向显示步骤。

10. 根据权利要求 7 所述的内窥镜插入方向检测方法，其特征在于，

上述分类步骤具有：场景特征量算出步骤，对上述内窥镜图像的场景算出场景特征量；以及类算出步骤，根据与上述场景特征量对应的特征量向量来算出上述多个特征量的类。

内窥镜插入方向检测装置以及内窥镜插入方向检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种检测内窥镜的插入方向的内窥镜插入方向检测装置以及内窥镜插入方向检测方法。

背景技术

[0002] 近年来，在医疗领域中广泛地使用内窥镜。在将内窥镜的插入部插入到体腔内进行内窥镜检查的情况下，为了平滑地插入到如大肠那样复杂地弯曲的部位，有时需要熟练。

[0003] 因此，如果经验少的医生也能够将插入部简单地插入，则能够缩短内窥镜检查的时间，其价值很大。

[0004] 例如，作为第一以往例的日本特开 2004-167010 号公报中公开了一种具备像素提取单元等的内窥镜插入方向检测装置，其中，上述像素提取单元根据内窥镜图像提取与内窥镜插入方向的检测相关、或者与管腔构造相关的光晕等规定浓度值的像素。并且，该第一以往例根据提取结果来决定内窥镜的插入方向。

[0005] 另外，作为第二以往例的日本特开 2003-93328 号公报中公开了通过检测内窥镜图像中的明暗方向来决定插入内窥镜的插入部的方向的内窥镜插入方向检测装置以及内窥镜插入方向检测方法。

[0006] 然而，作为决定插入方向的装置或者方法，以往例所记载的技术存在如下缺点：没有综合地判断内窥镜图像的场景中的、与插入方向（管腔构造）相关的特征量，因此难以检测高精确度的插入方向。

[0007] 例如，当存在与多个不同的特征量对应的场景时，在以往例所记载的技术中，依赖于提取或者检测出的特征量的顺序来决定插入方向。因此，以往例存在如下缺点：有可能对非主要的特征量进行插入方向的检测处理，难以检测高精确度的插入方向。

[0008] 因此，本发明是鉴于上述问题而完成的，其目的在于提供一种即使在存在与内窥镜插入方向相关的多个特征量的场景的情况下也能够高精度地检测插入方向的内窥镜插入方向检测装置以及内窥镜插入方向检测方法。

发明内容

[0009] 用于解决问题的方案

[0010] 本发明的内窥镜插入方向检测装置的特征在于，具备：分类单元，其对由被插入到体腔内的内窥镜拍摄得到的运动图像的内窥镜图像的场景进行分类，分类为与上述体腔内的内窥镜插入方向的检测相关的、种类不同的多个特征量的类；以及插入方向算出单元，其被设置为与由上述分类单元分类得到的各个特征量的类相对应，算出上述内窥镜的插入方向。

[0011] 另外，本发明的内窥镜插入方向检测方法的特征在于，具备：分类步骤，对由被插入到体腔内的内窥镜拍摄得到的运动图像的内窥镜图像的场景进行分类，分类为与

上述体腔内的内窥镜插入方向的检测相关的、种类不同的多个特征量的类；以及插入方向算出步骤，能够与通过上述分类步骤分类得到的各个特征量的类相对应地算出上述内窥镜的插入方向。

附图说明

[0012] 图 1 是本发明的第一实施方式所涉及的、具备插入方向检测装置的内窥镜系统的整体结构图。

[0013] 图 2 是表示插入方向检测装置的结构框图。

[0014] 图 3 是表示构成插入方向检测装置的 CPU 的主要功能的图。

[0015] 图 4 是表示内窥镜插入方向检测的处理内容的流程图。

[0016] 图 5 是表示在内窥镜图像的显示画面上显示表示所检测出的管腔暗部的区域的标记的例子图。

[0017] 图 6 是表示在内窥镜图像的显示画面上显示通过所检测出的皱襞来表示插入方向的插入方向标记的例子图。

[0018] 图 7 是表示成为在高次局部自相关系数的算出中使用场景特征量的基准的二维图案的图。

[0019] 图 8 是用于说明算出场景特征量的运算的第一图。

[0020] 图 9 是用于说明算出场景特征量的运算的第二图。

[0021] 图 10 是表示算出特征量的处理过程的流程图。

[0022] 图 11 是表示利用图 10 的对图像进行缩小时使用的离散小波变换 (wavelet transform) 来缩小得到的子带 (sub band) 图像例的图。

[0023] 图 12 是表示第一变形例中的算出特征量的处理过程的流程图。

[0024] 图 13 是表示第二变形例中的算出特征量的处理过程的流程图。

[0025] 图 14 是表示利用图 13 的离散小波变换来缩小得到的子带图像例的图。

[0026] 图 15 是表示本发明的第二实施方式所涉及的、内窥镜插入方向检测的处理内容的流程图。

[0027] 图 16 是用于说明根据某分辨率的图像来进行其周围图像的合并的情况等的第一图。

[0028] 图 17 是用于说明根据某分辨率的图像来进行其周围图像的合并的情况等的第二图。

[0029] 图 18 是表示检测暗部区域的处理过程的概要的流程图。

[0030] 图 19 是表示图 18 中的步骤 S53 的详细处理过程的流程图。

[0031] 图 20 是算出浓度梯度角的说明图。

[0032] 图 21 是表示本发明的第三实施方式所涉及的、管腔暗部的区域检测的处理内容的流程图。

[0033] 图 22 是示意性地表示暗部区域等与管腔暗部的区域混在一起的内窥镜图像的图。

[0034] 图 23 是表示沿着图 22 中的 F-F' 线的截面的浓度值的图。

[0035] 图 24 是表示进行图 21 的方法时被分割的小区域的图。

[0036] 图 25 是按照图 21 的方法在图 22 所示的内窥镜图像中表示浓度梯度方向的图。

具体实施方式

[0037] 下面，参照附图说明本发明的实施方式。

[0038] (第一实施方式)

[0039] 图 1 至图 14 涉及本发明的第一实施方式，图 1 示出了具备插入方向检测装置的内窥镜系统的整体结构，图 2 示出了插入方向检测装置的结构，图 3 示出了构成插入方向检测装置的 CPU 的主要功能，图 4 示出了插入方向检测的处理内容，图 5 示出了在内窥镜图像的显示画面上显示表示所检测出的管腔暗部的区域的标记的例子，图 6 示出了在内窥镜图像的显示画面上显示通过所检测出的皱襞来表示插入方向的插入方向标记的例子，图 7 示出了成为在高次局部自相关系数的算出中使用场景特征量的基准的二维图案，图 8 和图 9 表示算出场景特征量的运算的说明图，图 10 示出了算出特征量的处理过程，图 11 示出了利用图 10 的对图像进行缩小时使用的离散小波变换来缩小得到的子带图像例，图 12 示出了第一变形例中的算出特征量的处理过程，图 13 示出了第二变形例中的算出特征量的处理过程，图 14 示出了利用图 13 的离散小波变换来缩小得到的子带图像例。

[0040] 如图 1 所示，本发明的第一实施方式的内窥镜系统 1 由内窥镜装置 2 和内窥镜插入方向检测装置（以下简记为插入方向检测装置）3 构成，其中，上述内窥镜插入方向检测装置 3 对从该内窥镜装置 2 输入的内窥镜图像的影像信号进行检测插入方向的图像处理。

[0041] 内窥镜装置 2 由如下部分构成：内窥镜 5，其被插入到作为被检体的例如大肠 4；控制装置 8，其具备对该内窥镜 5 提供照明光的光源部 6 和信号处理部 7；以及观察用监视器 9，其显示从信号处理部 7 输出的影像信号。

[0042] 从该信号处理部 7 输出的影像信号被输入到检测并显示插入方向的插入方向检测装置 3。

[0043] 内窥镜 5 具有：细长的插入部 11，其被插入到大肠 4 等；操作部 12，其被设置在该插入部 11 的后端；以及通用线缆 13，其从操作部 12 延伸出来。该通用线缆 13 的末端的连接器 14 安装和拆卸自如地连接在控制装置 8 上。

[0044] 控制装置 8 内的光源部 6 具有产生照明光的灯 15，该灯 15 的照明光被入射到内窥镜 5 的光导件 16 的入射端。被入射到该入射端的照明光被传送到插入部 11 的顶端部 17 的光导件出射端。并且，从该光导件发射端发射被传送的照明光，从而照明插入了插入部 11 的大肠 4 内部。

[0045] 在顶端部 17 上与光导件出射端相邻地设置有观察窗（摄像窗）。在该观察窗中配置有物镜 18 和配置在其成像位置上的例如电荷耦合元件（简记为 CCD）19。

[0046] 此外，在顶端部 17 的后端设置有弯曲自如的弯曲部 20。医生等操作者通过进行旋转被设置在操作部 12 上的弯曲把手 30 等的操作，能够使弯曲部 20 向上下、左右的任意方向弯曲。

[0047] 上述 CCD19 通过信号线被连接在构成控制装置 8 内的信号处理部 7 的 CCD 驱动电路 21。来自该 CCD 驱动电路 21 的 CCD 驱动信号被施加到 CCD19，由此 CCD19 输出

进行光电变换得到的摄像信号。

[0048] 该摄像信号被输入到信号处理电路 22，该信号处理电路 22 根据摄像信号例如生成模拟 RGB 信号的影像信号。

[0049] 该影像信号被输入到观察用监视器 9。在该观察用监视器 9 的显示面上显示被成像在 CCD19 的摄像面上的内窥镜图像。另外，被输入该影像信号的插入方向检测装置 3 是如图 2 所示那样的结构。

[0050] 该插入方向检测装置 3 由计算机 23 和显示装置 24 构成。模拟 RGB 信号通过计算机 23 内的 A/D 变换器 25 而被变换为数字的 RGB 信号之后被输入到进行输入输出控制的 I/O 控制部 26。

[0051] 该 I/O 控制部 26 被连接在进行插入方向检测的图像处理的中央处理装置（简记为 CPU）27、存储 CPU27 的图像处理的主程序 28a 的存储装置 28、以及显示装置 24 上。另外，CPU27 与主存储器 29 连接，其中，上述主存储器 29 作为进行插入方向检测的图像处理时的工作区域使用，暂时存储图像信息等。

[0052] 主程序 28a 是执行伴随本实施方式中的插入方向检测的一系列处理的程序。该主程序 28a 进行从 A/D 变换器 25 对 I/O 控制部 26 的图像信号的获取请求、向显示装置 24 的插入方向检测处理结果显示请求等。

[0053] 在本实施方式中，CPU27 具有如图 3 所示那样的处理功能。也就是说，CPU27 具有：场景特征量算出功能 27a，根据内窥镜图像的场景算出场景特征量；辨别分析功能（分类（classification）功能）27b，为了检测内窥镜插入方向，根据场景特征量的特征量向量，分类为与体腔内的内窥镜插入方向（换言之是体腔内的管腔构造）密切相关的、多个不同的特征量（具体地说是后述的管腔暗部、皱襞、其它）的类。

[0054] 另外，该 CPU27 具有分别与分类得到的多个不同的特征量的类相对应地算出插入方向的插入方向算出（检测）功能 27d。

[0055] 因而，在本实施方式中，在内窥镜图像中检测内窥镜插入方向时所使用的内窥镜图像的各场景中存在多个不同的特征量、或者与这些特征量对应的构造的情况下，也通过分类来分类为多个特征量，并且进行与分类得到的各特征量对应的插入方向的算出。由此，在本实施方式中能够适当地算出插入方向。

[0056] 此外，在本实施方式中，如图 3 所示，分类功能 27b 除了包含进行分类的功能以外，还包含算出多个特征量的类中的主要的特征量的类的主要类算出功能 27c。并且，实际上设为仅对主要的特征量的类进行算出插入方向的处理的结构，从而减少处理量。后面记述（图 14）没有这样减少处理量的情况。

[0057] 接着，参照图 4 的流程图来说明本实施方式的（内窥镜）插入方向检测方法的作用。

[0058] 如步骤 S1 所示，插入方向检测装置 3 的 CPU27 获取内窥镜图像的 RGB 图像中的、例如 R 图像，并暂时存储在主存储器 29、或者存储装置 28 中。

[0059] 然后，在下一个步骤 S2 中，CPU27 对取入的 R 图像的场景进行包含管腔暗部、皱襞等的场景特征量的算出处理。后面记述该场景特征量的算出。另外，关于各场景，可以是运动图像的内窥镜图像中的各帧，也可以是多个帧周期中的一帧。

[0060] 在下一个步骤 S3 中，CPU27 进行所算出的场景特征量的辨别分析的处理。

[0061] 对于辨别分析的处理,例如,可采用日本特开 2002-165757 号公报所公开的内容。

[0062] CPU27 将所算出的场景特征量作为特征量向量,使用统计的、或非统计的识别器进行辨别分析,通过该辨别分析,分类(或者类分类)为管腔暗部、皱襞、其它的、与内窥镜插入方向(或者管腔构造)密切相关的多个特征量的类。

[0063] 另外,如步骤 S4 所示,CPU27 在进行该分类之后,算出表示根据预先准备的教师数据的相似度的指标,在存在多个特征量的类的情况下,算出主要的特征量的类,其中,上述教师数据作为管腔暗部、皱襞、其它各特征量的类中的基准。

[0064] 然后,CPU27 根据在步骤 S4 中算出的主要的特征量的类进行接下来的分支处理。

[0065] 在作为主要的类算出了管腔暗部的情况下,如步骤 S5a 所示,CPU27 对 R 图像进行管腔暗部区域的检测处理。利用暗部检测用的阈值来检测规定尺寸以上的区域,由此进行管腔暗部区域的检测处理。另外,使用步骤 S2、或 S3 的处理中所使用的信息来检测管腔暗部区域。或者,例如也可以采用日本特公 2710384 号公报的暗部区域检测方法来进行。

[0066] 在检测该管腔暗部区域之后,如步骤 S6a 所示,CPU27 在所检测出的管腔暗部区域上、如图 5 所示那样将管腔暗部标记 Ma 显示在内窥镜图像上。或者,也可以如图 5 中的虚线所示那样显示从内窥镜图像的中心指向管腔暗部方向的插入方向标记 Ma'。

[0067] 另一方面,在步骤 S4 中,在作为主要的类算出了皱襞的情况下,如步骤 S5b 所示,CPU27 根据 R 图像进行皱襞的检测处理,之后,如步骤 S6b 所示,进行算出皱襞的重心位置的处理。

[0068] 能够使用在步骤 S2、或 S3 的处理中所使用的信息来进行皱襞的检测以及重心位置的算出处理。或者,也可以根据日本特公 2680111 号公报的皱襞检测以及皱襞的重心位置检测方法来算出皱襞的重心位置。

[0069] 然后,如步骤 S7 所示,CPU27 求出包含有皱襞的管腔的中心,如图 6 所示那样显示插入方向标记 Mb。

[0070] 另一方面,在步骤 S4 中,在作为主要的类而被分类为其它类的情况(也就是说,是无法充分地算出管腔暗部、皱襞的场景的情况)下,如步骤 S5c 所示,CPU27 根据 R 图像检测浓度梯度。对于该浓度梯度的检测处理,例如采用日本特开 2003-093328 号公报的浓度梯度检测方法。然后,CPU27 根据该浓度梯度检测方法求出内窥镜图像的浓度梯度。然后,向所检测出的浓度梯度的方向显示如图 6 所示那样的插入方向标记。

[0071] 这样,通过进行显示插入方向标记等的分支处理,成为步骤 S8 的分支处理结束。然后,返回到最初的步骤 S1,对下一个场景重复进行同样的处理。

[0072] 在本实施方式中,如图 4 所示,CPU27 进行如下处理:算出运动图像的内窥镜图像的各场景中的场景特征量,进一步进行场景特征量的辨别分析,分类为作为与内窥镜插入方向(换言之是管腔构造)密切相关的特征量的管腔暗部、皱襞、其它的特征量,根据主要的特征量的类的信息来检测插入方向,并显示插入方向的标记等信息。

[0073] 因而,医生根据插入方向的信息来进行弯曲操作,由此将插入部 11 的顶端侧导入到管腔暗部变得容易,能够平滑地进行插入作业。

[0074] 这样，本实施方式中的方法改进以往例进行被所提取或检测出的特征量的顺序所左右的插入方向的检测的缺点，进行高精确度的插入方向的检测。另外，在本实施方式中，在分类为多个特征量的类的情况下，CPU27 进行减少处理的控制使得不需要分别进行与被分类的多个特征量对应的插入方向的检测而仅对主要的特征量的类的情况进行检测。

[0075] 也就是说，CPU27 算出与主要的特征量对应的插入方向并显示所算出的插入方向，从而能够减少处理量。

[0076] 接着，说明场景特征量的算出、以及场景特征量的辨别分析（分类）。在本实施方式中，算出自相关系数、更具体地说是算出高次局部自相关系数，来算出场景特征量。关于该高次局部自相关系数，例如在非专利文献 1 的 O Plus E2003 年 10 月 pp1130～1136 “シーン理解のためのパターン認識 長谷川” 中有说明。

[0077] 算出场景特征量的方法是求出作为场景的图像内的纹理的场景特征量的方法。将高次局部自相关系数作为场景特征量的方法是如下的方法：定义被限定在局部区域（具体地说是 3×3 的像素区域）内的 n 点（通常使用 $n = 3$ ）的自相关函数，将它应用到图像整体，由此统计地算出场景特征量。

[0078] 图 7 示出了在本实施方式中的场景特征量的算出中使用的、作为二维的基准图案的高次局部自相关特征。在此，图中用 [1] 表示的像素部分的配置成为特征。并且，CPU27 对 R 图像设定 3×3 的局部区域，一边在 R 图像上使 3×3 的局部区域每次移动一个像素、一边进行与局部自相关系数的算出对应的处理，由此算出场景特征量，其中，在上述局部自相关系数的算出中，对图 7 的从 No.1 到 No.25 中的分别用图中 [1] 所表示的部分的像素值进行加法运算。

[0079] 在这种情况下，在图 8 和图 9 中示出了例如算出对于图 7 中的 No.2 的特征的特征量的例子。图 8 示出了在某个场景的图像中的左上角设定的最初的 3×3 的局部区域，在算出对于 No.2 的特征的场景特征量的情况下，将像素 a_{22} 和 a_{23} 的像素值 a_{22} 和 a_{23} （为了简单而用与像素相同的符号表示）相加。也就是说，CPU27 算出相加值 $a_{22}+a_{23}$ 。

[0080] 然后，CPU 27 将该 3×3 的局部区域向右侧平行移动一个像素而设定图 9 所示的 3×3 的局部区域，将这种情况下的像素值 $a_{23}+a_{24}$ 与在图 8 中求出的相加值相加。通过对各场景的全部图像进行这种处理，来算出对于 No.2 的特征的场景特征量。用 No.2 的情况进行了说明，但是其它 No. 的情况下也同样地进行这种处理。这样，能够算出 25 个场景特征量。

[0081] 在本实施方式中，在应用图 7 所示的 25 个特征的情况下，如图 10 所示那样进行图像的缩小处理并算出场景特征量，由此使场景特征量的算出处理高速化。

[0082] 图 10 示出了场景特征量的算出、以及将所算出的场景特征量视为特征量向量来进行分类的处理。

[0083] 如图 10 所示，当开始进行场景特征量的算出时，如步骤 S11 所示，CPU27 进行缩小图像的处理。在这种情况下，CPU27 用 512×512 的尺寸切出内窥镜图像中的 R 图像的摄像区域，并将该切出的图像例如缩小到 32×32 的尺寸。

[0084] 作为缩小该图像（换言之是变换分辨率）的缩小方法，使用作为公知技术的例如离散小波变换。图 11 示出了在离散小波变换中分解级别 2 的变换系数群（子带图像）。

用 HH1、LH1、HL1、HH2、LH2、HL2、LL2 表示通过离散小波变换生成的子带图像。

[0085] 在此，例如 HH1 表示在水平、垂直方向上都应用高通滤波器而得到的图像成分。另外，HHx 的 x 表示对于原图像的分解级别。并且，LH 表示在水平方向上应用低通滤波器、在垂直方向上应用高通滤波器而得到的图像成分，HL 表示在水平方向上应用高通滤波器、在垂直方向上应用低通滤波器而得到的图像成分，LL 表示在水平方向上应用低通滤波器、在垂直方向上应用低通滤波器而得到的图像成分。

[0086] 另外，通过将 LL1 分解为子带来导出 LL2、HL2、LH2、LL2。此外，在分解级别 1 的情况下，分解前的图像被分解为原图像的水平方向和垂直方向的尺寸成为 1/2 的四个变换系数 HH1、LH1、HL1、LL1（参照图 14）。

[0087] 这样，直到分解级别 4 为止进行利用离散小波变换的子带图像的生成，由此生成 32×32 的缩小图像。

[0088] 然后，如步骤 S12 所示，CPU27 算出上述高次局部自相关系数。

[0089] 然后，将所算出的 25 个场景特征量的数列视为特征量向量，如步骤 S13 所示，CPU27 进行分类为管腔暗部、皱襞、其它的特征量的类的辨别处理。

[0090] 在这种情况下，在进行分类的辨别处理的情况下，CPU27 参照例如预先存储在存储装置 28 中的、管腔暗部、皱襞、其它的情况下所具有的特征量向量的分布区域等的教师数据来进行。

[0091] 另外，通过算出表示管腔暗部、皱襞、其它与教师数据之间的相似度的指标，在存在多个特征量的类的情况下，CPU27 算出主要的特征量的类。然后，CPU27 如图 4 中说明的那样，对主要的特征量的类进行检测插入方向的处理，并显示所检测出的插入方向。

[0092] 进行这种处理的本实施方式在即使由于干扰等而产生或混入噪声也使用自相关系数算出场景特征量，因此能够几乎不受噪声影响而从各场景中高精度地算出与内窥镜插入方向（或管腔构造）密切相关的特征量。

[0093] 另外，在本实施方式中，即使在内窥镜图像中存在管腔暗部、皱襞等多个构造，也提取各场景特征量，并且将它们分类为管腔暗部、皱襞等特征量的类，用与主要的特征量的类对应的处理算法来算出插入方向并进行显示。

[0094] 因而，在本实施方式中，仅包含管腔暗部、皱襞等中的一个特征量的构造的情况下当然适当地算出插入方向并进行显示，在存在多个构造的情况下也适当地算出插入方向并进行显示，因此，医生能够平滑地进行插入作业、内窥镜检查。

[0095] 接着，说明对于图 10 的第一变形例。在图 10 中，对图像进行缩小并对缩小后的图像算出高次局部自相关系数，而第一变形例是简化的 CPU27 的处理方法，也就是说，CPU27 算出小区域的像素的平均值作为场景特征量。

[0096] 在本变形例中，CPU27 为了算出场景特征量而算出可以说是内窥镜图像的分辨率的变换的小区域的像素的平均值。

[0097] 图 12 示出了表示第一变形例的场景特征量的算出等的流程图。当开始进行场景特征量的算出处理时，在步骤 S31 中，CPU27 将拍摄得到的 R 图像例如分割为 8×8 的小区域，将小区域内的像素值的平均值设为小区域像素值，由此生成缩小图像。

[0098] 在下一个步骤 S32 中，CPU27 将该缩小图像中的小区域像素值视为场景特征

量的构成要素，对该小区域像素值进行扫描而算出将其数列作为特征量向量的场景特征量。

[0099] 在下一个步骤 S33 中，CPU27 使用该特征量向量进行辨别分析。

[0100] 在本变形例中，能够用比图 10 所示的处理方法更简单的处理进行特征量的分类。

[0101] 接着，参照图 13 所示的流程图说明图 10 的第二变形例。本变形例是 CPU27 利用直方图的处理方法。

[0102] 在本变形例中，为了不依赖于旋转和平行移动而算出场景特征量，采用将图像的像素值或频率特性的直方图与教师图像的直方图进行比较的方法。

[0103] 关于频率特性，使用上述的离散小波变换。

[0104] 并且，当开始进行场景特征量的算出时，在最初的步骤 S41 中，CPU27 对 R 图像进行上述的离散小波变换。

[0105] 通过步骤 S41，如图 14 所示，对于各分辨率的图像中的每个图像得到水平 (HL1)、垂直 (LH1)、倾斜 (HH1) 三个方向的频谱和低频成分 (LL1) 的各自的子带图像。

[0106] 在下一个步骤 S42 中，CPU27 对子带图像算出直方图。然后，在下一个步骤 S43 中，CPU27 通过比较直方图来进行分类 (classification)。此外，在此，说明了分解级别 1 时的子带图像的情况，但是也可以用分解级别 2 等的子带图像来进行。

[0107] 作为比较直方图的方法，例如采用使用了 x^2 分布的方法。在这种情况下，在比较 K 个直方图时，根据以下的式 (1) 来求出 K 个 x^2 分布的值，根据式 (2) 求出比较值 COMP。

$$[0108] \quad x^2 = \sum_i (q_i - h_i)^2 / (q_i + h_i) \quad (1)$$

$$[0109] \quad \text{COMP} = (1/K) \sum_{\alpha} (x^2_{\alpha}) \quad (2)$$

[0110] 在此， \sum_{α} 表示 $\alpha = 1$ 至 K 的总和， \sum_i 表示 i 的总和。另外， q_i 是比较 (检测) 对象的直方图的第 i 个频率值， h_i 是教师图像的直方图的第 i 个频率值。

[0111] 因此，对各个被分类的特征量的类事先准备与其特征量对应的教师图像的直方图，通过求出各自的 x^2 的分布，能够分类为其值较小的、教师图像所属的特征量的类。另外，还可以算出 x^2 分布的值最小的、教师图像所属的主要的特征量的类。

[0112] 这样，根据本变形例，利用直方图能够算出与内窥镜插入方向 (或者管腔构造) 相关的管腔暗部等特征量。并且，能够算出主要的特征量，并对该主要的特征量进行高精确度的插入方向的检测。

[0113] 此外，也可以不使用 x^2 分布，而使用相关系数 $(\sum_i q_i \cdot h_i - \sum_i q_i \cdot \sum_i h_i) / ((\sum_i q_i^2 - \sum_i q_i \cdot \sum_i q_i) \cdot (\sum_i h_i^2 - \sum_i h_i \cdot \sum_i h_i))^{1/2}$ 、或者差分 $\sum_i \min(q_i, h_i)$ 作为比较值。

[0114] 这样，在变形例的情况下，也能够算出与内窥镜插入方向 (或者管腔构造) 相关的特征量，能够进行高精确度地检测插入方向。

[0115] (第二实施方式)

[0116] 接着，参照图 15 至图 20 说明本发明的第二实施方式。在第一实施方式中，在进行场景特征量的辨别分析之后进行特征量的分类，并在该分类时算出主要的类。在本实施方式中，不进行算出主要的类的处理，而是进行与分类的结果相应的分支处理。

[0117] 图 15 示出了本实施方式的内窥镜插入方向检测方法。图 15 中设对与分类相应的处理进行分支的步骤 S4' 来代替图 4 中的算出主要的类的步骤 S4。

[0118] 因而，在本实施方式中，在场景中存在与多个特征量对应的构造的情况下，根据多个特征量来检测多个插入方向，并显示其结果。在这种情况下，当多个插入方向全部一致时，该插入方向的精确度较高。与此相对地，在多个插入方向不同的情况下，与全部一致地检测出的情况相比，插入方向的检测精确度较低。在这种情况下，医生根据该显示内容判断插入方向。

[0119] 因而，在本实施方式中，在场景中存在与多个特征量对应的构造的情况下，也消除以往例中的插入方向的检测结果受到特征量的检测（提取）顺序的影响的缺点。

[0120] 此外，作为本实施方式的变形例，也可以如在第一实施方式中说明的那样在插入方向的显示上反映出表示与预先准备的教师数据之间的相似度的指标的值的的信息。例如，也可以根据 指标值的大小来改变表示插入方向的箭头的大小，告知医生以最大的箭头显示的插入方向是以最高精确度检测出的插入方向。

[0121] 另外，下面说明在第一实施方式中也能够应用的、通过本实施方式中的特征量的分类而检测出管腔暗部的特征量的类的情况下（用于检测插入方向）高精度地检测管腔暗部的区域部分的检测方法。

[0122] 本实施方式中的管腔暗部的区域检测是改进了日本特公 2710384 号公报所记载的内容的方法。下面简单地说明该情况下的改进点。

[0123] 日本特公 2710384 号公报所记载的方法如下：生成多重分辨率的图像，比较上级 / 下级的层次间的亮度平均值，由此进行区域的分割、合并，检测具有规定的亮度范围的暗部区域。

[0124] 但是，该方法难以检测出具有平滑的亮度变化的暗部的情况下的其边界。另外，该方法仅比较亮度平均值，因此有可能误检测出分散较大的小区域、有纹理的小区域。

[0125] 更具体地进行说明，上述公报记载的方法如下：如图 16 所示，在作为管腔暗部的区域而被检测出的在分辨率 A 下的用实线表示的像素（原图像中的矩形的小区域）的像素值（包含在小区域内的像素的平均值）与相邻的像素（分辨率 A 下的用虚线表示的小区域）的像素值的差或比在规定的阈值内的情况下，合并该小区域。

[0126] 另外，该方法利用进行四分割的四叉树结构的多重分辨率的图像，对当前的下级层次的图像中的接近的小区域进行合并，求出管腔暗部的区域的外形线。

[0127] 也就是说，关于当前的下级层次的图像（如图 16 所示，成为分辨率 A 的下级的分辨率 B 的图像），接近与分辨率 A 下的管腔暗部的区域的像素相同的位置上存在的像素（图 16 中的分辨率 B 下的、用粗实线表示的四个小区域）的、用虚线表示的像素（分辨率 B 下的、用虚线表示的小区域）的像素值之间的差或比在规定阈值以内的情况下，合并该小区域。

[0128] 这样，上述公报的方法对于分辨率 A、分辨率 B 的像素值使用将像素视为小区域的情况下的、包含在小区域内的原图像的像素值的平均值。

[0129] 但是，存在如下问题：在如图 17 所示那样小区域内存在边缘、纹理的情况、存在浓度梯度的情况下，无法正确地进行判断，导致提取错误的管腔暗部的区域。例如，

图 17 的右侧的三个各小区域内的像素值平均值全部相同。因此，在上述方法中，由于这些小区域具有相同的平均值，因此对它们进行合并处理，从而有可能导致提取错误的管腔暗部的区域。

[0130] 因此，在本实施方式中，不进行图 17 那样的误提取（误合并）而适当地进行合并处理。因此，本实施方式的 CPU27 进行图 18 和图 19 那样的处理。

[0131] 当开始进行管腔暗部的检测时，在图 18 的步骤 S51 中，CPU27 根据所取入的 R 图像生成像素数不同的多个图像。

[0132] 然后，在下一个步骤 S52 中，CPU27 在通过之前的步骤 S51 生成的多个图像中从像素数较少的图像开始依次检查该图像中的各像素的亮度，并提取规定的像素数的图像中的、与管腔暗部相当的暗部区域。

[0133] 在下一个步骤 S53 中，CPU27 进行如下的合并处理：将作为在之前的步骤 S52 中求出的暗部区域附近的区域的、要求的亮度范围内的区域与在之前的步骤 S52 中求出的暗部区域进行合并。这样，CPU27 通过进行从步骤 S51 到步骤 S53 的处理来检测与管腔暗部相当的暗部区域。

[0134] 另外，图 19 示出了本实施方式中的步骤 S53 的细节。当开始进行步骤 S53 的处理时，在步骤 S61 中，CPU27 算出所提取的暗部区域的灰度水平（R 的平均值）。在这种情况下，例如作为图 16 所示那样的某个分辨率 A 的图像中以实线表示的暗部区域（在之前的步骤 S52 中提取）内的灰度水平，求出该区域内的 R 的平均值。

[0135] 另外，CPU27 求出与该暗部区域接近的区域（例如，图 16 的分辨率 A 中的、用虚线包围的区域）中的灰度水平（即，R 的平均值）、浓度梯度角的分散、以及变动系数（C.V、将标准偏差除以平均值而得到的值）。

[0136] 根据如图 20 所示那样作为对象的 3×3 的小区域中的、从像素 a11 起第三个像素的浓度值的梯度或者差信息，根据 X 方向浓度梯度与 Y 方向浓度梯度的正切来求出浓度梯度角。

[0137] 具体地说，在如图 20 所示那样表示像素的情况下，用 $\theta = \arctan(a_{31}-a_{11}) / (a_{13}-a_{11})$ 来算出浓度梯度角 θ 。另外，浓度梯度角的分散是指包含在区域内的像素的位置的浓度梯度角的分散。

[0138] 在下一个步骤 S62 中，CPU27 检查与所提取的区域内的灰度水平接近的区域的灰度水平之间的差或比是否在规定的范围内。然后，如果在规定的范围内则进入下一个步骤 S63。另一方面，在不在规定的范围内的情况下，转移到步骤 S66 的处理。

[0139] 在接下来的步骤 S63 中，CPU27 检查接近的区域的变动系数是否在规定的范围内。然后，如果接近的区域的变动系数在规定的范围内则 CPU27 进入下一个步骤 S64。另一方面，在接近的区域的变动系数不在规定的范围内的情况下，CPU27 转移到步骤 S66 的处理。

[0140] 在接下来的步骤 S64 中，CPU27 检查接近的区域的浓度梯度角的分散是否在规定的范围内。然后，如果接近的区域的浓度梯度角的分散在规定的范围内，则 CPU27 进入下一个步骤 S65。另一方面，在接近的区域的浓度梯度角的分散不在规定的范围内的情况下，CPU27 转移到步骤 S66 的处理。

[0141] 在满足从步骤 S62 到步骤 S64 的条件的情況下，在步骤 S65 中，CPU27 将该接

近的区域与已得到的暗部区域进行合并，并返回到步骤 S61。

[0142] 另一方面，在不满足从步骤 S62 到步骤 S64 所示的条件中的任一个的情况下，如步骤 S66 所示，CPU 27 根据当前的分辨率的设定值判断是否需要更高精确度的检查。如果当前的分辨率的设定值与规定的终端分辨率的设定值相同，则 CPU 27 结束该处理。如果不相同，则 CPU 27 对下一个叉树级别（分辨率）的图像进行相同的处理。例如，在用图 16 的分辨率 A 进行的情况下，CPU 27 关于在其下面示出的分辨率 B 进行同样的判断处理。然后，CPU 27 返回到步骤 S61。

[0143] 在本实施方式中，对与初始的管腔暗部相当的暗部区域递归地进行处理，由此扩大管腔暗部的区域，提高管腔暗部区域的外形线（轮廓）的精确度。

[0144] 如上所述，在本实施方式中，在接近的区域之间的合并处理中，不仅考虑接近区域的像素平均值，还考虑接近区域的像素值的变动来进行比较，由此对具有大致一样的像素值分布的区域进行合并，能够提高管腔暗部的区域的检测精确度。

[0145] 另外，在本实施方式中，在接近的区域之间的合并处理中，对接近的区域的浓度梯度角的分散进行比较，由此对具有平滑的梯度的区域进行合并，能够提高管腔暗部的区域的检测精确度。

[0146] 由于进行这种合并处理，因此能够防止例如如图 17 所示那样、在仅是灰度水平进入规定范围内的情况下进行合并而导致 的误合并，能够检测高精度的管腔暗部的区域。因而，在本实施方式中，通过提高管腔暗部的区域的检测精确度，内窥镜插入方向的检测精确度提高。

[0147] （第三实施方式）

[0148] 接着，参照图 21 至图 25 来说明本发明的第三实施方式。本实施方式也与第二实施方式同样地提供精确度良好地检测管腔暗部的方法。本实施方式中的检测管腔暗部的方法是图 21 的流程图所示的方法，该方法改进了例如日本特开 2003-93328 号公报所公开的方法。

[0149] 在这种情况下，日本特开 2003-93328 号公报的以往例所公开的方法在例如如图 22 所示的内窥镜图像那样除了管腔暗部的区域 C 以外还存在暗部区域 D 的情况下，难以精确度良好地检测出想要检测的管腔暗部的区域 C。此外，在该例中，在管腔暗部的区域 C 内，在其内部存在由肠管弯曲、皱襞所引起的亮区域和暗区域 E。

[0150] 并且，图 23 示出了连接图 22 中的管腔暗部的区域 C 和暗部区域 D 的线段 F、F' 上的浓度值。

[0151] 在上述以往例中，需要唯一地决定检测管腔暗部的区域 C 的阈值。作为该决定方法，广泛地使用全画面内的像素值的直方图的解析等。

[0152] 在所决定的阈值是 T 的情况下，只能提取图 22 的由 E 包围的区域。另外，在所决定的阈值是 T' 的情况下，导致还提取暗部区域 D 的一部分。这样，在以往例中存在如下问题：需要对每个图像决定最佳的阈值，难以精确度良好地检测管腔暗部的区域 C。

[0153] 因此，在本实施方式中，利用图 21 的流程图所示出的检测方法来提取管腔暗部的区域 C。该检测方法成为仅提取图 22 中的管腔暗部的区域 C 的方法。

[0154] 如图 21 所示，在最初的步骤 S71 中，CPU27 将内窥镜图像分割为小区域。在本实施方式中，为了使说明简单，用如图 25 所示那样分割为 4×4 个矩形的小区域 bxy(x

= 1 ~ 4, y = 1 ~ 4) 的例子进行说明。

[0155] 在下一个步骤 S72 中, CPU27 求出各小区域 bxy 的像素值的平均值 $\langle bxy \rangle$ 。在本实施方式中, 求出与内窥镜图像对应的 RGB 色彩信号中的 R 的平均值。

[0156] 在下一个步骤 S73 中, CPU27 对各个小区域 bxy, 将接近的 8 个方向 (在四角处 3 个方向, 沿外周的小区域中 5 个方向) 的像素值的平均值与处理对象的自小区域 bxy 的像素值的平均值 $\langle bxy \rangle$ 进行比较 (或者算出差值), 来求出浓度梯度方向。如果自小区域 bxy 的像素值的平均值 $\langle bxy \rangle$ 是进行比较的接近小区域中的最小值, 则将浓度梯度方向设为 0。

[0157] 具体地说, 在最初的小区域 b11 的情况下, 当用差值来表现时, 在 $\langle b21 \rangle - \langle b11 \rangle$ 、 $\langle b22 \rangle - \langle b11 \rangle$ 、 $\langle b12 \rangle - \langle b11 \rangle$ 的差值为负的情况下, 将其绝对值为最大的方向设为浓度梯度方向。

[0158] 在该小区域 b11 的情况下, $\langle b21 \rangle$ 的平均值最小, 因此浓度梯度方向成为从小区域 b11 朝向小区域 b21 的方向。这样, 得到图 25 所示那样的浓度梯度方向的分布 (排列) 信息。

[0159] 此外, 在算出上述那样的差值时、其值全部为正的情况下, 如上所述那样将浓度梯度方向设为 0。图 25 中的小区域 b21、b42 (b21 等的符号参照图 24) 成为浓度梯度方向 = 0 的小区域。

[0160] 在下一个步骤 S74 中, CPU27 依次提取没有产生向接近小区域的浓度梯度的、即浓度梯度方向 = 0 的小区域。

[0161] 然后, 在下一个步骤 S75 中, CPU27 判断在步骤 S74 的处理中是否提取出没有产生浓度梯度的小区域, 在没有提取出这种小区域的情况下, 结束该处理, 在提取出的情况下, 进入步骤 S76 的处理。

[0162] 在步骤 S76 的处理中, CPU 27 对没有产生浓度梯度 (浓度梯度方向 = 0) 的小区域判断是否满足如下条件: 接近该小区域的所有的小区域的浓度梯度向朝向一个小区域集中。

[0163] 关于图 25 中的例如小区域 b21, 下、右下、右的接近小区域的浓度梯度没有朝向该小区域 b21。因此, CPU27 判断为步骤 S76 的判断结果是“否”, 返回到步骤 S74。

[0164] 另一方面, 使小区域 b42 介于中间, 所有的接近小区域的浓度梯度都向小区域 b42 集中。这样, 在所有的接近小区域的浓度梯度都向一个小区域集中的情况下, 如步骤 S77 所示, CPU27 将该小区域作为管腔暗部的区域候选而进行标记。

[0165] 在图 25 的内窥镜图像的情况下, 将小区域 b42 作为管腔暗部的区域候选而进行标记。然后, 在步骤 S78 中, CPU27 判断是否为不存在浓度梯度的小区域中的最后的小区域, 在不是最后的小区域的情况下, 返回到步骤 S74, 在进行到最后的小区域的情况下, 进入步骤 S79。

[0166] 在步骤 S79 中, CPU27 从通过以上的处理而被标记的管腔暗部的区域候选中决定最终的管腔暗部的区域。在这种情况下, 有时多个管腔暗部的区域候选被标记。在这种情况下, CPU27 将多个管腔暗部的区域候选中的、像素平均值是最小值的管腔暗部的区域候选决定为管腔暗部的区域。

[0167] 此外, 在本实施方式中, 将图像设为分割成 4×4 的矩形小区域, 但是, 即使利

用例如维诺图 (voronoi) 的非矩形区域、日本特公 2710384 号公报中的作为多重分辨率图像的区域合并的结果而得到的区域来进行处理,也能够得到与本实施方式的目的对应的效果。

[0168] 在本实施方式中,将图像分割为小区域,对分割得到的各小区域调查接近的小区域的浓度梯度,并将浓度梯度全部朝向一个地集中的小区域设为管腔暗部的区域候选,由此不依赖于阈值而能够进行正确的管腔暗部的区域的检测。因而,根据本实施方式,内窥镜插入方向检测的精确度提高。

[0169] 在图 21 中的步骤 S76 的判断中,在进行了是否满足所有浓度梯度向一个小区域集中的条件的判断时,在符合的小区域一个也不存在的情况下,也可以将浓度梯度最集中的小区域显示为有可能是管腔暗部的候选。

[0170] 根据上述各实施方式所记载的本发明的内窥镜插入方向检测装置的结构,在存在与内窥镜插入方向相关的多个特征量的场景的情况下,也能够进行高精度的插入方向的检测。

[0171] 根据具备上述步骤的本发明的内窥镜插入方向检测方法的结构,在存在与内窥镜插入方向相关的多个特征量的场景的情况下,也能够进行高精度的插入方向的检测。

[0172] 即,根据本发明,在存在与内窥镜插入方向相关的多个特征量的场景的情况下,也能够进行高精度的插入方向的检测。

[0173] 详细地说,在本发明中,算出由被插入到体腔内的内窥镜拍摄得到的内窥镜图像的场景中的场景特征量,并分类为与内窥镜插入方向相关的管腔暗部、皱襞等特征量的类,检测与所分类的特征量相应的插入方向,由此在多个特征量混合存在的内窥镜图像的情况下,也能够进行精确度良好的插入方向的检测。

[0174] 另外,本发明并不是仅限于上述的实施方式,在不脱离发明要旨的范围内可进行各种变更。

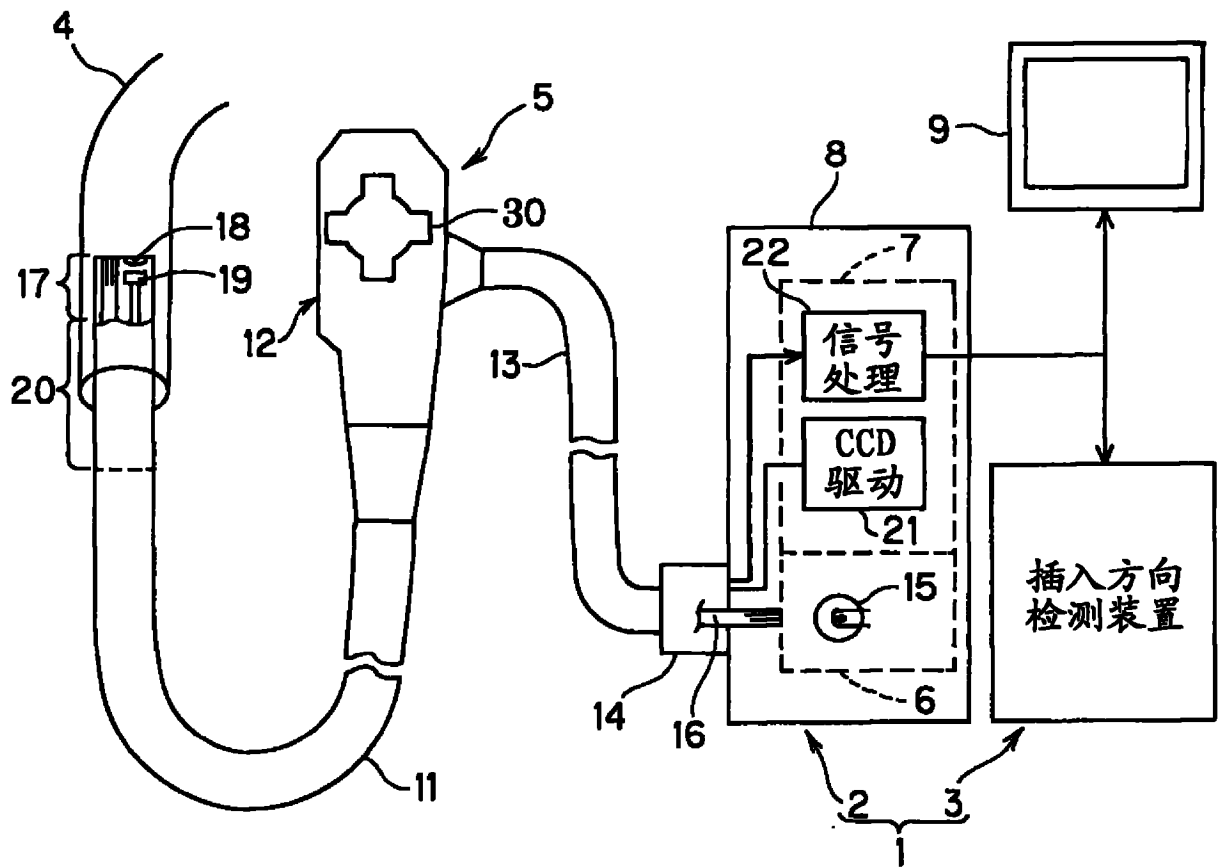


图 1

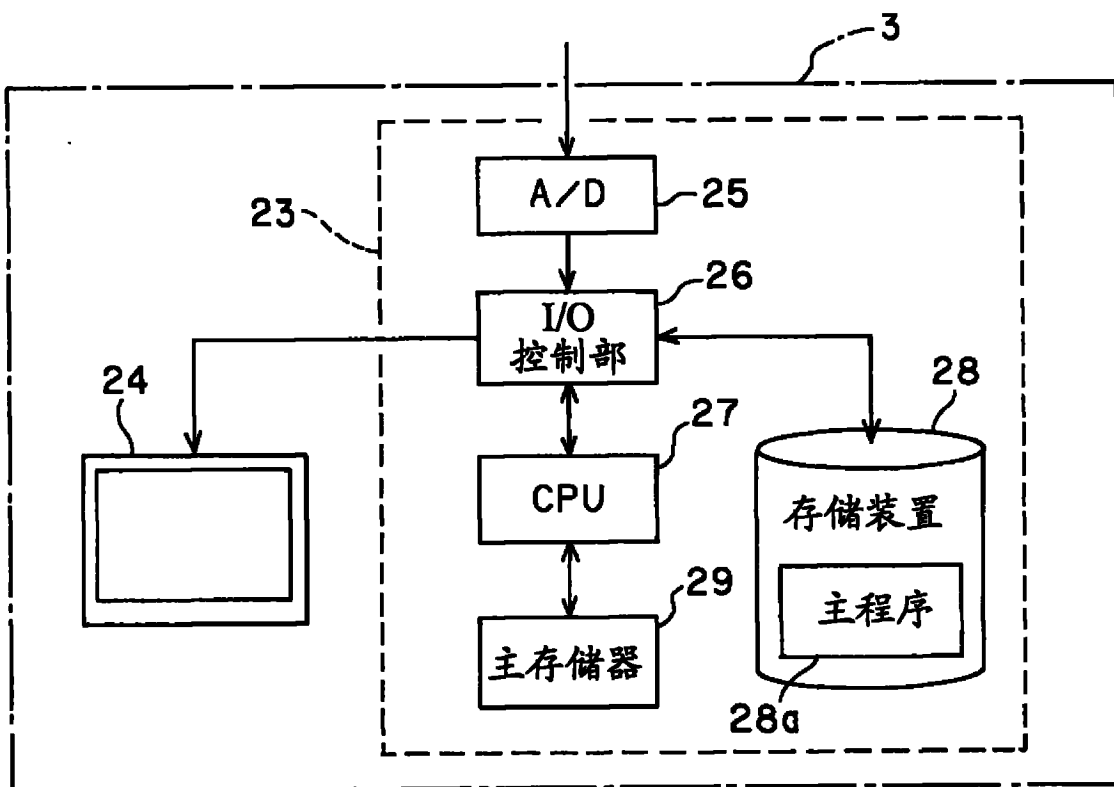


图 2

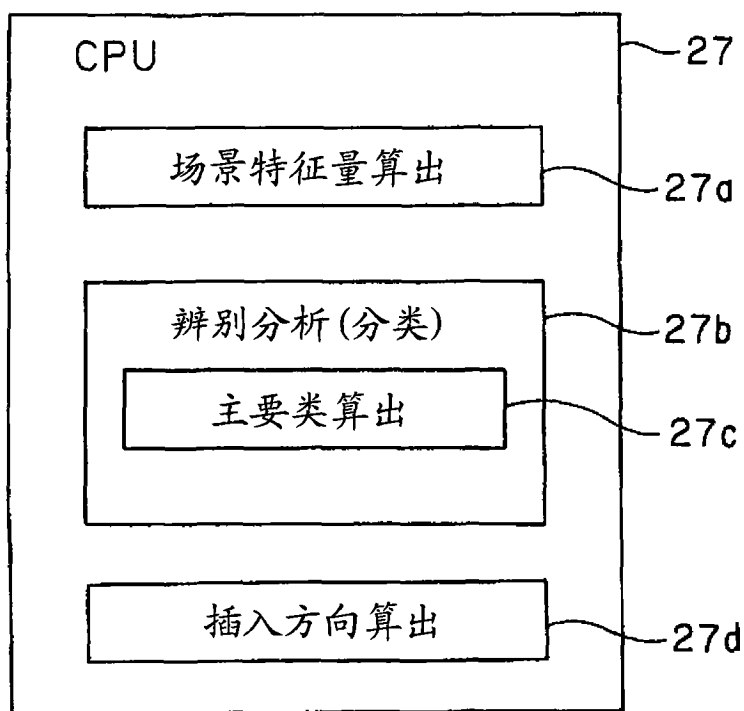


图 3

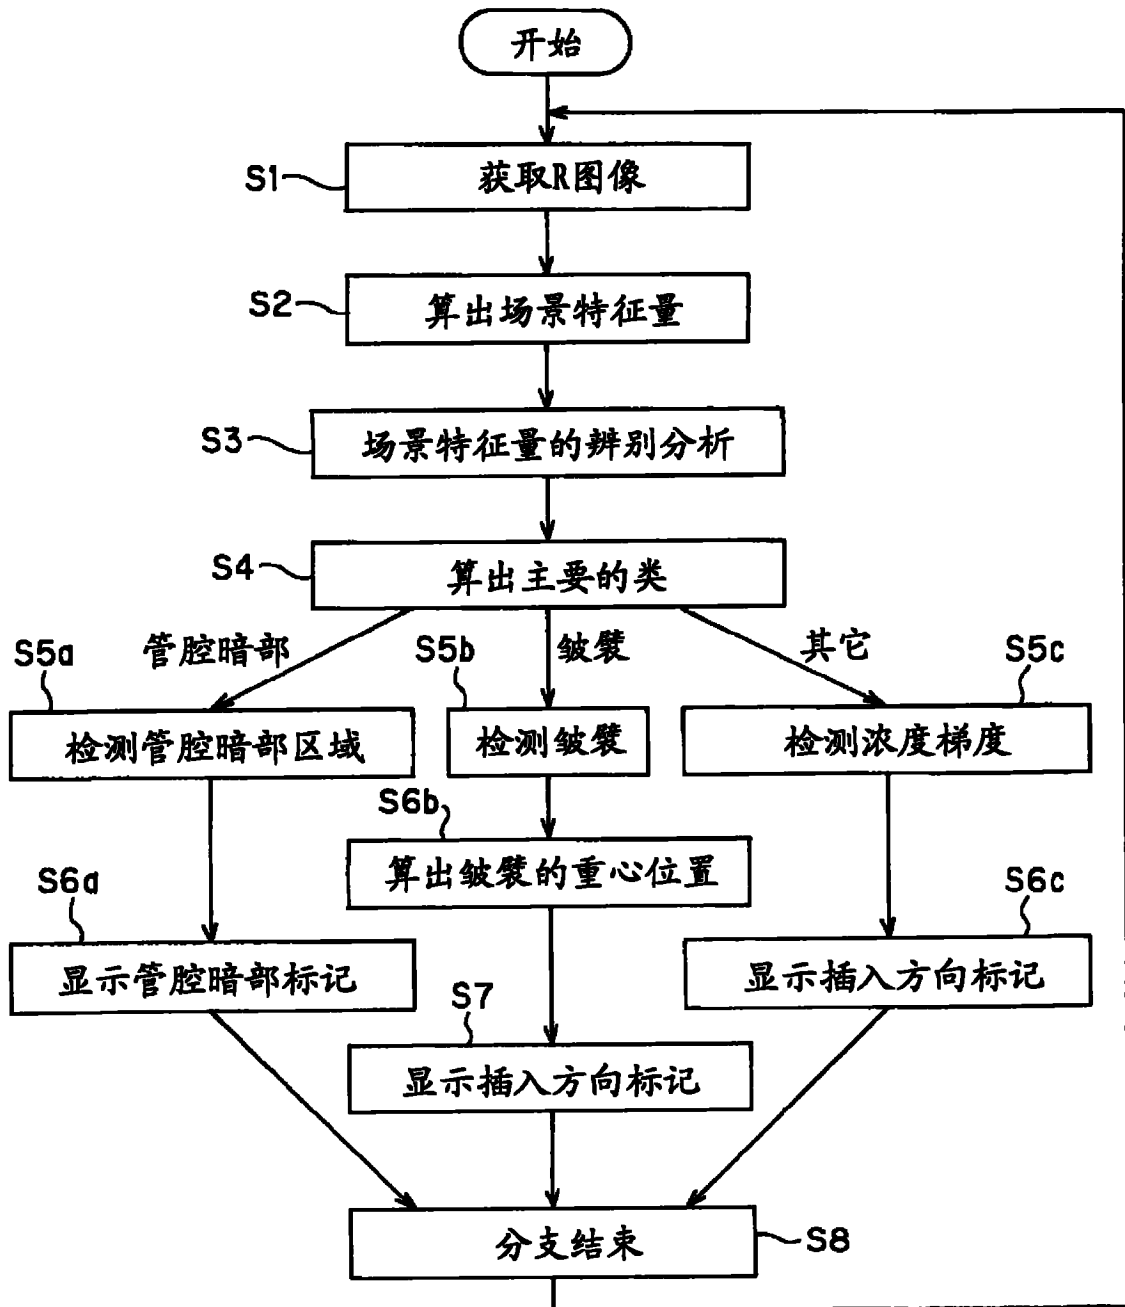


图 4

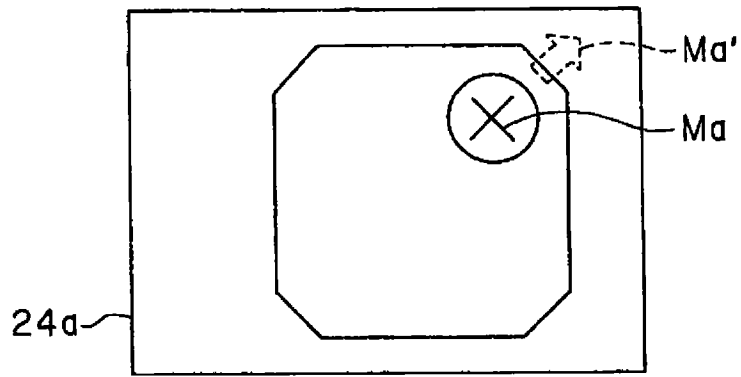


图 5

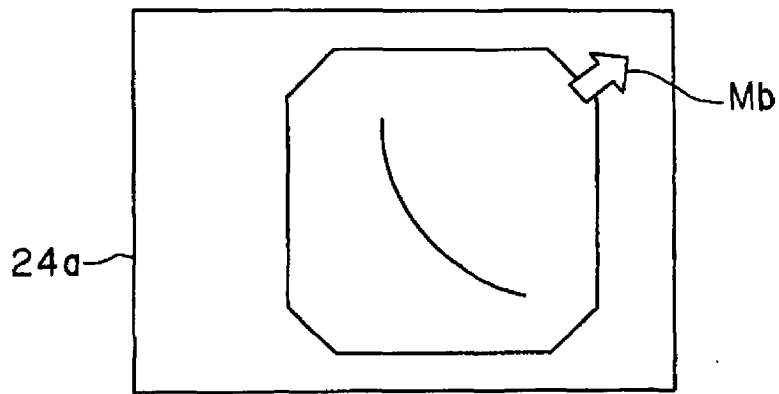


图 6

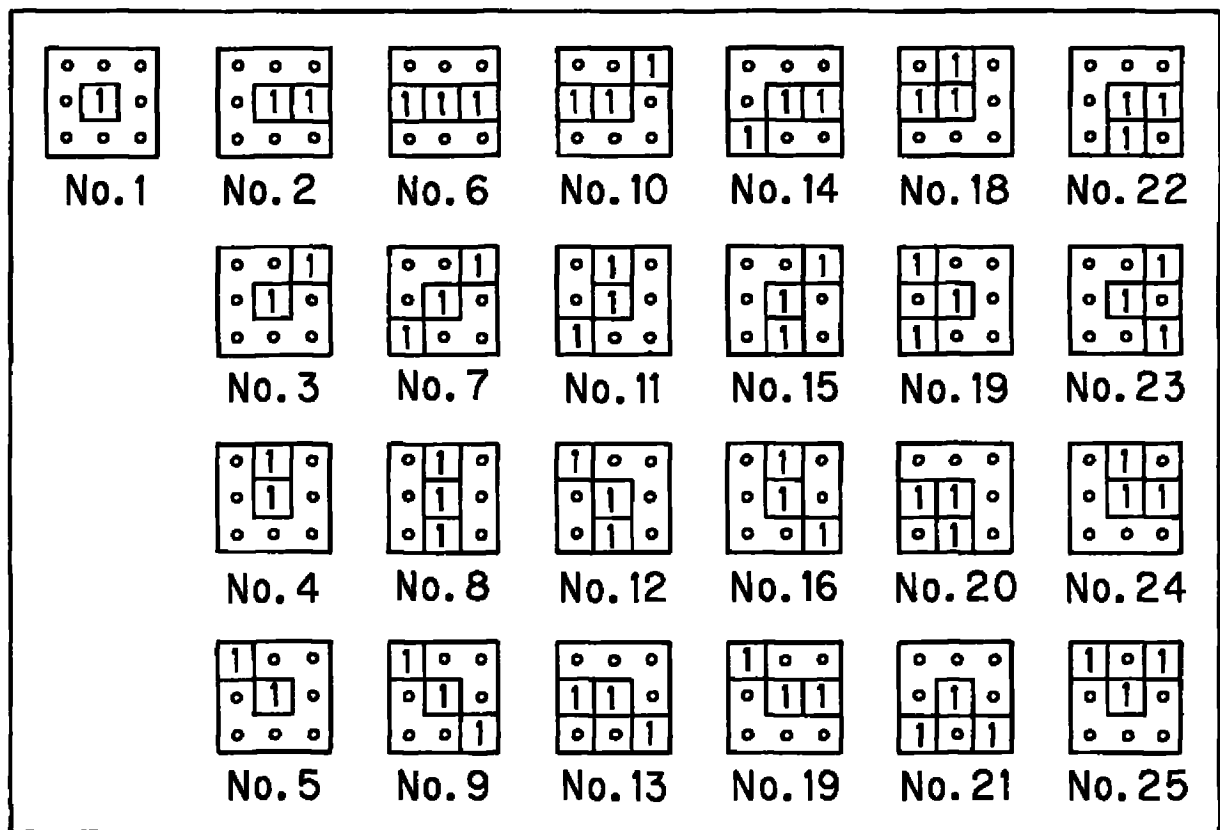


图 7

| | | | |
|-----|-----|-----|--|
| a11 | a12 | a13 | |
| a21 | a22 | a23 | |
| a31 | a32 | a33 | |
| | | | |

$a_{22} + a_{23}$

图 8

| | | | |
|-----|-----|-----|--|
| a12 | a13 | a14 | |
| a22 | a23 | a24 | |
| a32 | a33 | a34 | |
| | | | |

$a_{23} + a_{24}$

图 9

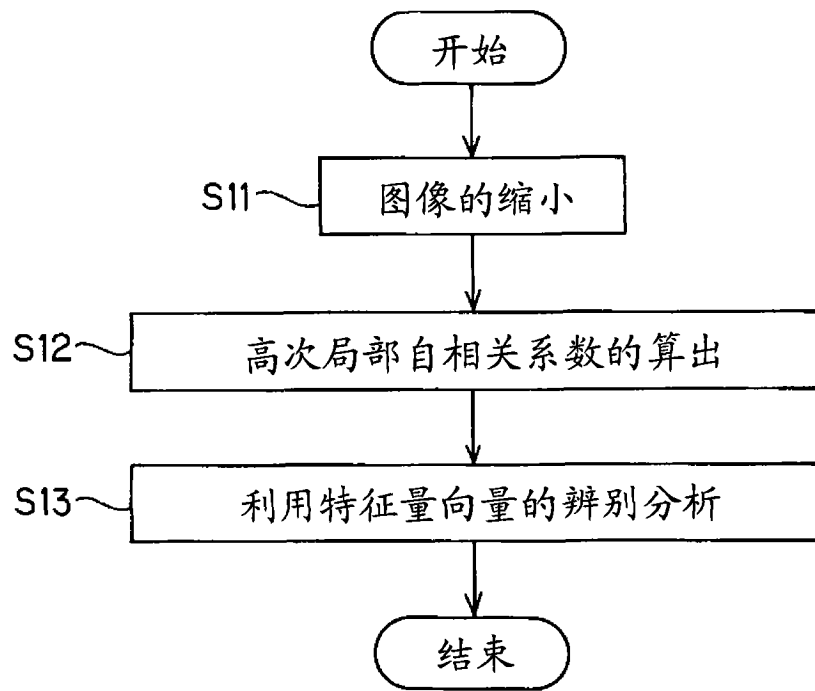


图 10

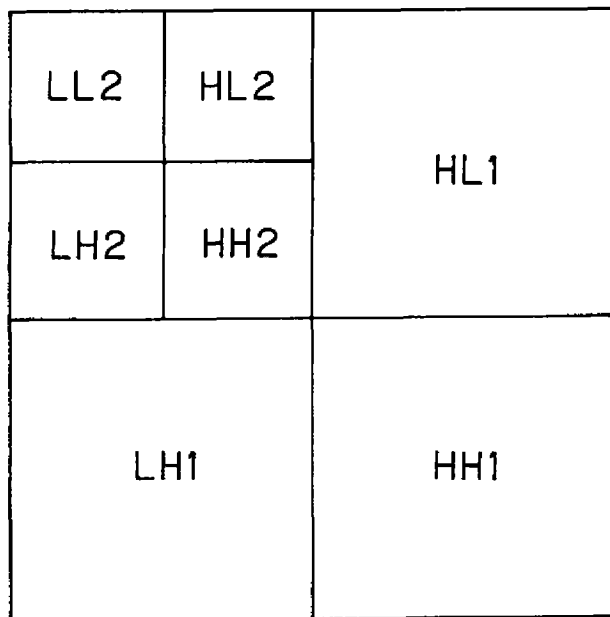


图 11

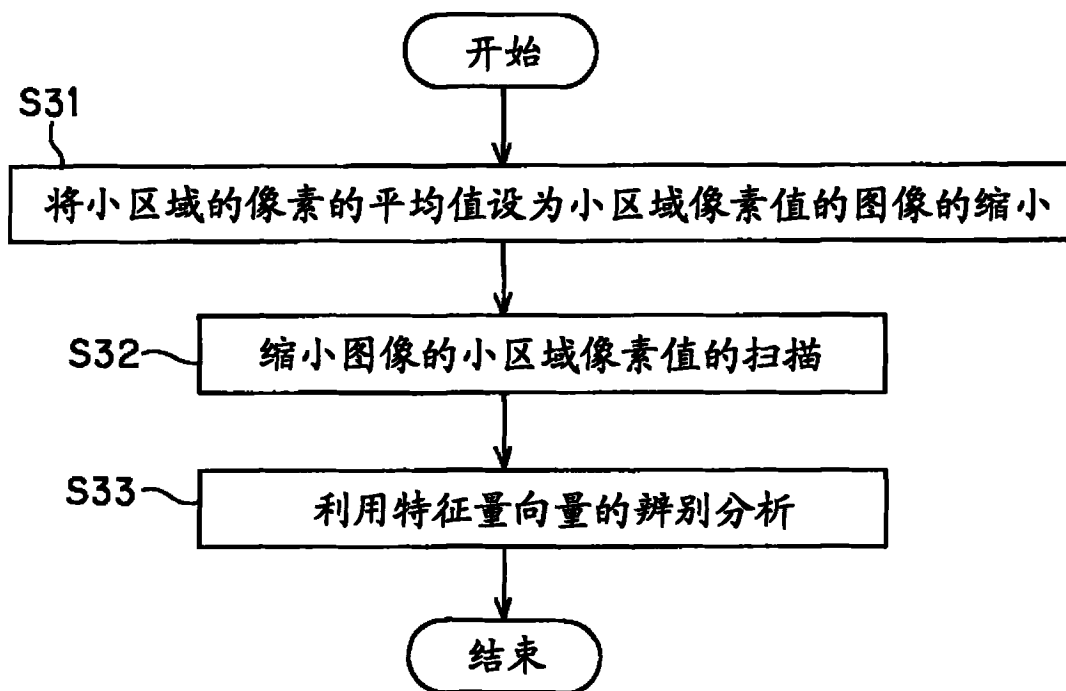


图 12

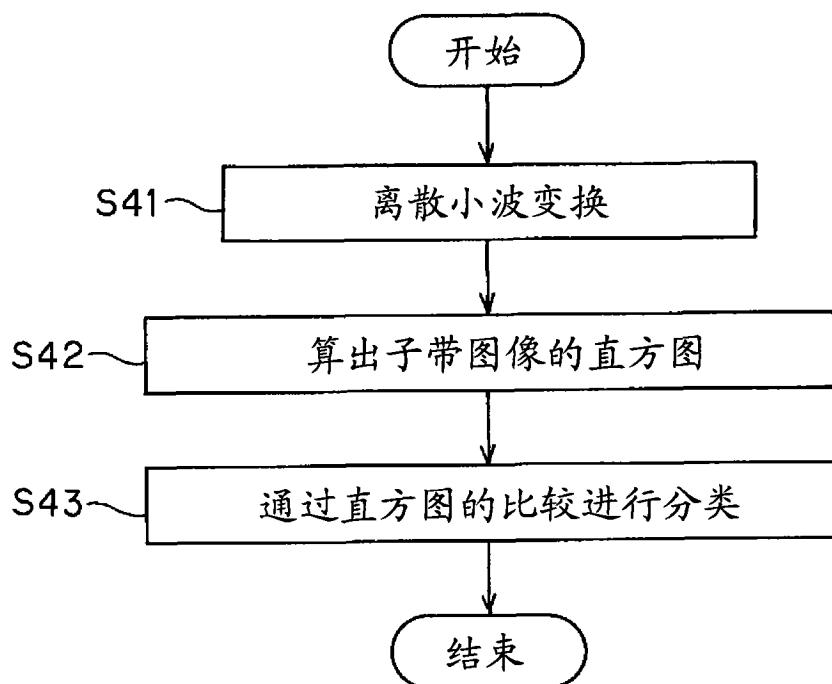


图 13

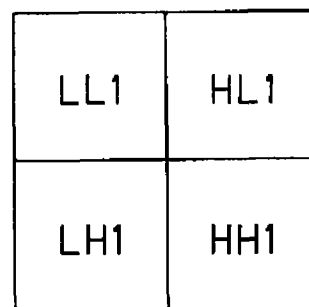


图 14

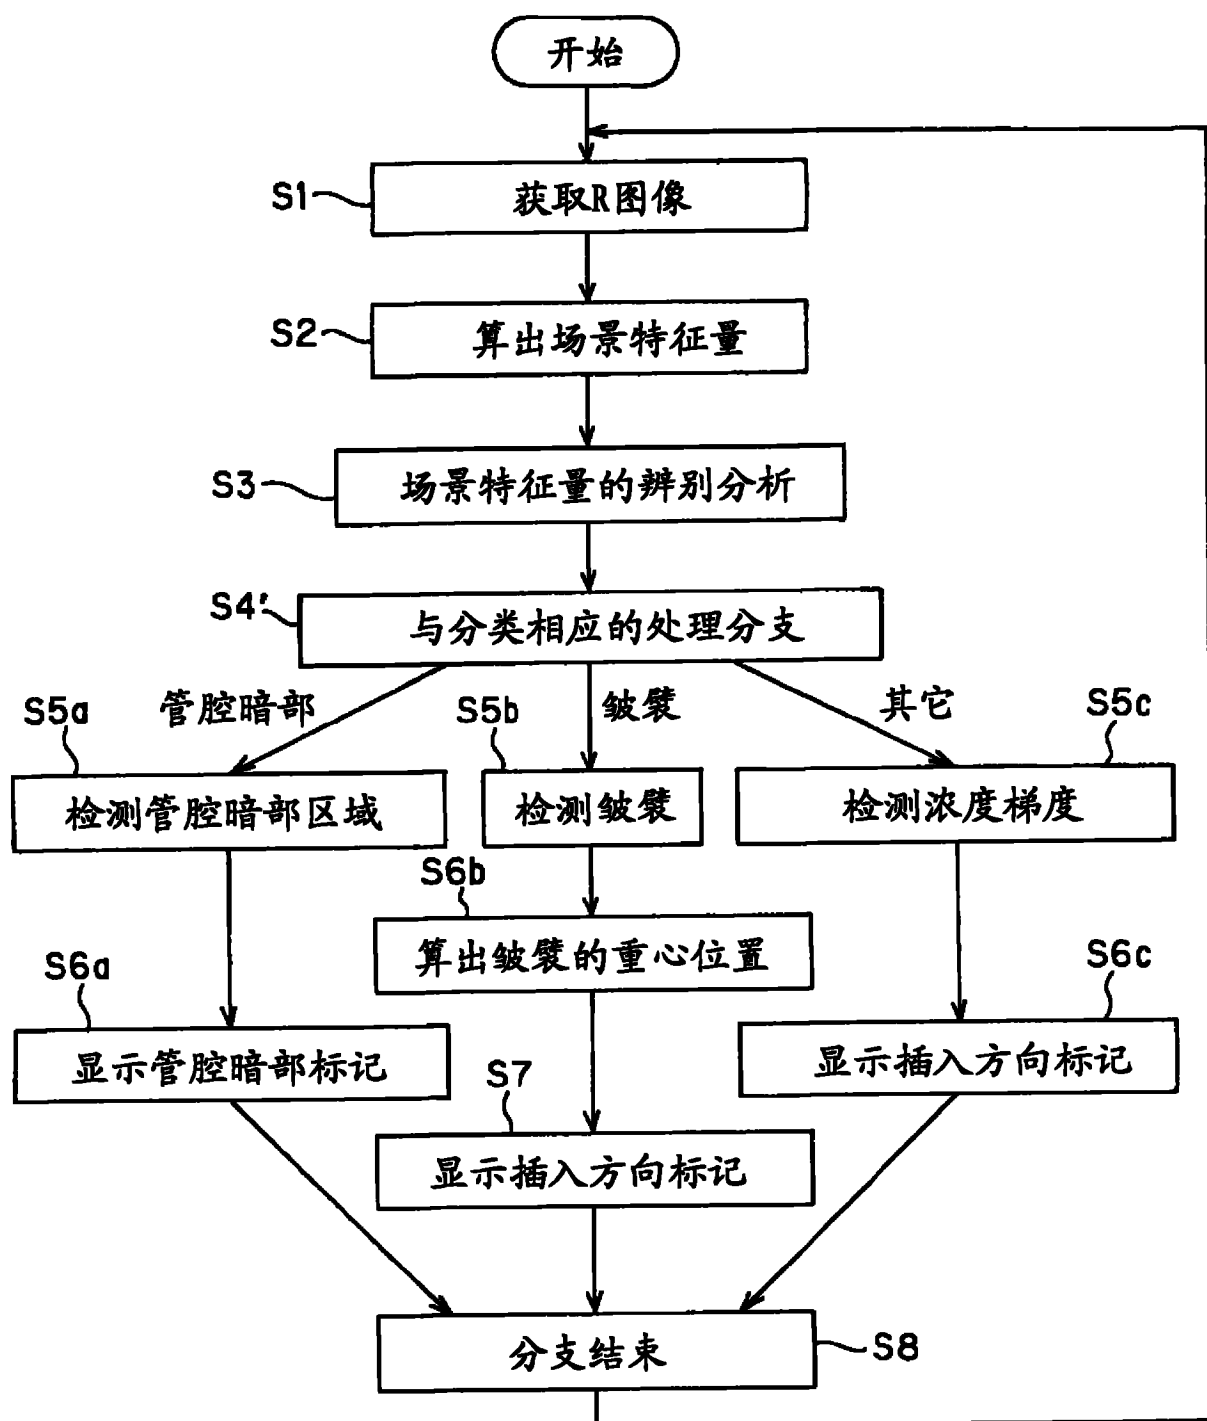


图 15

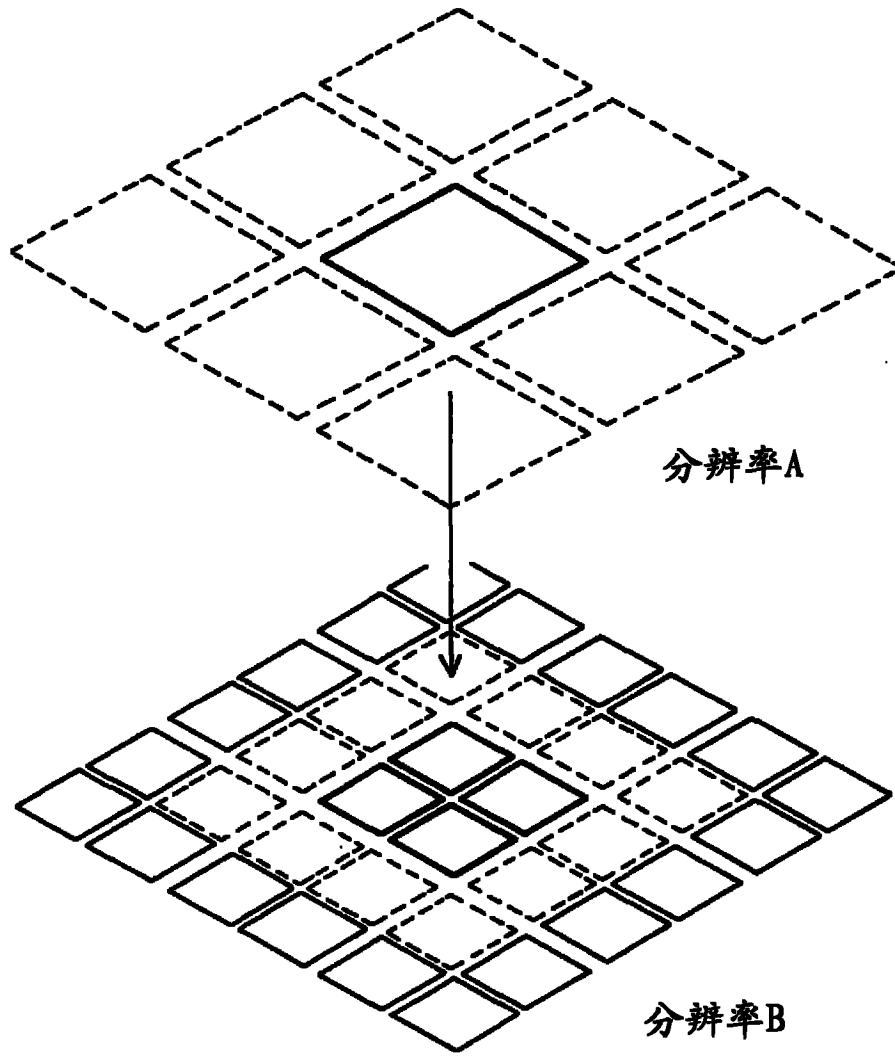


图 16

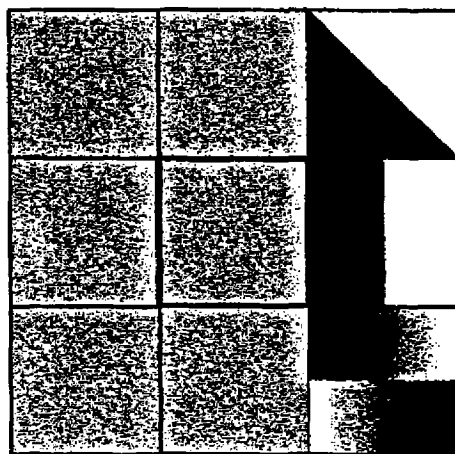


图 17

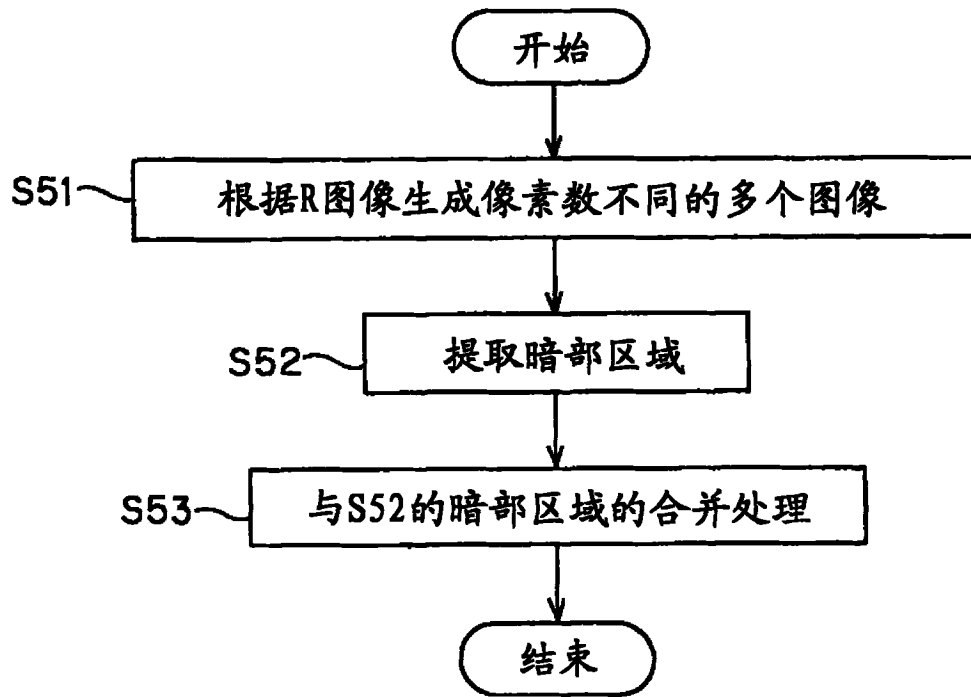


图 18

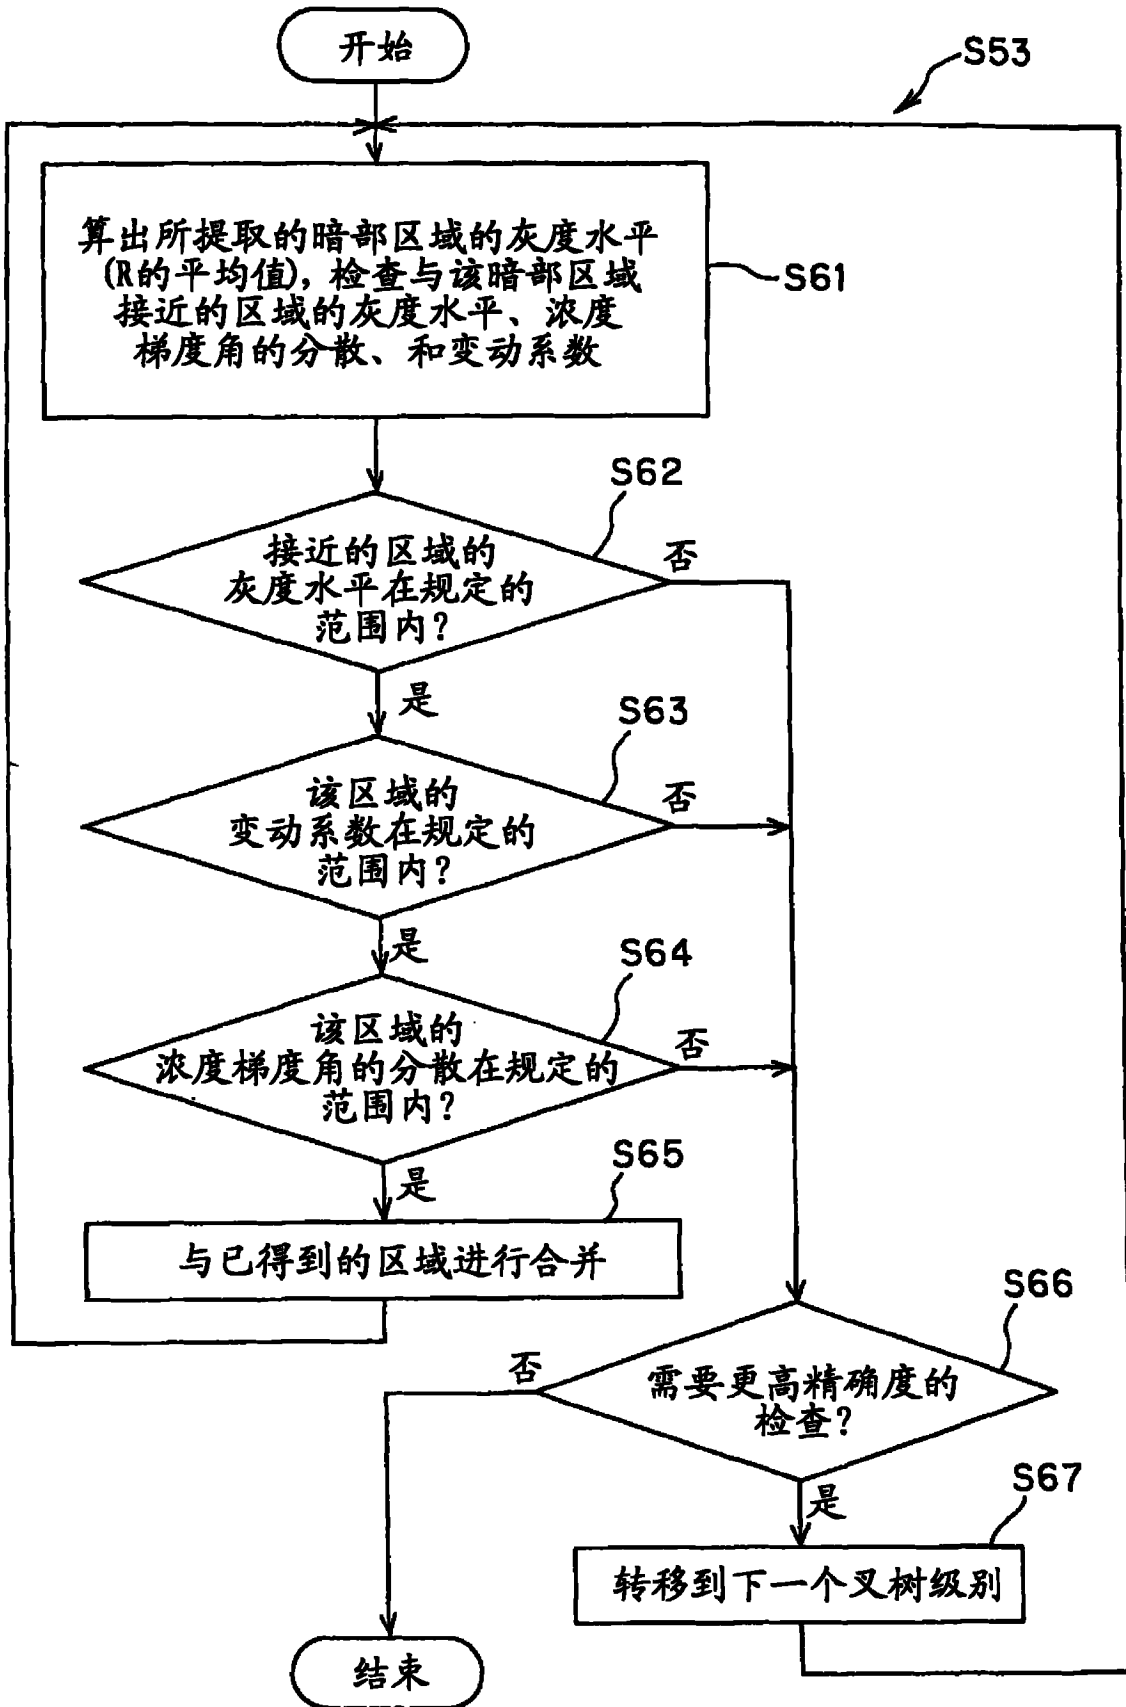


图 19

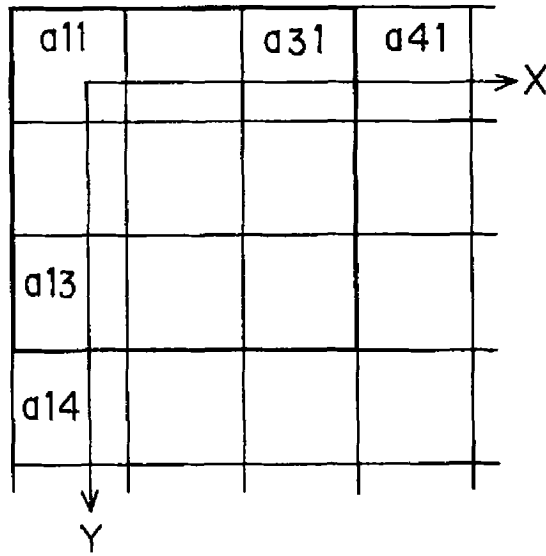


图 20

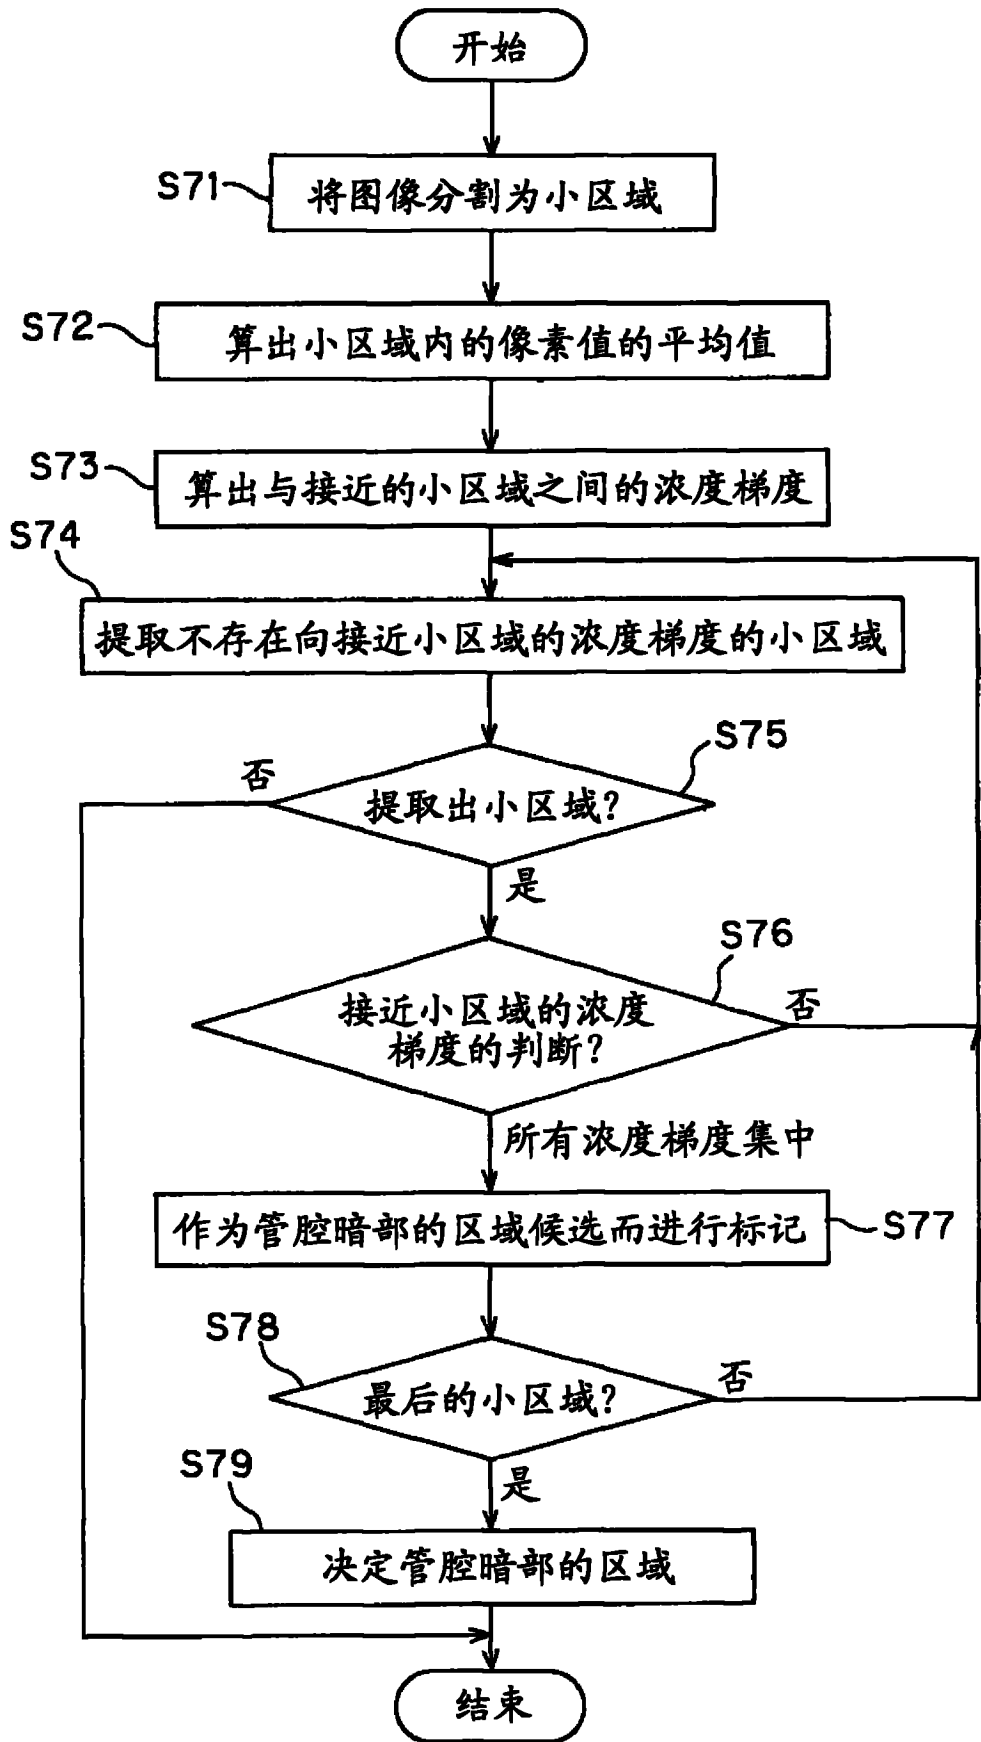


图 21

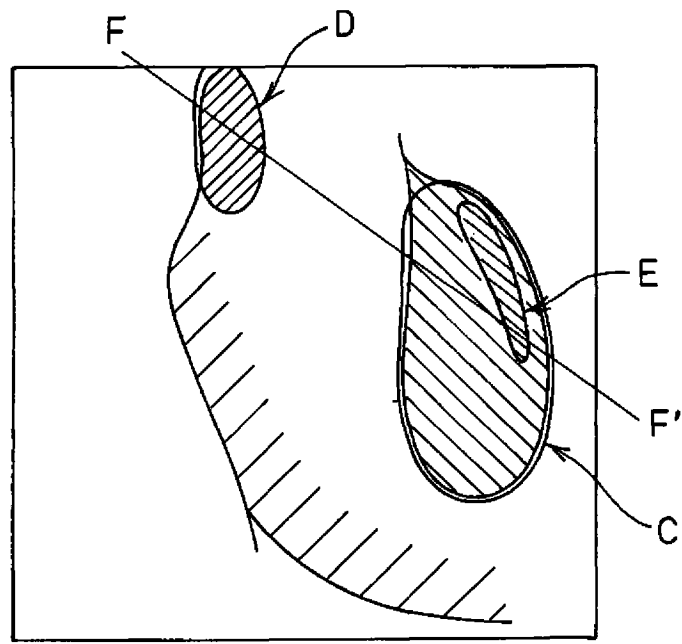


图 22

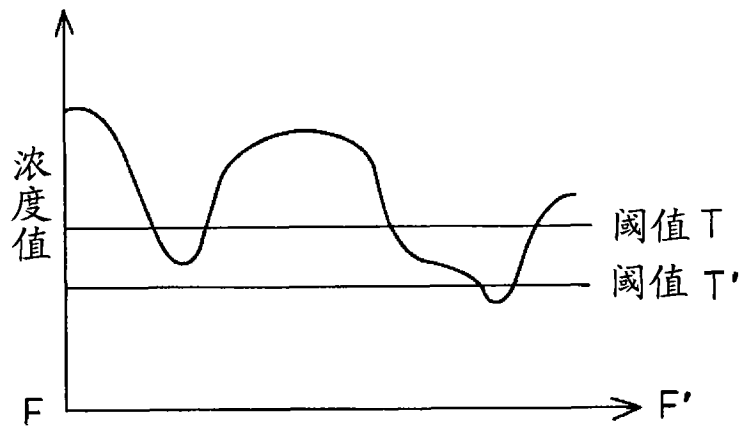


图 23

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| b11 | b21 | b31 | b41 |
| b12 | b22 | b32 | b42 |
| b13 | b23 | b33 | b43 |
| b14 | b24 | b34 | b44 |

图 24

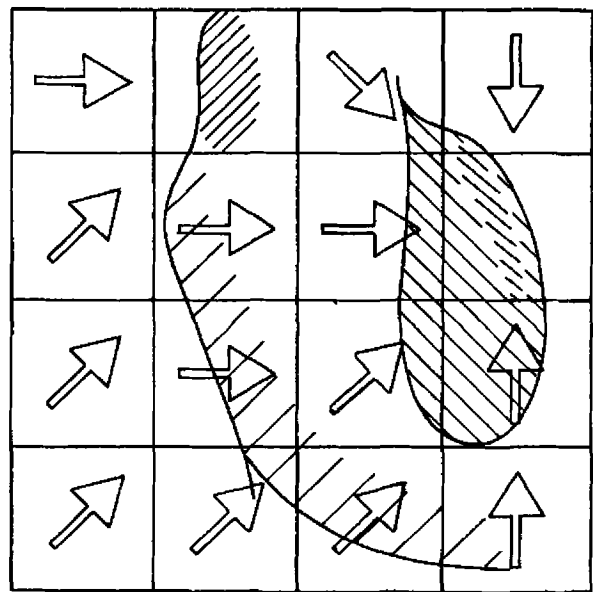


图 25

| | | | |
|----------------|--|---------|------------|
| 专利名称(译) | 内窥镜插入方向检测装置以及内窥镜插入方向检测方法 | | |
| 公开(公告)号 | CN101420897B | 公开(公告)日 | 2011-04-13 |
| 申请号 | CN200780013635.3 | 申请日 | 2007-02-27 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 奥林巴斯医疗株式会社 | | |
| 申请(专利权)人(译) | 奥林巴斯医疗株式会社 | | |
| 当前申请(专利权)人(译) | 奥林巴斯医疗株式会社 | | |
| [标]发明人 | 田中秀树 | | |
| 发明人 | 田中秀树 | | |
| IPC分类号 | A61B1/00 A61B1/04 G06T1/00 G06T7/60 | | |
| CPC分类号 | A61B1/04 A61B1/00147 G06K9/527 G06K2209/05 G06T7/0042 G06T2207/30004 G06T2207/10068 G06T7/73 | | |
| 代理人(译) | 刘新宇 | | |
| 审查员(译) | 宋含 | | |
| 优先权 | 2006113794 2006-04-17 JP | | |
| 其他公开文献 | CN101420897A | | |
| 外部链接 | Espacenet SIPO | | |

摘要(译)

根据内窥镜图像中的R图像的场景算出场景特征量，使用统计或非统计的识别器将场景特征量作为特征量向量来进行辨别分析，并分类为与内窥镜插入方向密切相关的管腔暗部、皱襞等多个特征量的类。并且，算出主要的特征量的类，算出与该特征量对应的插入方向，并显示高精度的插入方向标记等，由此实现在存在多个特征量的场景的情况下也能够进行高精度的插入方向的检测的内窥镜插入方向检测装置以及内窥镜插入方向检测方法。

