

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A61B 1/00

A61B 5/103

A61B 10/00



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 200320129176.4

[45] 授权公告日 2005 年 4 月 6 日

[11] 授权公告号 CN 2689888Y

[22] 申请日 2003.12.26

[21] 申请号 200320129176.4

[73] 专利权人 祁志强

地址 300222 天津市河西区小海地秀峰里 11
号 401-404 室


[72] 设计人 祁志强

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 测量型内窥镜活检钳

[57] 摘要

本实用新型公开了一种测量型内窥镜活检钳，主要由活检钳和钳部组成，其特征在于：活检钳体部的钳部上端设有标记刻度尺。标记刻度尺每厘米为一单位，每一单位的标记由不同颜色构成。刻度标尺上的标记颜色排序为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。经内窥镜钳道进入体腔的测量型内窥镜活检钳在钳取组织活检，同时观察活检钳体部 1 的刻度标尺 3 颜色，测量病变范围得出较为准确的数值，缩短内窥镜检查时间，减少患者痛苦。

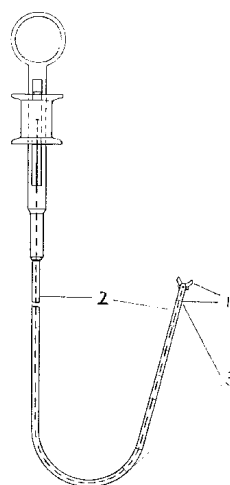

I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

1、一种测量型内窥镜活检钳，主要由活检钳(1)和钳部(2)组成，其特征在于：活检钳体部(1)下端的钳部(2)端上设有标记刻度尺(3)。

2、根据权利要求1所述的测量型内窥镜活检钳，其特征在于：上述的标记刻度尺(3)每厘米为一单位，每一单位的标记由不同颜色构成。

3、根据权利要求1所述的测量型内窥镜活检钳，其特征在于：刻度标尺(3)上的标记颜色排序为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。

测量型内窥镜活检钳

技术领域

本实用新型属于医疗器具，特别涉及一种测量型内窥镜活检钳。

背景技术

目前临床使用内窥镜对体腔内进行检查，通常对病变范围的描述皆是凭经验估算，因而缺少较为准确的测量数值，其测量结果与实际病变范围比较往往出现较大误差，甚至误导检查医生对病变的最初印象诊断。

实用新型内容

本实用新型解决的技术问题在于克服现有技术中之不足，提供一种测量型内窥镜活检钳，从而对于内窥镜在体腔内观察病变范围的描述有较为准确的测量依据。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种测量型内窥镜活检钳，主要由活检钳和钳部组成，其特征在于：活检钳体部下端的钳部端上设有标记刻度尺。

上述的标记刻度尺每厘米为一单位，每一单位的标记由不同颜色构成；其每一单位标记颜色排序为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。通过观察刻度标尺不同颜色，便于测量病变范围。

本实用新型的有益效果是：使用本实用新型的内窥镜对体腔内进行

检查时，通过观察内窥镜刻度标尺上的不同颜色，便于测量病变范围。


附图说明

附图1为本实用新型测量型内窥镜活检钳示意图。

具体实施方式

结合附图1对本实用新型具体实施方式说明如下：

测量型内窥镜活检钳，主要由活检钳1和钳部2组成，活检钳体部1下端的钳部2端上设有标记刻度尺。所述的标记刻度尺每厘米为一单位，每一单位的标记由不同颜色构成；其标记颜色排序为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。通过观察刻度标尺不同颜色，便于测量病变范围，得出病变范围准确数值。做到病变范围测量、活检同时进行，缩短内窥镜检查时间，减少患者痛苦。

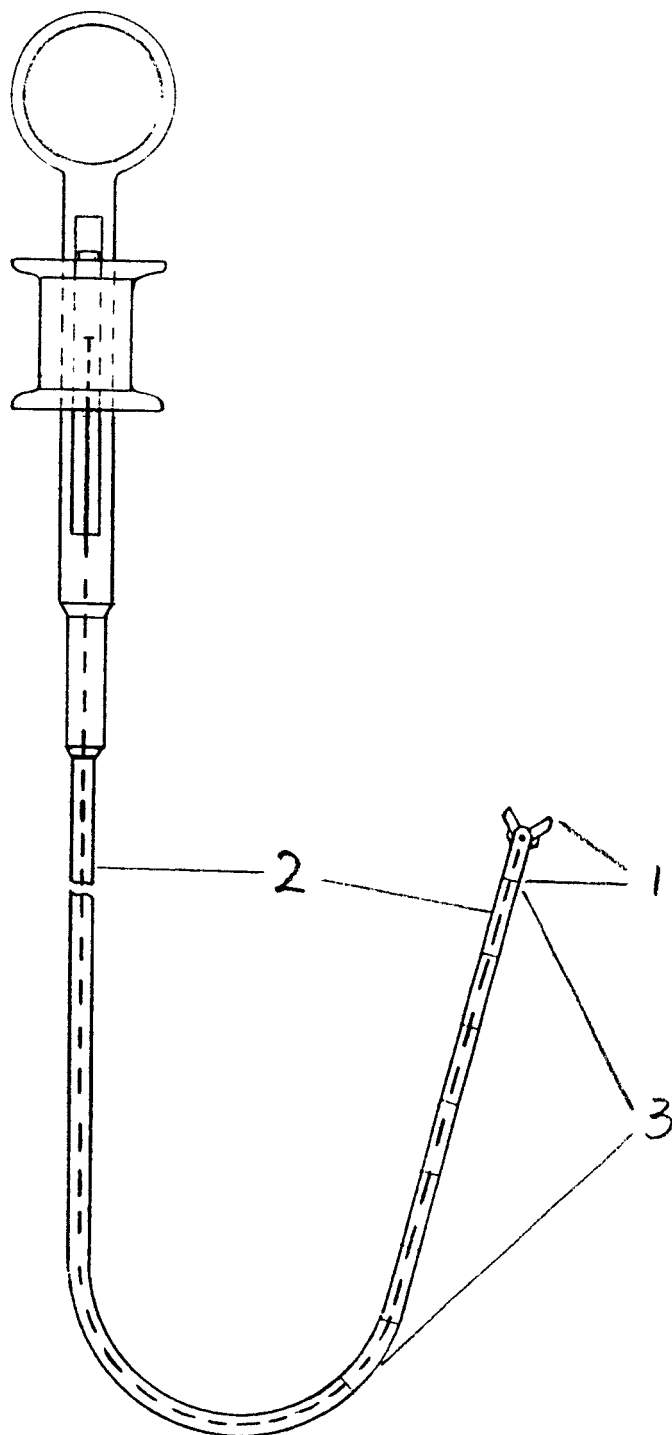

专利名称(译)	测量型内窥镜活检钳		
公开(公告)号	CN2689888Y	公开(公告)日	2005-04-06
申请号	CN200320129176.4	申请日	2003-12-26
[标]发明人	祁志强		
发明人	祁志强		
IPC分类号	A61B1/00 A61B5/103 A61B10/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型公开了一种测量型内窥镜活检钳，主要由活检钳和钳部组成，其特征在于：活检钳体部的钳部上端设有标记刻度尺。标记刻度尺每厘米为一单位，每一单位的标记由不同颜色构成。刻度标尺上的标记颜色排序为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。经内窥镜钳道进入体腔的测量型内窥镜活检钳在钳取组织活检，同时观察活检钳体部1的刻度标尺3颜色，测量病变范围得出较为准确的数值，缩短内窥镜检查时间，减少患者痛苦。

