



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201782745 U

(45) 授权公告日 2011.04.06

(21) 申请号 201020509775.9

(22) 申请日 2010.08.30

(73) 专利权人 武汉佑康科技有限公司

地址 430223 湖北省武汉市东湖开发区汤逊
湖北路长城科技园 B 座 4 楼

(72) 发明人 龙刚 宋磊 吴耀辉 夏萍

(74) 专利代理机构 武汉开元知识产权代理有限
公司 42104

代理人 黄行军

(51) Int. Cl.

A61B 1/07(2006.01)

A61B 1/012(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 5 页

(54) 实用新型名称

球囊式生殖内镜

(57) 摘要

球囊式生殖内镜，它包括导管部分、控制导管弯曲的转向手柄和管道连接器，所述导管部分包括外管和内管，外管套在内管外面，其特征是，在外管的外壁上设有用于防止腔内液体回流的球囊，该球囊通过位于外管外壁上的充气管道与充气嘴连接。本实用新型结构简单、使用方便，能在手术中有效防止腔内液体回流。



1. 球囊式生殖内镜,它包括导管部分、控制导管弯曲的转向手柄和管道连接器,所述导管部分包括外管和内管,外管套在内管外面,其特征是,在外管的外壁上设有用于防止腔内液体回流的球囊,该球囊通过位于外管外壁上的充气管道与充气嘴连接。

2. 如权利要求 1 所述的球囊式生殖内镜,其特征是,所述转向手柄包括手柄套、柄体盖,所述手柄套、柄体盖均为圆筒体形状,手柄套套在柄体盖外面,在手柄套与柄体盖之间设有轴向导轨和滑块,导轨和滑块分别固定于手柄套或柄体盖上,所述外管与手柄套固定相连,所述内管穿过手柄套中的通孔,与管道连接器的一个接口相连并固定在接口处,所述管道连接器位于柄体盖内与柄体盖固定相连,管道连接器的其余接口通过各自的软连接管分别与柄体盖上的各个通道口连接。

3. 如权利要求 2 所述的球囊式生殖内镜,其特征是,位于柄体盖上的各个通道口为内窥镜光纤通道口、注水通道口、器械通道口,所述内窥镜光纤通道口位于柄体盖端部中央,注水通道口和至少一个器械通道口分别位于柄体盖端部边缘部位。

4. 如权利要求 2 所述的球囊式生殖内镜,其特征是,所述导轨为沿轴向设置在柄体盖外表面上的条状滑槽,滑块为设置在手柄套侧壁螺孔中的限位螺栓,螺栓与滑槽相配。

5. 如权利要求 1 所述的球囊式生殖内镜,其特征是,所述外管为硬管,所述内管为弯头管,弯头管一端呈弯曲状,另一端与管道连接器的一个接口相连并固定在接口处,在弯头管中穿过有光纤或导丝。

6. 如权利要求 1 所述的球囊式生殖内镜,其特征是,所述外管为硬管,所述内管为软管,软管内设有转向通道和工作通道,转向通道中设有转向钢丝,所述软管的外端设置有硬质护套,在软管内的转向通道中设有定位套管,在定位套管与硬质护套之间的软管中设有弹性管,转向钢丝穿过定位套管弹性管,一端与硬质护套固定连接,另一端穿过管道连接器的接口与位于柄体盖上的能控制转向钢丝伸缩的转向控制阀连接。

7. 如权利要求 6 所述的球囊式生殖内镜,其特征是,所述工作通道包括并排排列的器械通道、光纤通道和注水通道。

8. 如权利要求 6 所述的球囊式生殖内镜,其特征是,设置在软管内的转向通道偏离软管的中心线。

球囊式生殖内镜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域,特别是涉及一种球囊式生殖内镜。

背景技术

[0002] 现有的妇科内窥镜,如输卵管镜是用于检查(输卵管腔内形态)整条输卵管形态,且能评估拾卵、运送受精卵的功能的显微内镜。这种内窥镜使用时是在宫腔镜辅助下采用同轴技术自宫腔内输卵管开口向输卵管内置入一条可弯曲导丝,疏通堵塞部位部位,同时也可以向腔内注水,达到治疗目的。但传统的妇科内窥镜都没有防止腔内液体回流的部件,实际手术操作中腔内液体会大量回流,影响环境和治疗效果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服上述背景技术的不足,提供一种能在手术中防止腔内液体回流的球囊式生殖内镜。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供一种球囊式生殖内镜,它包括导管部分、控制导管弯曲的转向手柄和管道连接器,所述导管部分包括外管和内管,外管套在内管外面,其特征是,在外管的外壁上设有用于防止腔内液体回流的球囊,该球囊通过位于外管外壁上的充气管道与充气嘴连接。

[0005] 在上述方案中,所述转向手柄包括手柄套、柄体盖,所述手柄套、柄体盖均为圆筒体形状,手柄套套在柄体盖外面,在手柄套与柄体盖之间设有轴向导轨和滑块,导轨和滑块分别固定于手柄套或柄体盖上,所述外管与手柄套固定相连,所述内管穿过手柄套中的通孔,与管道连接器的一个接口相连并固定在接口处,所述管道连接器位于柄体盖内与柄体盖固定相连,管道连接器的其余接口通过各自的软连接管分别与柄体盖上的各个通道口连接。

[0006] 优选地,位于柄体盖上的各个通道口为内窥镜光纤通道口、注水通道口、器械通道口,所述内窥镜光纤通道口位于柄体盖端部中央,注水通道口和至少一个器械通道口分别位于柄体盖端部边缘部位。

[0007] 优选地,所述导轨为沿轴向设置在柄体盖外表面上的条状滑槽,滑块为设置在手柄套侧壁螺孔中的限位螺栓,螺栓与滑槽相配。

[0008] 优选地,所述外管为硬管,所述内管为弯头管,弯头管一端呈弯曲状,另一端与管道连接器的一个接口相连并固定在接口处,在弯头管中穿过有导丝或光纤。

[0009] 在上述方案中,所述外管为硬管,所述内管为软管,软管内设有转向通道和工作通道,转向通道中设有转向钢丝,所述软管的外端设置有硬质护套,在软管内的转向通道中设有定位套管,在定位套管与硬质护套之间的软管中设有弹性管,转向钢丝穿过定位套管和弹性管,一端与硬质护套固定连接,另一端穿过管道连接器的接口与位于柄体盖上的能控制转向钢丝伸缩的转向控制阀连接。

[0010] 优选地,所述工作通道包括并排排列的器械通道、光纤通道和注水通道。

[0011] 优选地,设置在软管内的转向通道偏离软管的中心线。

[0012] 本实用新型利用设在外管的外壁上的球囊防止腔内液体回流,利用转向手柄中的手柄套与柄体盖之间的相对运动实现外管与内管之间的相对伸缩和转动,外管与内管之间通过导轨和滑块实现轴向伸缩;当将滑块从导轨中退出后,外管与内管之间可以实现转动。在转动过程中,由于内管穿过手柄套中央的通孔通过固定在柄体盖中管道连接器和软连接管分别与柄体盖上的各个通道口连接,而外管又与手柄套固定相连,因此,外管和内管之间可以方便伸缩、转动,且不影响内窥镜光纤通道口、注水通道口和器械通道口的工作。

[0013] 本实用新型结构简单、使用方便,能在手术中有效防止腔内液体回流。

[0014] 以下结合附图通过实施例对本实用新型的特征及相关特征做进一步详细说明,以便于同行业技术人员的理解。

附图说明

[0015] 图 1 为实施例的结构示意图;

[0016] 图 2 为图 1 的俯视图;

[0017] 图 3 为转向手柄的结构示意图;

[0018] 图 4 为软管头部剖视图;

[0019] 图 5 为图 4 的 A-A 剖视图;

[0020] 图 6 为图 4 的 M 向视图;

[0021] 图 7 为实施例 2 的结构示意图;

[0022] 图 8 为图 7 的俯视图;

[0023] 图 9 为转向手柄立体图。

[0024] 图中:1-硬管,2-软管,3-手柄套,4-柄体盖,5-螺栓,6-滑槽,7-连接法兰,8-管道连接器,9-旋转手柄,10-转轮,11-内窥镜光纤通道口,12-软管注水通道口,13-器械通道口,14-转向钢丝,15-内窥镜光纤,16-硬质护套,17-定位套管,18-弹性管,19-气囊,20-充气嘴,21-硬管注水通道口,22-导丝。

具体实施方式

[0025] 实施例 1:本实施例提供一种可弯曲转向内窥镜,参见图 1 和图 2,它包括导管部分、控制导管弯曲的转向手柄和管道连接器,所述导管部分包括用塑料制成的硬管 1 和软管 2,硬管 1 套在软管 2 外面。

[0026] 参见图 3、图 9,所述转向手柄包括手柄套 3、柄体盖 4,所述手柄套、柄体盖均为圆筒体形状,手柄套套在柄体盖外面,在手柄套与柄体盖之间设有轴向导轨和滑块。所述导轨为沿轴向设置在柄体盖外表面上的条状滑槽 6,滑块为设置在手柄套侧壁螺孔中的限位螺栓 5,螺栓 5 与滑槽 6 相配。

[0027] 所述硬管 1 与手柄套 3 通过连接法兰 7 以螺纹形式固定相连,所述软管 2 穿过手柄套 3 中央的通孔,与管道连接器 8 的一个接口相连并固定在接口处。软管 2 内设有转向通道和工作通道,转向通道中设有转向钢丝 14,所述工作通道包括并排排列的器械通道、光纤通道和软管注水通道。

[0028] 参见图 4-图 6,所述软管 2 的外端设置有金属材料制成的硬质护套 16,硬质护套

为环状,套在软管头部外面,与软管注塑为一体。在软管外端部设有斜面(见图4),便于软管伸入器官。在软管内的转向通道中设有定位套管,定位套管17为不锈钢管,在定位套管17与硬质护套16之间的软管中设有弹性管18,弹性管18采用高分子材料制成,一端与定位套管接触,另一端与硬质护套接触。转向钢丝14穿过定位套管和弹性管,一端与硬质护套固定连接,另一端穿过管道连接器8的接口与位于柄体盖上的能控制转向钢丝14伸缩的转向控制阀连接。所述转向控制阀为旋转手柄9,旋转手柄的旋转轴装在柄体盖上,该旋转轴上装有转轮10,转轮10位于柄体盖内,转向钢丝14固定在该转轮10上。

[0029] 位于柄体盖上的各个通道口为内窥镜光纤通道口11、软管注水通道口12、器械通道口13,所述内窥镜光纤通道口11位于柄体盖端部中央,内窥镜光纤15从内窥镜光纤通道口11伸入,从软管2头部伸出。注水通道口和器械通道口分别位于柄体盖端部边缘部位,通过管道连接器8分别与软管中的注水通道和器械通道相连通。

[0030] 所述管道连接器8为四通管,位于柄体盖内与柄体盖之间用螺栓固定相连,管道连接器8一端的一个接口与软管连接;另一端的其余接口的外端通过各自的软接管分别与柄体盖上的内窥镜光纤通道口11、注水通道口12和器械通道口13连接;内端分别与软管2中的器械通道、光纤通道和注水通道连接。

[0031] 在硬管的外壁上还设有用于防止腔内液体回流的球囊19,以及硬管注水通道口21。球囊19通过位于硬管外壁上的充气管道与充气嘴20连接。使用时,球囊先不充气,当插入腔内后,在对球囊进行充气。硬管注水通道口21用于通过硬管1向腔内注水。

[0032] 本实用新型所述软管内的三个工作通道可以根据不同的需要而在通道尺寸上有不同的规格。本实用新型直接通过转向手柄和转向控制阀来控制软管前端的角度的。旋转转向控制阀的旋转手柄时,带动转向钢丝回缩,弹性管被压缩,拉动软管前端转向,参见图所示;松开滑块3后,弹性管回位,导致整根软管回位。弯曲过程不仅操作简单,而且能够准确控制转向角度,软管转向弯曲的角度依据弹性管的长度而定,可达180度或更大,整个弯曲过程配合软、硬管之间的伸缩、旋转运动能够实现全范围的变向(包括弯曲方向和角度),伸缩,视角可呈360度,彻底消除盲角。

[0033] 本实用新型的软管与硬管组合使用,可以优化目前的宫腔镜、腹腔镜及阴道镜。用于临床上宫颈病变有癌前期或癌可疑者、防癌图片中发现有异常细胞者、随访治疗后的宫颈病变,以了解治疗效果,有无复发或新的病变出现、异常子宫出血:子宫腔内肌瘤、息肉及子宫内膜癌、异常超声声像所见、不孕症与计划生育合并症、激素替代与应用三苯氧胺所致子宫内膜的生理或特殊改变、前次IVF(体外受精)失败的患者,替代宫腔镜检查子宫内膜情况、习惯性流产、检视有无子宫腔畸形、子宫腔粘连、子宫腔内异物等检查及良性妇科肿瘤的切除、宫外孕的诊断和治疗、卵巢囊肿的疗、骨盆内粘连剥离、子宫内膜异位症烧灼治疗、输卵管结扎等治疗。

[0034] 实施例2:本实施例提供一种导丝式输卵管镜,参见图7和图8,它包括导管部分、控制导管弯曲的转向手柄和管道连接器,所述导管部分包括用塑料制成的硬管1和软管2,所述外管1为引导管,所述内管2为弯头管,引导管套在弯头管外面。

[0035] 所述转向手柄与实施例1相同,参见图3、图9,所述引导管与手柄套固定相连,所述弯头管穿过手柄套中央的通孔,与管道连接器的一个接口相连并固定在接口处。

[0036] 所述管道连接器为四通管,位于柄体盖内与柄体盖之间用螺栓固定相连,管道连

接器的其余接口通过各自的软连接管分别与柄体盖上的各个通道口连接。

[0037] 位于柄体盖上的各个通道口为内窥镜光纤通道口、注水通道口、器械通道口,所述内窥镜光纤通道口位于柄体盖端部中央,注水通道口和器械通道口分别位于柄体盖端部边缘部位。器械通道口可以有一个或多个。

[0038] 所述弯头管一端呈弯曲状,另一端与管道连接器的一个接口相连并固定在接口处,在弯头管中可以穿过有导丝或光纤。导丝 3 采用不锈钢材料制成,导丝 3 的直径在 0.15mm ~ 0.35mm 范围之内。弯头管 4 外端呈弯曲状,弯头管 4 呈弯曲状的端部采用的材质比其余部分采用的材料软。硬管 2 采用聚丙烯制成。

[0039] 本实施例在手术操作中可根据实际情况需要,采取三种操作方案,下面通过三种使用方法对本实施例进行说明。

[0040] 方法 1 :先穿图像及照明光纤,再穿导丝

[0041] 先将引导管由患者的阴道口进入,放置在患者的生殖通道内,以到达扩张阴道的的作用。再将弯头管插入引导管内,其前端在引导管的协助下到达或者进入子宫底部的输卵管口,为后面的注水或者下器械疏通提供支持。将图像及照明光纤穿过光纤通道、弯头管,再直接将导丝穿过弯头管,在引导管的引导下直接通过输卵管间质部,到达峡部,甚至可以到达壶腹部,本实施例使用时,可以边注水边通过图像及照明光纤来观察病情。图像及照明光纤与摄像系统连接,高达 2 万像素的成像系统及较宫腔镜更纤细的直径,使它完全可以在镜下完成相关妇科手术操作。

[0042] 方法 2 :只穿导丝

[0043] 通过图像及照明光纤观察诊断后,取出图像及照明光纤,将导丝穿过导丝通道、弯头管,此时主要是对于那些输卵管堵塞比较严重或者输卵管较细、图像及照明光纤无法进入的,在注水无效的情况下改为直接用导丝疏通。引导管引导弯头管通过宫颈口到达子宫,弯头管引导导丝通过输卵管口到达输卵管间质部,可以采用直接疏通的方式来处理输卵管堵塞,此实施例应该借助造影剂在 X 光下完成。

[0044] 方法 3 :取出图像及照明光纤,通入器械 / 激光光纤 (无导丝)

[0045] 此种情况下无导丝。通过图像及照明光纤观察诊断后,将图像及照明光纤取出,通入器械或激光光纤,打激光进行疏通,此时不通入导丝。

[0046] 在实际手术操作中,本实施例也可以借助宫腔镜的器械通道进入宫腔,再借助膨宫泵膨宫后,进入输卵管。

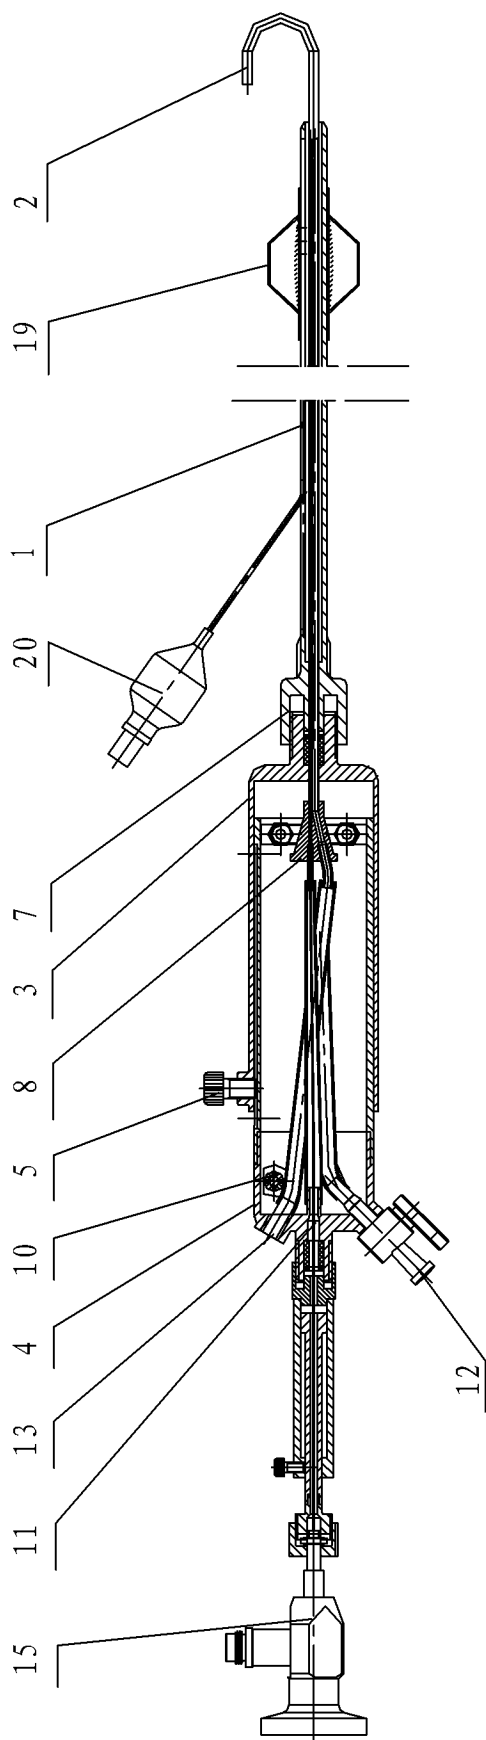


图 1

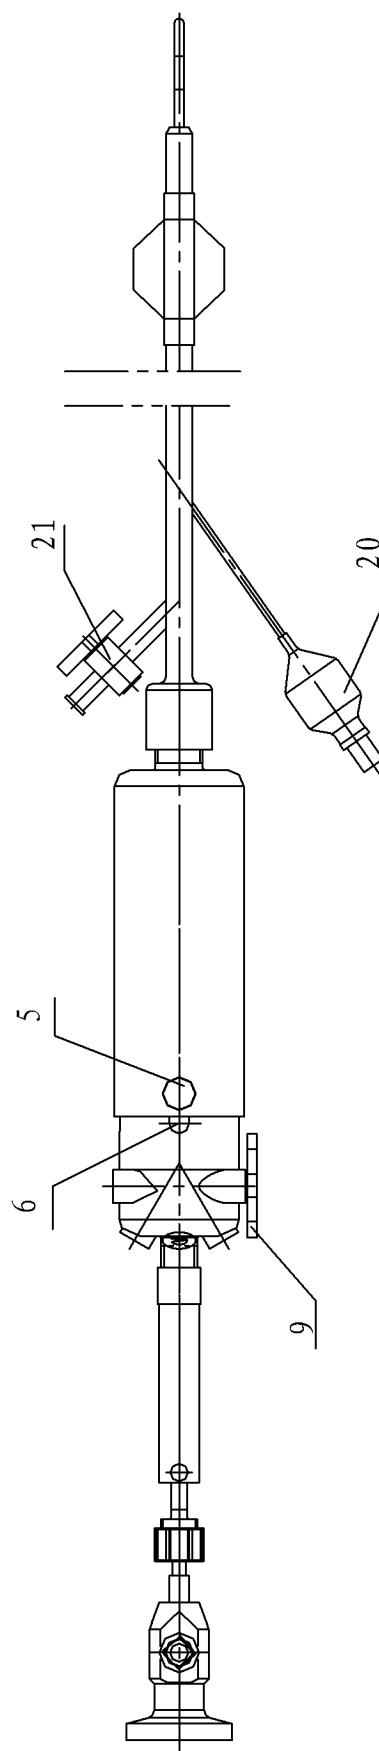


图 2

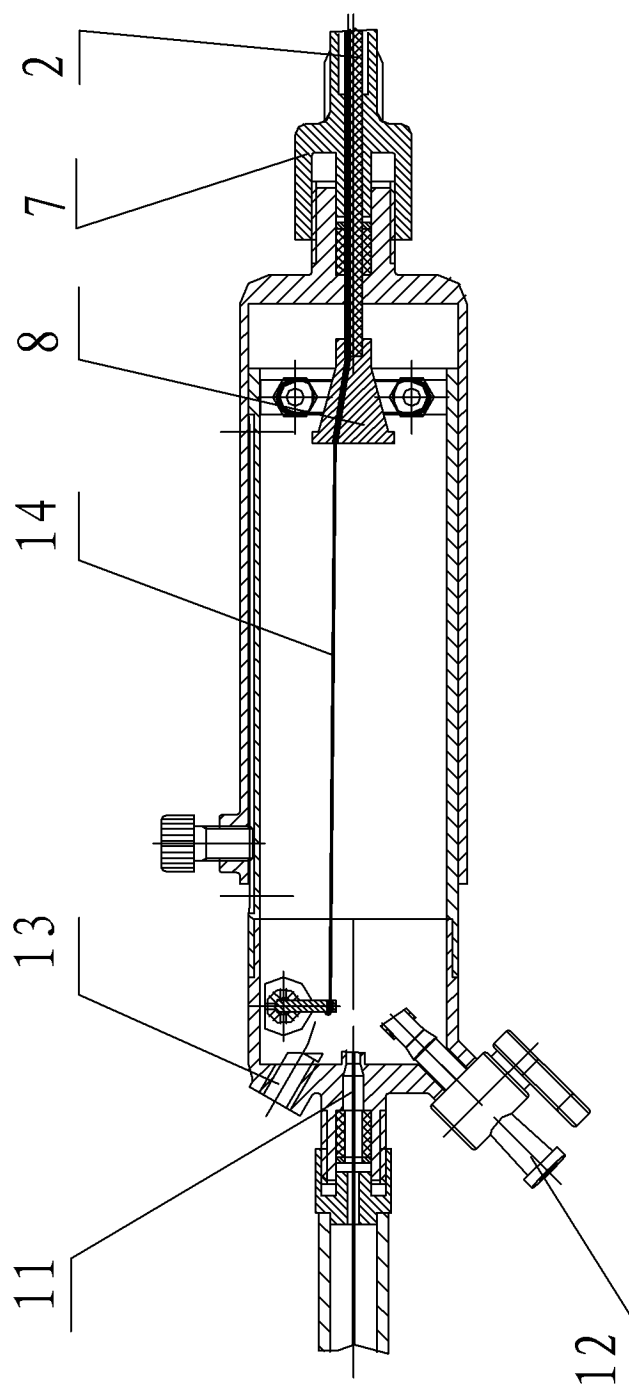


图 3

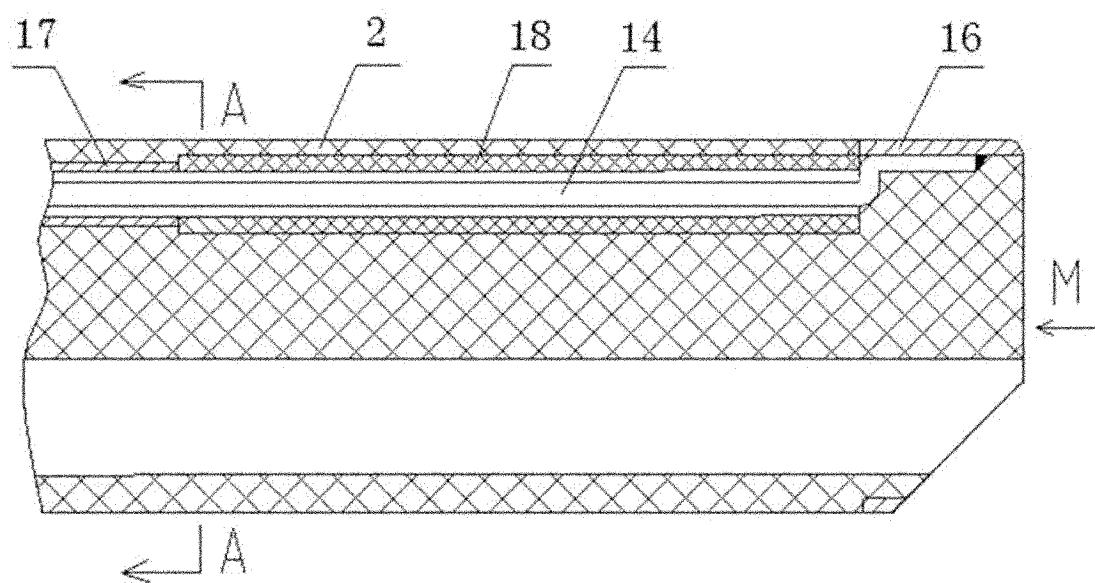


图 4

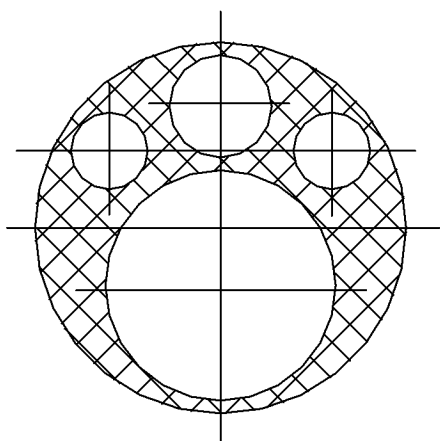


图 5

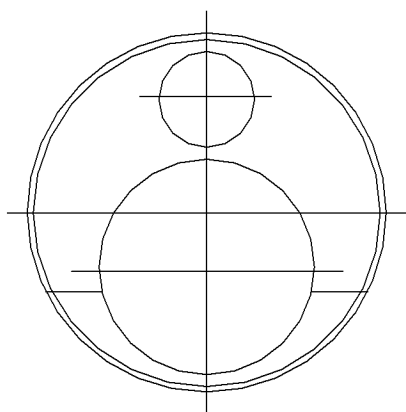


图 6

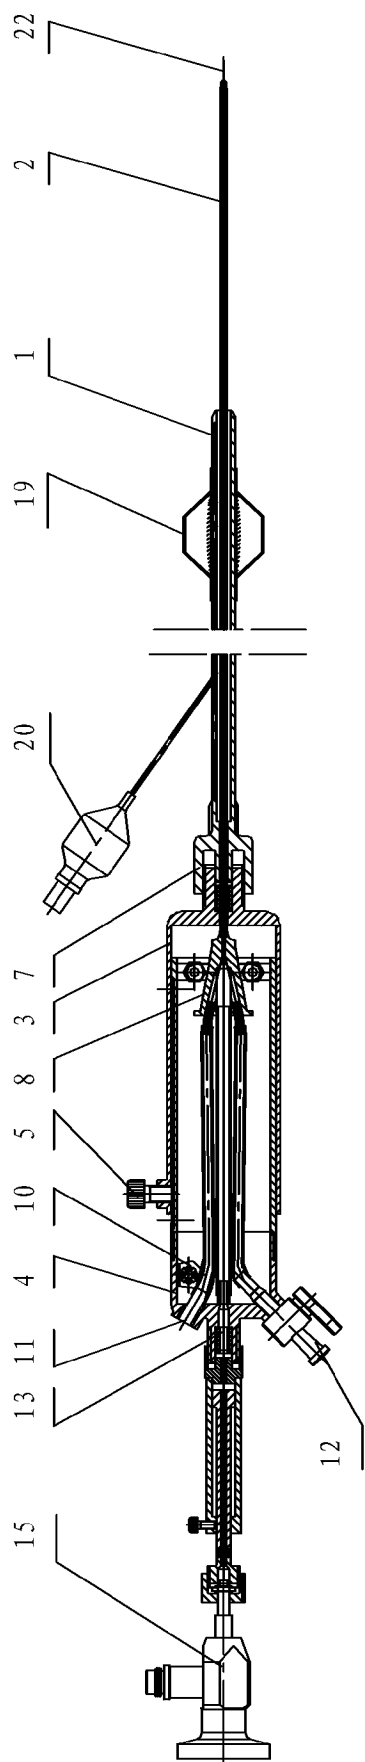


图 7

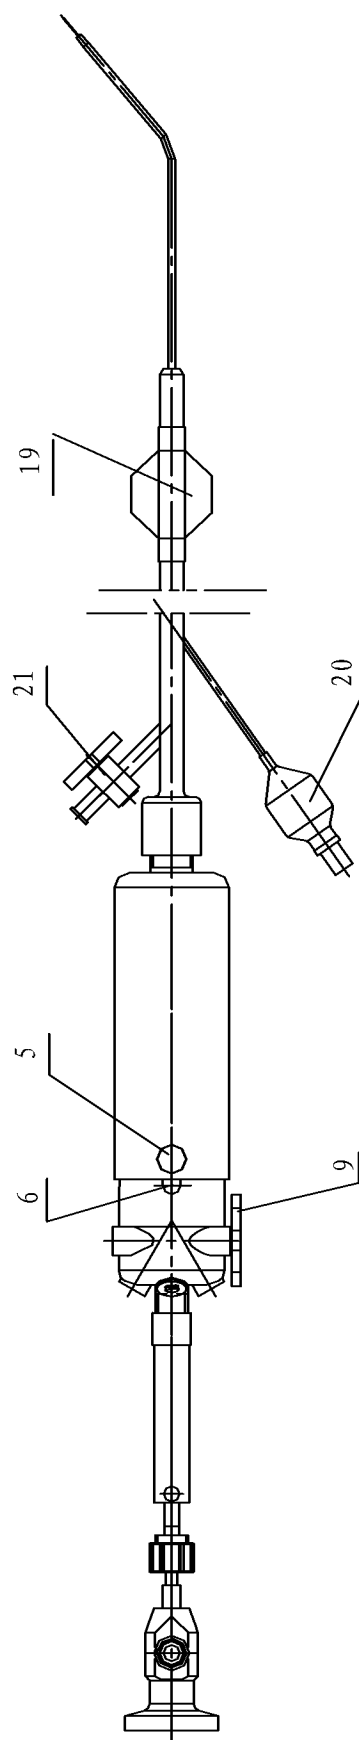


图 8

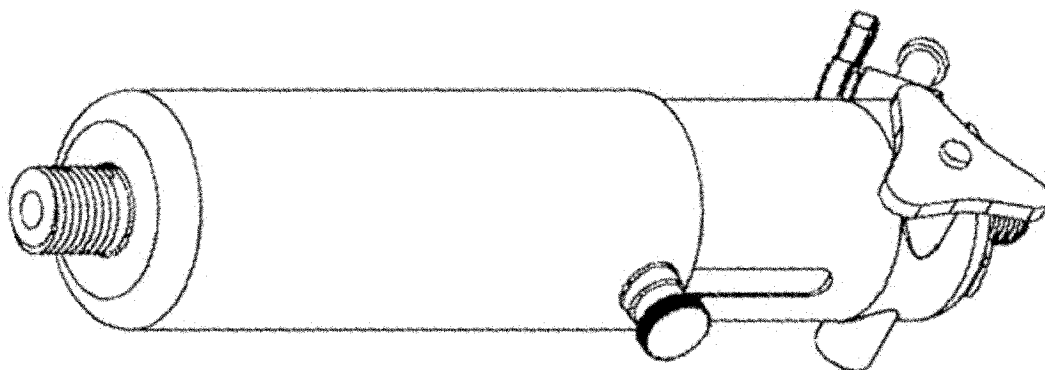


图 9

专利名称(译)	球囊式生殖内镜		
公开(公告)号	CN201782745U	公开(公告)日	2011-04-06
申请号	CN201020509775.9	申请日	2010-08-30
[标]申请(专利权)人(译)	武汉佑康科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	武汉佑康科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	武汉佑康科技有限公司		
[标]发明人	龙刚 宋磊 吴耀辉 夏萍		
发明人	龙刚 宋磊 吴耀辉 夏萍		
IPC分类号	A61B1/07 A61B1/012		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

球囊式生殖内镜，它包括导管部分、控制导管弯曲的转向手柄和管道连接器，所述导管部分包括外管和内管，外管套在内管外面，其特征是，在外管的外壁上设有用于防止腔内液体回流的球囊，该球囊通过位于外管外壁上的充气管道与充气嘴连接。本实用新型结构简单、使用方便，能在手术中有效防止腔内液体回流。

