

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号  
特許第4997443号  
(P4997443)

(45) 発行日 平成24年8月8日(2012.8.8)

(24) 登録日 平成24年5月25日(2012.5.25)

(51) Int.Cl. F I

A 6 1 B 1/00 (2006.01)

A 6 1 B 18/20 (2006.01)

A 6 1 B 1/00 3 0 0 D

A 6 1 B 1/00 3 0 0 U

A 6 1 B 1/00 3 0 0 H

A 6 1 B 17/36 3 5 0

請求項の数 10 (全 14 頁)

|           |                               |           |                   |
|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| (21) 出願番号 | 特願2006-292578 (P2006-292578)  | (73) 特許権者 | 505374783         |
| (22) 出願日  | 平成18年10月27日 (2006.10.27)      |           | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 |
| (65) 公開番号 | 特開2008-104791 (P2008-104791A) |           | 茨城県那珂郡東海村村松4番地49  |
| (43) 公開日  | 平成20年5月8日 (2008.5.8)          | (74) 代理人  | 100090169         |
| 審査請求日     | 平成21年7月2日 (2009.7.2)          |           | 弁理士 松浦 孝          |
|           |                               | (74) 代理人  | 100124497         |
|           |                               |           | 弁理士 小倉 洋樹         |
|           |                               | (74) 代理人  | 100127306         |
|           |                               |           | 弁理士 野中 剛          |
|           |                               | (74) 代理人  | 100129746         |
|           |                               |           | 弁理士 虎山 滋郎         |
|           |                               | (74) 代理人  | 100132045         |
|           |                               |           | 弁理士 坪内 伸          |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 内視鏡装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

画像用ファイバと、照明用ファイバと、前記画像用ファイバに接続される光結合分離装置と、前記光結合分離装置及び前記照明用ファイバに接続される計測装置とを備え、

前記画像用ファイバは、観察部位からの反射光を伝達して前記光結合分離装置へ出力し、

前記照明用ファイバは、前記計測装置から入力される計測用レーザ光を観察部位へ向けて伝達し、

前記光結合分離装置は、前記画像用ファイバから入力される前記反射光を画像及び反射レーザ光に分離し、

前記計測装置は、前記光結合分離装置から入力される前記反射レーザ光により観察部位の状態を測定することを特徴とする内視鏡装置。

【請求項2】

前記内視鏡装置は、治療用レーザ光を発生する治療用レーザ装置と、治療用レーザ光を伝達するレーザ用ファイバとをさらに備え、

前記治療用レーザ装置は、前記光結合分離装置へ前記治療用レーザ光を出力し、

前記光結合分離装置は前記治療用レーザ光を前記レーザ用ファイバに出力することを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。

【請求項3】

前記計測装置は、前記反射レーザ光を用いて前記照明用ファイバの遠位端から観察部位

までの距離を測定することを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 4】

前記計測装置は、前記反射レーザ光を用いて観察部位の血流を測定することを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 5】

前記計測装置は、前記反射レーザ光を用いて観察部位の温度を測定することを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 6】

前記内視鏡装置は情報処理装置をさらに備え、

前記計測装置は、前記反射レーザ光を用いて観察部位の温度を測定し、観察部位の温度を示す温度信号を前記情報処理装置へ出力し、

前記情報処理装置は前記温度信号に従い前記治療用レーザ光の出力を制御することを特徴とする請求項 2 に記載の内視鏡装置。

【請求項 7】

前記光結合分離装置は、ダイクロイックプリズムを用いて前記反射光の分離を行うことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 8】

前記照明用ファイバに照明光を入力する光源装置を備えることを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 9】

前記レーザ用ファイバの径方向における周囲には前記画像用ファイバが前記レーザ用ファイバと同軸に設けられて複合光ファイバを構成し、

前記複合光ファイバの径方向における周囲には前記照明用ファイバが前記複合光ファイバと同軸に設けられてファイバスコープを構成することを特徴とする請求項 2 に記載の内視鏡装置。

【請求項 10】

前記内視鏡装置はモニタをさらに備え、前記画像は前記モニタに表示されることを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、内視鏡装置に関し、より詳しくは、胎児治療内視鏡装置に関する。

【背景技術】

【0002】

内視鏡装置は、例えば人体の内臓を観察、検査、又は治療するために用いられる。

【0003】

内視鏡装置は光結合分離装置と、それに接続されるファイバスコープ、光源装置、治療用レーザ発生装置、及び情報処理装置から構成される。ファイバスコープは複数の光ファイバから成る。光源装置はファイバスコープに接続されて、照明光をファイバスコープに出力する。ファイバスコープは人体に挿入される遠位端と、光結合装置及び光源装置に接続される近位端とを有する。遠位端が人体に挿入されると、ファイバスコープは観察部位からの反射光を光結合分離装置に伝達する。反射光は光結合分離装置が備える撮像素子により電気信号に変換される。電気信号は情報処理装置に伝達されて情報処理された後に、情報処理装置が備えるモニタに画像として表示される。

【0004】

治療用レーザ発生装置は治療用レーザ光を発生し、光結合分離装置に入力する。光結合分離装置は治療用レーザ光をファイバスコープに出力する。ファイバスコープは治療用レーザ光を伝達して観察部位に向けて照射し、観察部位を治療する。

【0005】

正確な治療を行うために、使用者はファイバスコープを介して伝えられる画像を参照し

10

20

30

40

50

ながら、治療用レーザー光をファイバ스코プの遠位端から観察部位に照射する必要がある。これを解決するためにレーザー照射と同時に照射位置を観察できるようにした内視鏡システムやレーザー加工装置が知られている（特許文献1、2、3、4）。

【特許文献1】特開2003-1465号公報

【特許文献2】特開2005-237436号公報

【特許文献3】特許第3746554号公報

【特許文献4】特許第3746555号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

10

しかし、照射位置を画像により確認するだけでは、ユーザの経験と勘により治療状態を判断せざるを得ず、確実に治療されていることを確認する術がない。また、確実に治療を行うためには必要量以上の治療用レーザー光を照射することがあり、患者の負担が増える問題がある。一方治療用レーザー光の照射を最小限に留めようとして照射量を減らすと十分に治療できず、再度の治療が必要となるという問題がある。

【0007】

他方、ファイバ스코プの遠位端と観察部位との間の距離に従って治療用レーザー光は減衰する。正確な照射量で治療用レーザー光を照射するためには治療用レーザー光の減衰量を推定することが必要となる。しかし、従来の内視鏡システムでは遠位端と観察部位との距離を測定することが出来ないため、治療用レーザー光の減衰量を推定することが出来ないとい

20

【0008】

さらに、治療用レーザー光の照射時間は観察部位の状態により変化する。そのため、ユーザは随時治療用レーザー光の照射を中止して照射部位の状態を確認しなければならず、これにより治療時間が余計に必要となって患者の負担が増加するという問題もあった。

【0009】

本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、観察部位の血流、ファイバ스코プの遠位端から観察部位までの距離、及び観察部位の温度等の観察部位の状況を的確に計測することが可能な内視鏡装置を得ることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

30

【0010】

本発明による内視鏡装置は、画像用ファイバと、照明用ファイバと、画像用ファイバに接続される光結合分離装置と、光結合分離装置及び照明用ファイバに接続される計測装置とを備え、画像用ファイバは、観察部位からの反射光を伝達して光結合分離装置へ出力し、照明用ファイバは、計測装置から入力される計測用レーザー光を観察部位へ向けて伝達し、光結合分離装置は、画像用ファイバから入力される反射光を画像及び反射レーザー光に分離し、計測装置は、光結合分離装置から入力される反射レーザー光により観察部位の状態を測定することを特徴とする。

【0011】

内視鏡装置は、治療用レーザー光を発生する治療用レーザー装置と、治療用レーザー光を伝達するレーザー用ファイバとをさらに備え、治療用レーザー装置は、光結合分離装置へ治療用レーザー光を出力し、光結合分離装置は治療用レーザー光をレーザー用ファイバに出力することが好ましい。

40

【0012】

計測装置は、反射レーザー光を用いてファイバ스코プの遠位端から観察部位までの距離、又は観察部位の血流若しくは温度を測定することが望ましい。観察部位の血流、ファイバ스코プの遠位端から観察部位までの距離、及び観察部位の温度等の観察部位の状況を的確に計測して、人体に対して負担が少ない安全かつ確実なレーザー治療を施すことが可能な内視鏡装置を得ることができる。

【0013】

50

内視鏡装置は情報処理装置をさらに備え、計測装置は、反射レーザ光を用いて観察部位の温度を測定し、観察部位の温度を示す温度信号を情報処理装置へ出力し、情報処理装置は温度信号に従い治療用レーザ光の出力を制御しても良い。

【0014】

光結合分離装置は、ダイクロイックプリズムを用いて反射光の分離を行うことが望ましく、内視鏡装置は照明用ファイバに照明光を入力する光源装置を備えても良い。

【0015】

レーザ用ファイバの径方向における周囲には画像用ファイバがレーザ用ファイバと同軸に設けられて複合光ファイバを構成し、複合光ファイバの径方向における周囲には照明用ファイバが複合光ファイバと同軸に設けられてファイバスコープを構成することが好適である。

10

【0016】

内視鏡装置はモニタをさらに備え、画像はモニタに表示されることが好ましい。

【発明の効果】

【0017】

本発明によれば、観察部位の血流、ファイバスコープの遠位端から観察部位までの距離、及び観察部位の温度等の観察部位の状況を的確に計測することが可能な内視鏡装置を得ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

20

以下、本発明における内視鏡装置の実施形態について添付図面を参照して説明する。

【0019】

第1の実施形態による内視鏡装置を図1から5を用いて説明する。

【0020】

内視鏡装置は、人体に挿入されるファイバスコープ100と、ファイバスコープ100と接続される光結合分離装置200と、治療用レーザ光を供給する治療用レーザ装置410と、観察部位の状態を測定する計測装置300と、観察部位を照明する光源を備える光源装置420と、画像処理装置430とから主に構成される。

【0021】

ファイバスコープ100は遠位端部101から人体に挿入される。遠位端部101は観察部位に対向する。近位端部102はファイバスコープ100の近位端部102において、光結合分離装置接続ファイバ110、及び光源装置接続ファイバ120に接続される。光源装置接続ファイバ120からは計測装置接続ファイバ122が分岐する。これらの接続ファイバは、光結合分離装置200、光源装置420、及び計測装置300にそれぞれ接続される。

30

【0022】

ファイバスコープ100は複合光ファイバ135と照明用ファイバ133とからなる。複合光ファイバ135は、治療用レーザ光を観察部位まで伝達する治療用レーザファイバ141、観察部位の反射光を光結合分離装置200まで伝達する画像用ファイバ143とからなる。複合光ファイバ135は、遠位端101に設けられる対物レンズ131を介して観察部位に対向する。治療用レーザファイバ141は複合光ファイバ135の断面における中心に位置し、画像用ファイバ143は治療用レーザファイバ141の周囲に設けられた多数のファイバ要素から成る。照明用ファイバ133は環状に配置され、光源装置420からの照明光を遠位端部101まで伝達する。

40

【0023】

光源装置420は観察部位を観察するために必要な照明を提供する。光源装置420は照明用ファイバ接続部421を備え、光源装置接続ファイバ120と接続する。光源装置420で発生した照明光は、照明用ファイバ接続部421から光源装置接続ファイバ120を経て照明用ファイバ133に伝達される。

【0024】

50

照明用ファイバ１３３に入力した照明光は、照明用ファイバ１３３の遠位端部１０１まで伝達される。そして照明光は遠位端部１０１から観察部位に照射される。

【００２５】

計測装置３００は計測用レーザを発生する計測用レーザ発生装置３２２、レーザカットフィルタ３１３、フォトディテクター３１４を主に有する。計測用レーザ発生装置３２２は波長が７８０nmである計測用レーザ光を発生する。計測用レーザ光は、計測装置３００が備える計測装置接続ファイバ接続部３２１から、計測装置接続ファイバ１２２に伝達される。

【００２６】

計測装置接続ファイバ１２２及び光源装置接続ファイバ１２０を経た計測用レーザ光は、照明用ファイバ１３３の遠位端部１０１まで伝達される。そして計測用レーザ光は遠位端部１０１から観察部位に照射される。

10

【００２７】

治療用レーザ装置４１０は波長１０６４nmの治療用レーザ光を発生する。治療用レーザ光はＹＡＧレーザ光である。治療用レーザ装置４１０は光結合分離装置２００と接続ファイバ４１１を用いて接続される。治療用レーザ装置４１０で発生した治療用レーザ光は、接続ファイバ４１１により光結合分離装置２００が備える治療用レーザ装置接続部２１３に伝達される。

【００２８】

光結合分離装置２００は、治療用レーザ光を治療用レーザファイバ１４１へ導入する機能と、画像用ファイバ１４３から伝達された観察部位からの反射光を画像と反射レーザ光に分離する機能とを有する。光結合分離装置２００は、第１及び第２のダイクロイックプリズム２３１、２４１と、レーザカットフィルタ２５０と、ＣＣＤ２６０と、４つのレンズ群２２１、２２２、２２３、２２４とを主に備える。

20

【００２９】

第１及び第２のダイクロイックプリズム２３１、２４１は図５に示すような光学特性を有する。第１のダイクロイックプリズム２３１は波長７８０nm未満の波長を有する光を透過させる性質を有し、第２のダイクロイックプリズム２４１は波長７８０nmより大きい波長を有する光を透過させる性質を有する。一般に人間が認識しうる可視光線は波長３８０nmから７８０nmの光である。そのため、第１のダイクロイックプリズム２３１は可視光線を透過する光学特性を有する。

30

【００３０】

光結合分離装置２００が備える治療用レーザ装置接続部２１３には、治療用レーザ装置４１０から波長１０６４nmの治療用レーザ光が入力される。治療用レーザ光は第２のダイクロイックプリズム２４１の第２の反射面２４２の背面に入射する。第２の反射面２４２の背面に入射した光は第２のダイクロイックプリズム２４１により光路が曲げられること無く直進する。直進する治療用レーザ光は第１のダイクロイックプリズム２３１の第１の反射面２３２に入射する。治療用レーザ光は第１の反射面２３２で反射され、第１のレンズ群２２１に向けて光路が曲げられる。その後、治療用レーザ光は第１のレンズ群２２１により集光されて治療用レーザファイバ１４１へ入力される。

40

【００３１】

治療用レーザファイバ１４１に入力した治療用レーザ光は、治療用レーザファイバ１４１の遠位端部１０１まで伝達される。そして治療用レーザ光は遠位端部１０１から観察部位に照射され、観察部位の治療を行う。

【００３２】

観察部位には照明光、計測用レーザ光、及び治療用レーザ光が照射される。そのため、観察部位からの反射光には照明光、計測用レーザ光、及び治療用レーザ光の反射光が含まれる。画像用ファイバ１４３の遠位端部１０１には観察部位からの反射光が入射し、光結合分離装置２００へ伝達される。

【００３３】

50

光結合分離装置 200 に入力した反射光は、第 1 のレンズ群 221 を通過した後、第 1 のダイクロイックプリズム 231 に入射する。反射光が第 1 の反射面 232 に入射すると、反射光のうち 780 nm 以下の波長を有する光、すなわち可視光線は画像として第 1 の反射面 232 を透過して第 2 のレンズ群に導かれる。さらに、第 1 のダイクロイックプリズム 231 により反射されなかった計測用レーザ及び治療用レーザ光を除去するため、画像はレーザカットフィルタ 250 を通過して、CCD 260 に入射する。CCD 260 に入射した画像は、電気信号に変換され、画像処理装置 430 に出力される。

#### 【0034】

他方、第 1 の反射面 232 に入射した反射光のうち、780 nm 以上の波長を有する光は第 1 の反射面 232 で反射される。反射された光は反射レーザ光として第 2 のダイクロイックプリズム 241 の第 2 の反射面 242 に入射する。第 2 の反射面 242 は波長 780 nm 以下の光を反射するため、反射レーザ光は第 2 の反射面 242 により反射されて計測装置接続部 212 へ導かれる。

10

#### 【0035】

計測装置 300 は、反射レーザ光を光結合分離装置接続部 311 から受光する。反射レーザはレンズ群 312 を通過した後、レーザカットフィルタ 313 により 780 nm 以外の波長の光を除去されてフォトディテクター 314 に入射する。フォトディテクター 314 は、反射レーザ光の強度に応じて変化する電圧を計測信号として出力する。計測信号は、計測信号ケーブル 331 により、画像処理装置 430 に伝えられる。

#### 【0036】

20

画像処理装置 430 は画像信号ケーブル 431 により光結合分離装置 200 と、モニタ 440 ケーブル 432 により画像を表示するためのモニタ 440 とそれぞれ接続される。CCD 260 から出力された画像信号は画像処理装置 430 において様々な画像処理、例えば色素強調処理等が行われ、画像としてモニタ 440 に表示される。

#### 【0037】

計測装置 300 から計測信号ケーブル 331 により伝えられた計測信号は、画像処理装置 430 により演算処理がなされる。この演算処理により観察部位の血流、温度、及びファイバースコープ 100 の遠位端部 101 と観察部位との距離が求められる。

#### 【0038】

血流は公知の方法によって求められ得る。例えば光のドップラー効果を利用して求める光ヘテロダイン法が用いられる。ファイバースコープ 100 の遠位端部 101 と観察部位との距離は公知の方法によって求められ得る。例えば、観察部位の温度が一定であれば、遠位端部 101 と観察部位との距離が大きくなるに従って、観察部位からの反射レーザ光の強度が弱くなる性質を用いて計測される。温度は公知の方法によって求められ得る。例えば、遠位端部 101 と観察部位との距離が一定であるとき、観察部位の温度が上昇するにつれて、観察部位からの反射レーザ光の強度が強くなる性質を用いて計測される。

30

#### 【0039】

求められた血流、温度、及び遠位端部 101 と観察部位との距離は、モニタ 440 に表示される。

#### 【0040】

40

画像処理装置 430 は、制御ケーブル 421 により治療用レーザ装置 410 に接続される。画像処理装置 430 は求められた温度に従い、治療用レーザ光の残りの照射時間を算出する。残りの算出時間がなくなると、画像処理装置 430 は治療用レーザ光の出力を止める信号を治療用レーザ装置 410 に送信し、治療用レーザ光の照射を中止する。

#### 【0041】

次に、図 6 を用いて本発明による内視鏡装置の処理について、例えば子宮の胎盤内に存在する血管の血流を止める処理を用いて説明する。

#### 【0042】

ステップ S601 において、ファイバースコープ 100 の遠位端部 101 が子宮内に挿入される。ステップ S602 では、モニタ 440 を参照しながら、血流を停止すべき血管を

50

探索する。このとき、照明用ファイバ 133 から計測用レーザを照射して、ファイバスコ  
ープ 100 の遠位端部 101 と観察部位との距離の測定が行われる。そして、モニタ 44  
0 には遠位端部 101 と観察部位との距離が表示される。ステップ S603 では、ユーザ  
が処置すべき血管を発見、決定する。ステップ S604 では、モニタ 440 に表示される  
遠位端部 101 と観察部位との距離を参照しながら遠位端部 101 を観察部位に接近させ  
る。そして、観察部位の血流を測定する。

#### 【0043】

ステップ S605 では、治療用レーザ光の照射に最適な位置に遠位端部 101 を置く。  
例えば対物レンズ 131 の焦点距離に適合する位置である。ステップ S606 では、観察  
部位へ治療用レーザ光を照射する。照射する間、計測用レーザを用いて観察部位の温度を  
測定する。計測温度に従って治療用レーザ光の出力は自動的に制御される。ステップ S6  
07 では、温度によって観察部位が十分に治療用レーザ光により焼灼されたか否かを判断  
し、十分と判断したときには観察部位への治療用レーザ光の照射を終了する。

#### 【0044】

ステップ S608 では、治療用レーザ光の照射が十分に行われたかを判断する。判断は  
観察部位における血流を測定することにより行われる。治療用レーザ光の照射によって観  
察部位の血液及び血管が凝固し、血流が停止しているのであれば、照射は十分であると判  
断してステップ S609 へ移行する。血流が停止していなければ照射は不十分であると判  
断してステップ S606 へ移行して治療用レーザ光の照射を再度行う。

#### 【0045】

ステップ S609 では、治療用レーザ光の照射が必要な血管の全てに照射を行ったか否  
かを判断する。全ての血管について照射が終了しているのであれば、ステップ S610 へ  
移行してこの処理は終了する。終了していないのであれば、ステップ S602 へ移行して  
別の血管に治療用レーザ光の照射を行う。

#### 【0046】

次に、図 7 を用いて治療用レーザ光の出力を制御する処理について説明する。

#### 【0047】

治療用レーザ光の照射が開始されると、ブロック 701 では、コンピュータ、すなわち  
画像処理装置 430 が A/D 変換器からのデジタルデータを用いて観察部位の温度を推定す  
る。そして、推定された温度に従って治療用レーザ装置 410 に治療用レーザ光の出力レ  
ベルを指示する。ブロック 702 において、治療用レーザ装置 410 は画像処理装置 43  
0 からの指示に従って出力レベルを調整しながら、治療用レーザ光の照射を行う。ブロッ  
ク 703 では、照射対象（観察部位）は治療用レーザ光の照射を受ける。

#### 【0048】

一方、ブロック 704 において、血流計（計測装置 300）は波長 780 nm の計測用  
レーザ光を照射対象に照射する。そして、照射対象からは波長 780 nm の反射レーザ光  
が反射されて血流計に入射する。反射レーザ光は血流計が備えるフォトディテクター 31  
4 に導かれ、フォトディテクター 314 は反射レーザ光の強度に従って電圧（計測信号）  
を出力する。電圧は画像処理装置 430 が備える A/D 変換器に伝達される。ブロック 70  
5 では、電圧（計測信号）を A/D 変換器がデジタルデータに変換し、画像処理装置 430  
へ伝達する。

#### 【0049】

次に図 8 を用いて画像処理装置 430 がモニタ 440 に画像を表示する処理について説  
明する。

#### 【0050】

ステップ S800 では、光結合分離装置 200 から画像処理装置 430 へアナログ信号  
による画像信号が入力されると、この処理が実行される。

#### 【0051】

ステップ S810 では、前処理部において画像処理装置 430 内のビデオキャプチャ回  
路（図示せず）の初期化等、動画像を表示するために必要な処理が行われる。

10

20

30

40

50

## 【0052】

次にリアルタイム映像表示部820において、ステップS821からS823までの処理が行われる。ステップS821において、画像処理装置430はモニタ440の解像度をモニタ440から取得する。ステップS822では、モニタ440の解像度に応じてモニタ440上に画像データを表示する位置を決定する。ステップS823では、画像処理装置430がCCD260から連続的に入力される画像信号をビデオキャプチャ回路によってAD変換し、モニタ440に画像データを連続的に送信し動画として表示する。この画像データは、ファイバスコープ100の遠位端部101に現在入射している観察部位の画像であり、連続的に表示することによりリアルタイム動画としてモニタ440に表示される。ステップS830では、処理が続行されるか否かが判断される。ユーザのボタン操作等により処理を続行すると判断する場合にはリアルタイム映像表示部820に処理が戻される。処理を終了すると判断する場合にはステップS840に処理が移されて、モニタ440に画像を表示する処理が終了する。

10

## 【0053】

これにより、観察部位が十分に焼灼出来たかを正確に把握すると共に、観察部位の状態に応じて治療用レーザー光を照射することにより患者の負担を軽減することが出来る。また、ユーザは、治療をすべき観察部位を探している間においても遠位端部101と観察部位との距離を正確に把握して、子宮等の人体に遠位端部101が接触することを防ぐことが出来る。

20

## 【0054】

図9を用いて第2の実施形態について説明する。第1の実施形態と同様の構成については説明を省略する。

## 【0055】

第2の実施形態では、光結合分離装置900は分離装置910と結合装置970とから主に構成される。

## 【0056】

分離装置910は第1のダイクロイックプリズム、レーザーカットフィルタ950、及びCCD960から主に構成される。光結合分離装置接続ファイバ110から入射した反射光は第1のダイクロイックプリズム231に入射する。第1のダイクロイックプリズム231の光学特性は第1の実施形態と同様である。第1のダイクロイックプリズム231は第1の反射面232を備える。反射光のうち、波長780nmの反射レーザー光は第1の反射面232で結合装置970へ反射される。反射光のうち波長780nm以下の波長の光、すなわち可視光線は画像として第1の反射面232を透過する。画像はレーザーカットフィルタ950により治療用レーザー光の成分を除去され、CCD960に入射する。

30

## 【0057】

結合装置970は第2のダイクロイックプリズムにより主に構成される。分離装置910から出力される反射レーザー光は結合装置970に入力される。結合装置970に入力された反射レーザー光は第2のダイクロイックプリズム241に入射する。第2のダイクロイックプリズム241の光学特性は実施形態1と同様である。反射レーザー光は第2のダイクロイックプリズム241の第2の反射面242により反射されて計測装置300へ導かれる。

40

## 【0058】

計測装置300は、結合装置970から入力された反射レーザー光を用いて実施形態1と同様の手段により、観察部位の血流、温度、及び遠位端部101から観察部位までの距離を算出する。

## 【0059】

治療用レーザー装置410は第1の実施形態と同様の手段により治療用レーザー光を生成して結合装置970に出力する。結合装置970に入力された治療用レーザー光は、第2のダイクロイックプリズム241に導かれる。治療用レーザー光は第2のダイクロイックプリズム241における第2の反射面242の背面から入射するため、第2の反射面242で反

50



射されずに透過する。そして、治療用レーザ光は分離装置 910 に導かれる。分離装置 910 へ伝達された治療用レーザ光は、第 1 のダイクロイックプリズムにより光結合分離装置接続ファイバ 110 へ出力される。そして治療用レーザ光は、第 1 の実施形態と同様の手段により観察部位に照射される。

#### 【0060】

これにより、分離装置 910 と結合装置 970 とを小型化して可搬性を向上させることが出来る。また、従来の光結合分離装置に結合装置 970 を接続することにより、第 1 の実施形態と同様の効果を得ることができる。

#### 【0061】

図 10 及び図 11 を用いて第 3 の実施形態について説明する。第 1 の実施形態と同様の構成については説明を省略する。

10

#### 【0062】

第 3 の実施形態における光結合分離装置 1100 は、第 1 及び第 3 のダイクロイックプリズム 231、1141 と、レーザカットフィルタ 1150 とを主に備える。第 1 のダイクロイックプリズム 231 は実施形態 1 と同様の光学的特性を有する。

#### 【0063】

治療用レーザ装置から入射した治療用レーザ光は第 1 のダイクロイックプリズム 231 の第 1 の反射面 232 で反射され、第 3 のダイクロイックプリズム 1141 に導かれる。第 3 のダイクロイックプリズム 1141 における第 3 の反射面 1142 は治療用レーザ光が入射する面とは反対側の面であるため、治療用レーザ光は第 3 の反射面 1142 を透過する。そして治療用レーザ光は光結合分離装置接続ファイバ 110 を介して複合光ファイバに出力され、第 1 の実施形態と同様の手段により観察部位に照射される。

20

#### 【0064】

観察部位からの反射光は、複合光ファイバを介して光結合分離装置接続ファイバ 110 から光結合分離装置に伝達される。光結合分離装置接続ファイバ 110 から入射した反射光は第 3 のダイクロイックプリズム 1141 に入射する。第 3 のダイクロイックプリズム 1141 の特性は図 11 に示される。

#### 【0065】

第 3 のダイクロイックプリズム 1141 は波長 780 nm の光のみを通過する光学特性を有する。第 3 のダイクロイックプリズム 1141 における第 3 の反射面 1142 に入射した反射光のうち、波長 780 nm の反射レーザ光は第 3 の反射面 1142 で反射されて計測装置に導かれる。波長 780 nm 以外の波長の光は画像として第 3 の反射面 1142 を透過して第 1 のダイクロイックプリズム 231 に入射する。第 1 のダイクロイックプリズム 231 は波長 780 nm 以下の波長の光、すなわち可視光線を透過させる光学特性を有する。波長 780 nm 以下である画像は第 1 のダイクロイックプリズム 231 を透過してレーザカットフィルタ 1150 に入射する。画像はレーザカットフィルタにより治療用レーザ光の成分を除去され、CCD 1114 に出力される。画像は CCD 1114 により電気信号へ変換され、第 1 の実施形態と同様の手段によりモニタに表示される。

30

#### 【0066】

計測装置 300 は、光結合分離装置 1100 から入力された反射レーザ光を用いて実施形態 1 と同様の手段により、観察部位の血流、温度、及び遠位端部 101 から観察部位までの距離を算出する。

40

#### 【0067】

これにより、光結合分離装置接続ファイバの接続部と、第 1 及び第 3 のダイクロイックプリズム 231、1141 と、CCD とを直線的に設けることが出来、光結合分離装置の幅を小さくすることが可能となる。

#### 【0068】

なお、第 1 から第 3 の実施形態において、光結合分離装置に接続される光結合分離装置接続ファイバ、治療用レーザ装置、及び計測装置、そして CCD のそれぞれの位置は互いに置き換えられても良い。このとき、各ダイクロイックプリズムの光学特性は各装置の位

50

置に応じて変更される。

【0069】

また、第1から第3のダイクロイックプリズムの光学特性は、計測用レーザ光の波長に応じて変更されても良い。

【0070】

さらに、第2及び第3のダイクロイックプリズムの光学特性は、計測用レーザ光を透過せず、治療用レーザ光を透過するものであればよい。

【0071】

血流の測定は具体的な数値が求められるような方法によらなくても良く、血流が有るか無いかを判断できるような方法であっても良い。

10

【0072】

治療用レーザ光の制御は自動で行われなくても良い。モニタ440への警告表示又は画像処理装置430からの音声による警告により、治療用レーザ光の出力の調整又は照射の終了をユーザに認知させても良い。

【図面の簡単な説明】

【0073】

【図1】内視鏡装置のブロック図である。

【図2】ファイバ스코プの遠位端部周辺を模式的に示した断面図である。

【図3】複合光ファイバの径方向断面図である。

【図4】複合光ファイバの長手方向断面図である。

20

【図5】第1及び第2のダイクロイックプリズムの光学特性を示したグラフである。

【図6】内視鏡装置における処理を示したフローチャートである。

【図7】治療用レーザ光の照射について示したブロック図である。

【図8】モニタ440に画像を表示する処理を示したフローチャートである。

【図9】第2の実施形態における内視鏡装置を模式的に示した図である。

【図10】第3の実施形態における光結合分離装置を模式的に示した図である。

【図11】第3のダイクロイックプリズムの光学特性を示したグラフである。

【符号の説明】

【0074】


- 100 ファイバ스코プ
- 135 複合光ファイバ
- 133 照明用ファイバ
- 200 第1の光結合分離装置
- 231 第1のダイクロイックプリズム
- 232 第1の反射面232
- 241 第2のダイクロイックプリズム
- 242 第2の反射面242
- 300 計測装置
- 314 フォトディテクター
- 410 治療用レーザ装置
- 420 光源装置
- 430 画像処理装置
- 440 モニタ440
- 900 第2の光結合分離装置
- 1100 第3の光結合分離装置

30


40




【図 5】

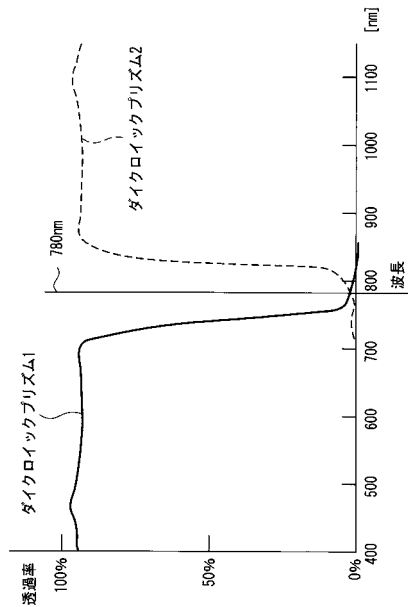


【図 6】

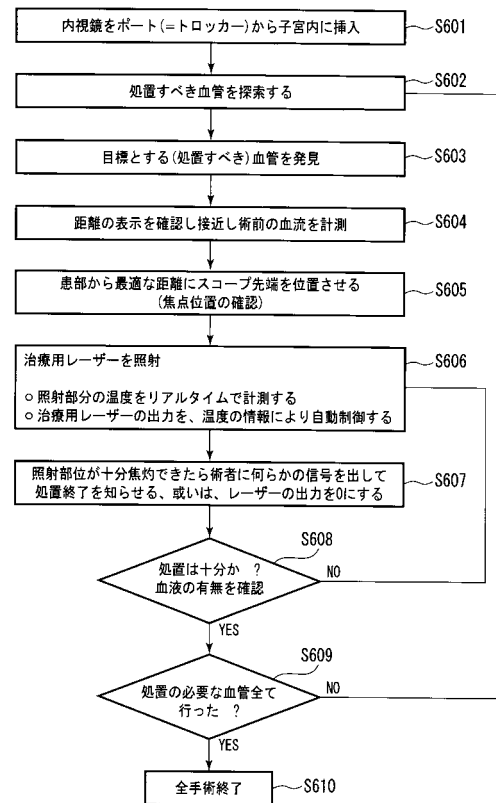


【図 7】

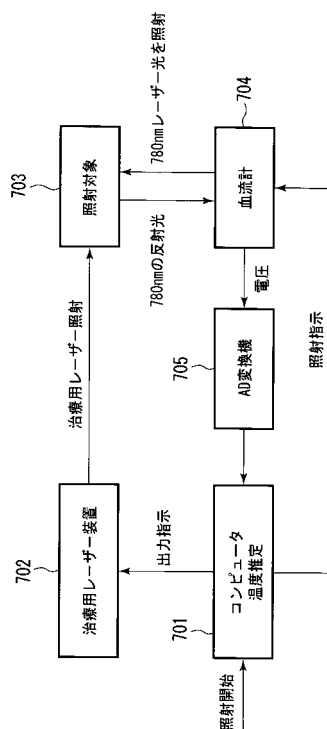


【図 8】

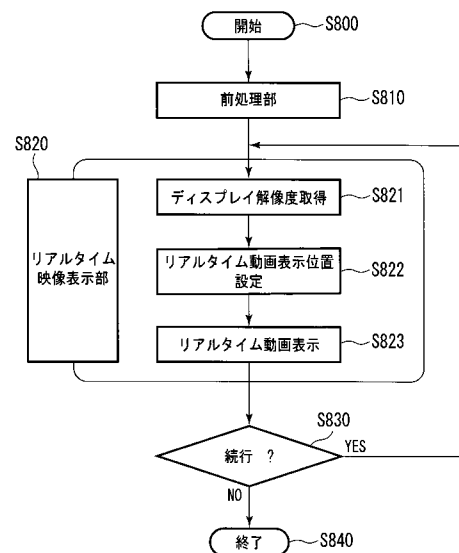


【図 9】

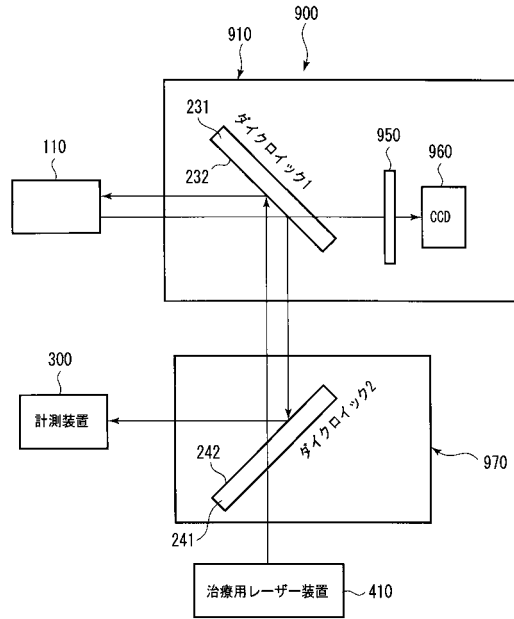

【図 10】

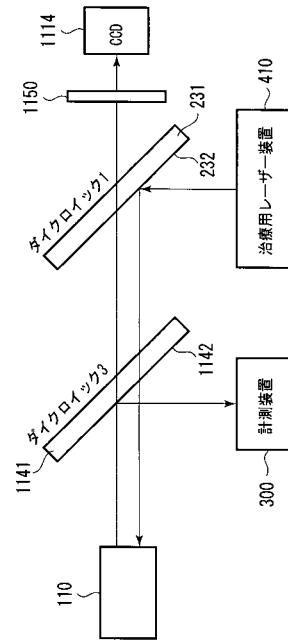

【図 11】

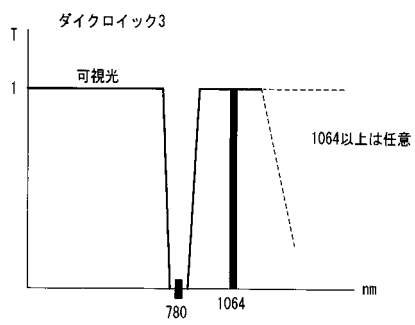

## フロントページの続き

- (73)特許権者 510136312  
独立行政法人国立成育医療研究センター  
東京都世田谷区大蔵 2-10-1
- (74)代理人 100090169  
弁理士 松浦 孝
- (74)代理人 100124497  
弁理士 小倉 洋樹
- (73)特許権者 307029319  
エーテック株式会社  
茨城県那珂郡東海村船石川駅西 2-14-19
- (74)代理人 100090169  
弁理士 松浦 孝
- (74)代理人 100124497  
弁理士 小倉 洋樹
- (74)代理人 100127306  
弁理士 野中 剛
- (74)代理人 100129746  
弁理士 虎山 滋郎
- (74)代理人 100132045  
弁理士 坪内 伸
- (72)発明者 市倉 繁  
東京都板橋区前野町 2 丁目 3 6 番 9 号 ペンタックス株式会社内
- (72)発明者 向本 徹  
東京都板橋区前野町 2 丁目 3 6 番 9 号 ペンタックス株式会社内
- (72)発明者 中村 哲也  
東京都板橋区前野町 2 丁目 3 6 番 9 号 ペンタックス株式会社内
- (72)発明者 岡 潔  
茨城県那珂郡東海村村松 4 番地 4 9 独立行政法人日本原子力研究開発機構内
- (72)発明者 大川 慶直  
茨城県那珂郡東海村船石川駅西 2-14-19 エーテック株式会社内
- (72)発明者 千葉 敏雄  
東京都世田谷区大蔵 2 丁目 10 番 1 号 国立成育医療センター内

審査官 井上 香緒梨

- (56)参考文献 特開平 01-238853 (JP, A)  
特開平 01-250740 (JP, A)  
特開 2001-204683 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)  
A 61 B 1/00

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 内视镜装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP4997443B2</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公开(公告)日 | 2012-08-08 |
| 申请号            | JP2006292578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 申请日     | 2006-10-27 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 旭光学工业株式会社<br>国家中心儿童健康和发展的一般<br>Etekku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 宾得株式会社<br>独立行政法人 日本原子力研究开发机构<br>国家中心儿童健康和发展的一般<br>イーテック株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| 当前申请(专利权)人(译)  | 独立行政法人日本原子力研究开发机构<br>国立儿童健康研究中心<br>イーテック株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |
| [标]发明人         | 市倉繁<br>向本徹<br>中村哲也<br>岡潔<br>大川慶直<br>千葉敏雄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 发明人            | 市倉 繁<br>向本 徹<br>中村 哲也<br>岡 潔<br>大川 慶直<br>千葉 敏雄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| IPC分类号         | A61B1/00 A61B18/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
| FI分类号          | A61B1/00.300.D A61B1/00.300.U A61B1/00.300.H A61B17/36.350 A61B1/00.550 A61B1/00.553<br>A61B1/00.621 A61B1/00.732 A61B18/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| F-TERM分类号      | 4C026/AA01 4C026/FF17 4C026/FF33 4C026/FF34 4C026/FF52 4C026/FF53 4C026/FF55 4C026<br>/GG06 4C026/GG07 4C026/HH02 4C026/HH13 4C061/AA00 4C061/BB02 4C061/CC07 4C061/DD00<br>4C061/FF46 4C061/HH51 4C061/HH56 4C061/JJ11 4C061/LL03 4C061/NN01 4C061/NN05 4C061<br>/QQ01 4C061/WW15 4C161/AA00 4C161/BB02 4C161/CC07 4C161/DD00 4C161/FF46 4C161/HH51<br>4C161/HH56 4C161/JJ11 4C161/LL03 4C161/NN01 4C161/NN05 4C161/QQ01 4C161/WW15 |         |            |
| 代理人(译)         | 松浦 孝<br>野刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
| 其他公开文献         | JP2008104791A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |

#### 摘要(译)

要解决的问题：通过准确地获取观察部位的血流，从纤维镜的远端到观察部位的距离，提供一种执行安全且可靠的激光治疗的内窥镜设备，对人体施加很小的负担，和观察点的温度。ŽSOLUTION：测量仪器300将波长为780nm的测量激光照射到观察部位。反射的激光从观察位置反射并进入测量仪器。反射的激光由设置在测量仪器300中的光电检测器314引导，并根据反射的激光的强度输出测量信号。图像处理器430根据测量信号将治疗激光的输出水平命令到治疗激光装置410。治疗激光装置410在根据来自图像处理器430的命令调节输出水平的同时照射治疗激光

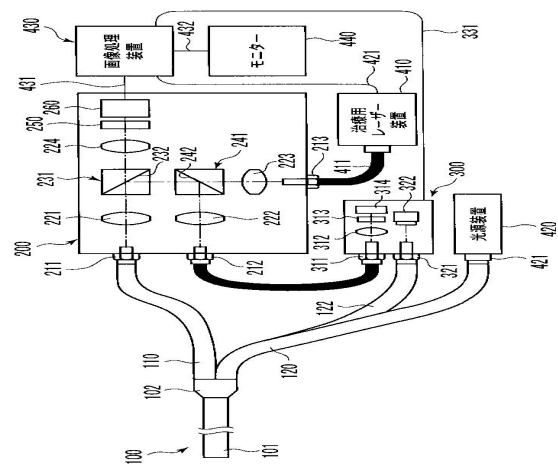


图 1