

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02010/044446

発行日 平成24年3月15日(2012.3.15)

(43) 国際公開日 平成22年4月22日(2010.4.22)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/04 (2006.01)	A 6 1 B 1/04 3 7 0	4 C 0 3 8
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 2 0 B	4 C 0 6 1
A 6 1 B 5/07 (2006.01)	A 6 1 B 5/07	4 C 1 6 1
G 0 6 T 1/00 (2006.01)	G 0 6 T 1/00 2 9 0 Z	5 B 0 5 7
G 0 6 T 5/00 (2006.01)	G 0 6 T 5/00 1 0 0	5 C 1 2 2
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 21 頁) 最終頁に続く		


出願番号	特願2010-515306 (P2010-515306)	(71) 出願人	000000376
(21) 国際出願番号	PCT/JP2009/067863		オリンパス株式会社
(22) 国際出願日	平成21年10月15日(2009.10.15)		東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
(11) 特許番号	特許第4589464号 (P4589464)	(74) 代理人	100089118
(45) 特許公報発行日	平成22年12月1日(2010.12.1)		弁理士 酒井 宏明
(31) 優先権主張番号	特願2008-268896 (P2008-268896)	(72) 発明者	葉袋 哲夫
(32) 優先日	平成20年10月17日(2008.10.17)		東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		リンパスメディカルシステムズ株式会社内
		(72) 発明者	田村 和昭
			東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
			リンパス株式会社内
		(72) 発明者	森 健
			東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
			リンパス株式会社内
		Fターム(参考)	4C038 CC03 CC09
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像生成装置、内視鏡システム、および画像生成方法

(57) 【要約】

本発明の一態様にかかる画像生成装置および内視鏡システムは、取得された複数の色要素情報であるRGBデータをもとに白色画像である通常画像を生成する通常画像生成回路(21)と、RGBデータの色相を算出する色相算出回路(22)と、算出された色相をもとに黄色成分を検出する黄色成分検出回路(23)と、黄色成分除去回路(24)と、分光画像生成回路(25)と、を備える。黄色成分除去回路(24)は、Gデータから黄色成分検出回路(23)が検出した黄色成分を除去した黄色除去Gデータ(GY)を生成する。分光画像生成回路(25)は、黄色除去Gデータ(GY)とBデータとをもとに血管画像である分光画像を生成する。

【図4】

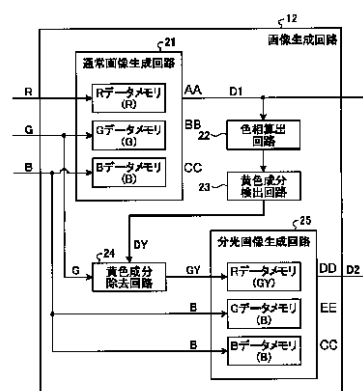

- 12 IMAGE GENERATING CIRCUIT
- 21 NORMAL IMAGE GENERATING CIRCUIT
- AA R DATA MEMORY (R)
- BB G DATA MEMORY (G)
- CC B DATA MEMORY (B)
- 24 YELLOW COMPONENT REMOVING CIRCUIT
- 22 HUE CALCULATING CIRCUIT
- 23 YELLOW COMPONENT DETECTION CIRCUIT
- 25 SPECTRAL IMAGE GENERATING CIRCUIT
- DD R DATA MEMORY (GY)
- EE G DATA MEMORY (B)

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

取得された複数の色要素情報をもとに第 1 の画像情報を生成する第 1 画像情報生成手段と、

各色要素情報をもとに所定の色成分を検出する色成分検出手段と、

前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出手段が検出した所定の色成分を除去する色成分除去手段と、

前記色成分除去手段によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに第 2 の画像情報を生成する第 2 画像情報生成手段と、

を備えたことを特徴とする画像生成装置。

10

【請求項 2】

前記複数の色要素情報は、赤色、緑色、青色の 3 つのデータであり、

前記色成分検出手段は、黄色の色成分を検出し、

前記色成分除去手段は、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、

前記第 2 画像情報生成手段は、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする請求項 1 に記載の画像生成装置。

【請求項 3】

前記色成分検出手段は、黄色の波長以上の色成分を検出し、

前記色成分除去手段は、前記緑色データから前記黄色の波長以上の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成することを特徴とする請求項 2 に記載の画像生成装置。

20

【請求項 4】

前記第 2 画像情報生成手段は、前記第 1 の画像情報の赤色データに前記黄色除去緑色データを対応づけ、前記第 1 の画像情報の緑色データおよび青色データのそれぞれに前記青色データを対応付けて生成することを特徴とする請求項 2 に記載の画像生成装置。

【請求項 5】

前記第 2 画像情報生成手段は、前記黄色除去緑色データおよび前記青色データの各コントラスト情報をもとに、前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする請求項 2 に記載の画像生成装置。

【請求項 6】

請求項 1 に記載の画像生成装置を備えたことを特徴とする内視鏡システム。

30

【請求項 7】

被検体の体内画像を撮像する内視鏡装置と、

前記画像生成装置が生成した第 1 および第 2 の画像情報を表示する表示装置と、

を備えたことを特徴とする請求項 6 に記載の内視鏡システム。

【請求項 8】

前記内視鏡装置は、カプセル型内視鏡であることを特徴とする請求項 7 に記載の内視鏡システム。

【請求項 9】

取得された赤色データ、緑色データ、および青色データをもとに第 1 の画像情報を生成する第 1 画像情報生成ステップと、

40

前記第 1 の画像情報の色相を算出し、この算出した色相をもとに黄色成分を検出する色成分検出ステップと、

前記緑色データから前記黄色成分を除去する色成分除去ステップと、

前記色成分除去ステップによって前記黄色成分を除去した緑色データである黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに、第 2 の画像情報を生成する第 2 画像情報生成ステップと、

を含むことを特徴とする画像生成方法。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】**

50

【 0 0 0 1 】

この発明は、白色光によって照明された被写体のカラー画像である通常画像と特定の色成分をもとに生成される分光画像とを同一の被写体に対して位置関係を一致して同時に得ることができる画像生成装置、内視鏡システム、および画像生成方法に関するものである。

【 背景技術 】

【 0 0 0 2 】

近年、内視鏡分野においては、撮像機能と無線通信機能とを設けたカプセル型の被検体内導入装置（例えばカプセル型内視鏡）が提案され、このカプセル型内視鏡を用いて被検体内の画像を取得する被検体内導入システムが開発されている。カプセル型内視鏡は、被検体内を観察（検査）するために、例えば被検体の口から飲込まれ、その後、自然排出されるまでの間、体腔内たとえば胃、小腸等の臓器の内部をその蠕動運動に従って移動するとともに、例えば 0.5 秒間隔で被検体内の画像を撮像するように機能する。

10

【 0 0 0 3 】

カプセル型内視鏡が被検体内を移動する間、このカプセル型内視鏡によって撮像された画像は、被検体の体表面に配置したアンテナを介して外部の画像表示装置に受信される。この画像表示装置は、カプセル型内視鏡に対する無線通信機能と画像のメモリ機能とを有し、被検体内のカプセル型内視鏡から受信した画像をメモリに順次格納する。医師または看護師は、かかる画像表示装置に蓄積された画像、すなわち被検体の消化管内の画像をディスプレイに表示することによって、被検体内を観察（検査）し、診断することができる。

20

【 0 0 0 4 】

ここで、特許文献 1 には、体内画像を取得する場合、鮮明な画像を得るために、青感度素子の割合を、赤感度素子および緑感度素子のそれぞれの割合に比して大きくしたカラーフィルタアレイ（CFA）を用いるものが記載されている。これは、青色の光が他の光に比して波長が短いため、体内組織内部に透過し散乱することなく、体内組織表面で反射することを利用したものである。

【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

【 0 0 0 5 】

30

【 特許文献 1 】 特開 2 0 0 6 - 2 9 7 0 9 3 号 公 報

【 特許文献 2 】 特開平 5 - 3 3 2 8 3 8 号 公 報

【 特許文献 3 】 特開 2 0 0 7 - 1 9 5 0 2 3 号 公 報

【 特許文献 4 】 特開 2 0 0 6 - 3 3 6 3 9 号 公 報

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 6 】

ところで、内視鏡などの分野では、白色光によって照明された被写体のカラー画像である通常画像と特定の色成分をもとに生成される分光画像との複数の画像を得て、診断等を行っているが、同じ被写体に対して位置関係が一致した通常画像と分光画像とを同時に得ることができなかった。

40

【 0 0 0 7 】

すなわち、同一被写体に対する通常画像と分光画像とは、通常画像用および分光画像用の各撮像素子を異なる近傍位置に配置し、切り替えによって各画像を取得し、あるいは、通常画像用および分光画像用の照明手段を異なる位置に配置し、各照明手段を切り替えて 1 つの撮像素子によって各画像を取得するようにしていた。いずれの場合にも、各画像は、同一の被写体に対して位置関係が一致した画像とは言えない。

【 0 0 0 8 】

この発明は、上記に鑑みてなされたものであって、簡易な構成で、同一被写体に対して位置関係が一致した通常画像と分光画像とを同時に得ることができる画像生成装置、内視

50

鏡システム、および画像生成方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

上述した課題を解決し、目的を達成するために、この発明にかかる画像生成装置は、取得された複数の色要素情報をもとに第1の画像情報を生成する第1画像情報生成手段と、各色要素情報をもとに所定の色成分を検出する色成分検出手段と、前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出手段が検出した所定の色成分を除去する色成分除去手段と、前記色成分除去手段によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに第2の画像情報を生成する第2画像情報生成手段と、を備えたことを特徴とする。

10

【0010】

また、この発明にかかる画像生成装置は、上述した発明において、前記複数の色要素情報は、赤色、緑色、青色の3つのデータであり、前記色成分検出手段は、黄色の色成分を検出し、前記色成分除去手段は、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、前記第2画像情報生成手段は、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第2の画像情報を生成することを特徴とする。

【0011】

また、この発明にかかる画像生成装置は、上述した発明において、前記色成分検出手段は、黄色の波長以上の色成分を検出し、前記色成分除去手段は、前記緑色データから前記黄色の波長以上の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成することを特徴とする。

20

【0012】

また、この発明にかかる画像生成装置は、上述した発明において、前記第2画像情報生成手段は、前記第1の画像情報の赤色データに前記黄色除去緑色データを対応づけ、前記第1の画像情報の緑色データおよび青色データのそれぞれに前記青色データを対応付けて生成することを特徴とする。

【0013】

また、この発明にかかる画像生成装置は、上述した発明において、前記第2画像情報生成手段は、前記黄色除去緑色データおよび前記青色データの各コントラスト情報をもとに、前記第2の画像情報を生成することを特徴とする。

【0014】

また、この発明にかかる内視鏡システムは、上述した発明のいずれか一つに記載の画像生成装置を備えたことを特徴とする。

30

【0015】

また、この発明にかかる内視鏡システムは、上述した発明において、被検体の体内画像を撮像する内視鏡装置と、前記画像生成装置が生成した第1および第2の画像情報を表示する表示装置と、を備えたことを特徴とする。

【0016】

また、この発明にかかる内視鏡システムは、上述した発明において、前記内視鏡装置は、カプセル型内視鏡であることを特徴とする。

【0017】

また、この発明にかかる画像生成方法は、取得された赤色データ、緑色データ、および青色データをもとに第1の画像情報を生成する第1画像情報生成ステップと、前記第1の画像情報の色相を算出し、この算出した色相をもとに黄色成分を検出する色成分検出ステップと、前記緑色データから前記黄色成分を除去する色成分除去ステップと、前記色成分除去ステップによって前記黄色成分を除去した緑色データである黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに、第2の画像情報を生成する第2画像情報生成ステップと、を含むことを特徴とする。

40

【発明の効果】

【0018】

この発明によれば、第1画像生成手段が、取得された複数の色要素情報をもとに白色画

50

像などの通常画像である第 1 の画像情報を生成するとともに、色成分検出手段が、各色要素情報をもとに所定の色成分を検出し、色成分除去手段が、前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出手段が検出した所定の色成分を除去し、第 2 画像情報生成手段が、前記色成分除去手段によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに血管画像などの分光画像である第 2 の画像情報を生成するようにしているので、簡易な構成で、同一被写体に対して位置関係が一致した通常画像などの第 1 の画像情報と分光画像などの第 2 の画像情報とを同時に得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【0019】

【図 1】図 1 は、この発明の実施の形態である内視鏡システムであるカプセル型内視鏡システムの全体概要構成を示す図である。

10

【図 2】図 2 は、カプセル型内視鏡に搭載される撮像素子の画素配列の一例を示す図である。

【図 3】図 3 は、画像生成装置の構成を示すブロック図である。

【図 4】図 4 は、画像生成回路の構成を示す詳細ブロック図である。

【図 5】図 5 は、体腔内壁の分光特性、血液の吸光特性、発光素子の放射輝度、および撮像素子の分光感度の各波長依存性を示す図である。

【図 6】図 6 は、体腔内壁と血管に対する光の進入と反射との関係を示す模式図である。

【図 7】図 7 は、この発明の実施の形態である画像生成処理手順を示すフローチャートである。

20

【発明を実施するための形態】

【0020】

以下、図面を参照して、この発明にかかる画像生成装置およびこれを用いた内視鏡システム、並びに画像生成方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。なお、この実施の形態では、内視鏡システムにおける内視鏡装置の一例としてカプセル型内視鏡を例示するが、この実施の形態によってこの発明が限定されるものではない。

【0021】

(実施の形態)

図 1 は、この発明の実施の形態にかかる内視鏡システムの構成を示す模式図である。図 1 に示すように、この実施の形態にかかる内視鏡システムは、被検体 1 の体内画像を撮像するカプセル型内視鏡 2 と、カプセル型内視鏡 2 によって無線送信された画像信号を受信する受信装置 3 と、カプセル型内視鏡 2 によって撮像された体内画像を表示する画像表示装置 4 と、受信装置 3 と画像表示装置 4 との間におけるデータの受け渡しを行うための可搬型の記録媒体 5 とを備える。

30

【0022】

カプセル型内視鏡 2 は、被検体 1 の体内画像を撮像する内視鏡装置の一例であり、カプセル型の筐体内部に撮像機能と無線通信機能とを備える。カプセル型内視鏡 2 は、経口摂取等によって被検体 1 の臓器内部に導入され、その後、蠕動運動等によって被検体 1 の臓器内部を移動しつつ、所定の間隔（例えば 0.5 秒間隔）で被検体 1 の体内画像を順次撮像する。具体的には、カプセル型内視鏡 2 は、臓器内部において被写体に白色光等の照明光を照射し、この照明光によって照明された被写体の画像、すなわち被検体 1 の体内画像を撮像する。カプセル型内視鏡 2 は、このように撮像した被検体 1 の体内画像の画像信号を外部の受信装置 3 に無線送信する。カプセル型内視鏡 2 は、被検体 1 の臓器内部に導入されてから被検体 1 の外部に排出されるまでの期間、かかる体内画像の撮像動作および無線送信動作を順次繰り返す。なお、カプセル型内視鏡 2 の撮像部は、図 2 に示すような赤（R）、緑（G）、青（B）の画素が配置された撮像素子が用いられる。ここでは、図 2 の画素配列 2a に例示するようなベイヤー配列の撮像素子が用いられ、G データが、R データおよび B データの 2 倍の受光感度を持ち、通常の撮像素子の配列となっており、そのまま上述した R G B データの通常画像（白色光画像）を得ることができる。また、カプセル型内視鏡の発光部は、白色光を発光する LED が用いられている。

40

50

【 0 0 2 3 】

受信装置 3 は、例えば被検体 1 の体表上に分散配置される複数の受信アンテナ 3 a ~ 3 h を備え、複数の受信アンテナ 3 a ~ 3 h のうちの少なくとも一つを介して被検体 1 内部のカプセル型内視鏡 2 からの無線信号を受信する。受信装置 3 は、カプセル型内視鏡 2 からの無線信号から画像信号を抽出し、この抽出した画像信号に含まれる体内画像の画像データを取得する。

【 0 0 2 4 】

また、受信装置 3 は、被写体の位置関係が互いに一致する 2 種類の画像を異なる画像処理によって生成する画像生成機能を備える。受信装置 3 は、カプセル型内視鏡 2 から取得した 1 フレーム分の体内画像の色データをもとに異なる画像処理を行って、被写体の位置関係が一致し且つ画像処理が異なる 2 種類の画像、例えば白色光画像などの通常画像および分光画像を生成する。受信装置 3 によって生成された通常画像および分光画像は、描画態様が互いに異なる同一被写体の体内画像である。受信装置 3 は、カプセル型内視鏡 2 から 1 フレーム分の体内画像を取得する都度、取得した 1 フレーム分の体内画像に基づく同一被写体の通常画像および分光画像を順次生成する。受信装置 3 は、予め挿着された記録媒体 5 に、通常画像群および分光画像群を蓄積する。この場合、受信装置 3 は、同一の体内画像に基づく同一被写体の通常画像および分光画像を、画像処理が異なる同一フレーム番号の体内画像として記録媒体 5 に順次保存する。また、受信装置 3 は、白色光画像群および分光画像群の各画像に、元の体内画像の撮像時刻または受信時刻等の時間データを各々対応付ける。

【 0 0 2 5 】

なお、受信装置 3 の受信アンテナ 3 a ~ 3 h は、図 1 に示したように被検体 1 の体表上に配置してもよいし、被検体 1 に着用させるジャケットに配置されてもよい。また、受信装置 3 の受信アンテナ数は、1 以上であればよく、特に 8 つに限定されない。

【 0 0 2 6 】

画像表示装置 4 は、記録媒体 5 を介して被検体 1 の体内画像群等の各種データを取り込み、取り込んだ体内画像群等の各種データを表示するワークステーションのような構成を有する。具体的には、画像表示装置 4 は、受信装置 3 から取り外された記録媒体 5 を挿着され、この記録媒体 5 の保存データを取り込むことによって、被検体 1 の体内画像群（通常画像群および分光画像群）等の各種データを取得する。画像表示装置 4 は、取得した体内画像をディスプレイに表示し、この表示した体内画像に指定された所望の画像領域を異なる画像処理の同一被写体画像に切り替える表示切替機能を有する。この画像表示装置 4 による画像表示によって診断等が行われる。

【 0 0 2 7 】

記録媒体 5 は、上述した受信装置 3 と画像表示装置 4 との間におけるデータの受け渡しを行うための可搬型の記録メディアである。記録媒体 5 は、受信装置 3 および画像表示装置 4 に対して着脱可能であって、両者に対する挿着時にデータの出力および記録が可能な構造を有する。具体的には、記録媒体 5 は、受信装置 3 に挿着された場合、受信装置 3 によって画像処理された体内画像群および各画像の時間データ等を記録する。

【 0 0 2 8 】

つぎに、図 3 を参照し、受信装置 3 に組み込まれる画像生成装置 10 について説明する。画像生成装置 10 は、無線送信された無線信号からベースバンド信号に変換されたデータ D に対して前処理を行って R G B の各色データを出力する前処理回路 11 と、R G B の各色データをもとに通常画像 D1 と分光画像 D2 とを生成する画像生成回路 12 と、通常画像 D1 に対して所定の画像調整などの後処理を行って最終的な通常画像 D10 を出力する通常画像調整回路 13 と、分光画像 D2 に対して所定の画像調整などの後処理を行って最終的な分光画像 D20 を出力する分光画像調整回路 14 とを有する。特に、画像生成回路 12 は、入力された R G B の各色データから黄色成分を検出し、G データからこの黄色成分データを除去したデータと B データとをもとに分光画像を生成する。

【 0 0 2 9 】

図4は、画像生成回路12の詳細構成を示すブロック図である。画像生成回路12は、通常画像生成回路21、色相算出回路22、黄色成分検出回路23、黄色成分除去回路24、および分光画像生成回路25を有する。通常画像生成回路21は、入力されたRGBの各色データをそれぞれRデータメモリ、Gデータメモリ、Bデータメモリに一時格納し、これらを合成して1フレームの通常画像データD1として出力する。

【0030】

色相算出回路22は、通常画像生成回路21から出力された通常画像データD1をもとに、色相を算出する。黄色成分検出回路23は、色相算出回路22が算出した色相をもとに黄色成分データDYを検出する。一方、黄色成分除去回路24は、通常画像生成回路21に入力されるGデータから黄色成分データDYを除去した黄色除去GデータGYを生成する。

10

【0031】

分光画像生成回路25は、黄色成分除去回路24から出力された黄色除去Gデータおよび通常画像生成回路21に入力されるBデータをもとに、緑および青のコントラスト情報を用いた分光画像データD2を生成出力する。分光画像生成回路25は、黄色除去GデータをRデータメモリに、BデータをGデータメモリおよびBデータメモリに一時格納し、コントラスト情報を用いた分光画像データD2を各RGBデータに対応させて出力する。

【0032】

ここで、図5および図6を参照して、分光画像について説明する。図5(a)の分光特性L1に示すように、体腔内壁の分光特性レベルは、黄色(580nm)~赤色(680nm)以上にかけて大きい。一方、血液の吸光特性レベルは、図5(b)の吸光特性L2に示すように、415nm(青色)と540nm(緑色)とにピークがある以外は低い。すなわち、体腔内壁の画像は、一般に赤みがかったものとなり、体腔内壁の分光特性による色や明るさのコントラスト情報は、G画素(Gデータ)とR画素(Rデータ)とに多く現れ、血液の吸光特性による明るさのコントラスト情報は、B画素(Bデータ)とG画素(Gデータ)とに多く現れる。

20

【0033】

一方、発光素子の放射輝度レベルは、図5(c)の発光特性L3に示すように、ピーク波長は血液の吸光特性のピーク波長と同じ415nm付近にあるが、全体では青色(B)、緑色(G)、赤色(R)に偏らず、白色光が実現されている。ここで、図5(d)に示すように、撮像素子の分光感度レベルは、各B、G、R画素が、415nm(青色)、540nm(緑色)、および680nm(赤色)をほぼ中心としてピークをもつ分布特性L4B, L4G, L4Rをもつ。ただし、各分布特性L4B, L4G, L4Rは、各分布が重複する領域が存在し、たとえば、分布特性L4G, L4Rとは、580nm(黄色)で重複している。すなわち、GデータおよびRデータには、それぞれ黄色成分が含まれることになる。

30

【0034】

ところで、図6に示すように、体腔内壁には、粘膜表層40に毛細血管50が存在し、さらに粘膜深部41には、太い血管51が存在する。体腔内壁に照射される415nm(青色)の光は、波長が短いため、組織内部まで透過せず、上述した血液の吸光特性によって毛細血管50に吸収される(図6の30B参照)。また、540nm(緑色)の光は、青色よりも波長が長いため、粘膜深部41まで透過し、上述した血液の吸光特性によって太い血管51に吸収される(図6の30G参照)。一方、赤色の光は、内部組織42まで透過し、散乱光としてほとんどが反射される(図6の30R参照)。したがって、415nm(青色)および540nm(緑色)のみの受光感度を持たせれば、毛細血管50および太い血管51などの血管画像のコントラスト情報を得ることができる。

40

【0035】

したがって、BデータおよびGデータのみによって血管のコントラスト情報をもとに血管画像が上述した分光画像として得られるが、図5(d)に示した撮像素子の分光感度の分布特性から、Gデータに黄色成分が含まれ、分光画像の解像度が低下してしまう。

50

【 0 0 3 6 】

このため、上述した画像生成回路 1 2 によって、各 R G B データから色相を算出し、この色相から黄色成分を検出し、この黄色成分を、G データから削除することによって緑色 (5 4 0 n m) のみのコントラスト情報を得ることができる。一方、B データからは、青色 (4 1 5 n m) のみのコントラスト情報を得ることができる。なお、B データには、少量の G データの短波長成分が含まれてもよいし、G データには、少量の B データの長波長成分が含まれていてもよい。要は、4 1 5 n m (青色) と 5 4 0 n m (緑色) の成分のコントラスト情報のみによって分光画像が生成されればよい。

【 0 0 3 7 】

なお、上述した実施の形態では、G データから黄色成分を除去するようにしていたが、黄色成分以上の赤色成分を含む長波長成分を除去するようにしてもよい。このような黄色成分以上の長波長成分を G データから除去することによって、G データが緑色領域のみの狭帯域データとなり、鮮鋭な分光画像を得ることができる。

【 0 0 3 8 】

また、上述した実施の形態では、受信装置 3 内に画像生成装置 1 0 を持たせるようにしているが、これに限らず、画像表示装置 4 側に持たせるようにしてもよい。この場合、受信装置 3 は、通常画像のみを生成し、記録媒体 5 は通常画像のみを記録し、画像表示装置 4 内の画像生成装置 1 0 が、通常画像を形成する R G B データをもとに分光画像を生成すればよい。また、この分光画像は、必要な場合に、作成指示をもとに所望の通常画像から作成するようにしてもよい。

【 0 0 3 9 】

さらに、上述した実施の形態では、画像生成装置 1 0 を回路構成で示したが、ソフトウェアによる画像処理によって通常画像および分光画像を生成するようにしてもよい。すなわち、図 7 に示すように、まず通常画像を形成する R G B データから通常画像を生成する (ステップ S 1 0 1) 。その後、この通常画像のデータから色相を算出し、この色相から黄色成分を検出する (ステップ S 1 0 2) 。その後、G データから黄色成分を除去する (ステップ S 1 0 3) 。最後に、B データと、黄色成分を除去した G データとから分光画像を生成し (ステップ S 1 0 4) 、本処理を終了する。この場合、ステップ S 1 0 1 を省略して、ステップ S 1 0 2 ~ S 1 0 4 によって通常画像か分光画像を得るようにしてもよい。

【 0 0 4 0 】

この実施の形態では、取得した各 R G B データから白色光の通常画像を得るとともに、同時に通常画像と位置関係が一致した血管画像などの分光画像を得ることができる。この結果、通常画像と分光画像との位置関係が一致しているので、診断等のときに、関心対象の特定などを容易かつ高精度に行うことができる。

【 0 0 4 1 】

なお、上述した実施の形態では、図 2 に示したようにベイヤー配列の撮像素子を用いていたが、これに限らず、R データと B データとの解像度を上げるため、R , G , G , B の配列のうちの 2 つの G 画素のうちの 1 つをマゼンタ (M g) 画素にしてもよい。M g 画素にすることで R 成分と B 成分とに感度をもたせることができ、R データと B データとの解像度を上げることができる。

【 産業上の利用可能性 】

【 0 0 4 2 】

以上のように、本発明にかかる画像生成装置、内視鏡システム、および画像生成方法は、白色光によって照明された被写体のカラー画像である通常画像と特定の色成分をもとに生成される分光画像とを取得することに有用であり、特に、同一の被写体に対して位置関係が一致した通常画像と分光画像とを簡易な構成で同時に得ることができる画像生成装置、内視鏡システム、および画像生成方法に適している。

【 符号の説明 】

【 0 0 4 3 】

10

20

30

40


50

- 1 被検体
- 2 カプセル型内視鏡
- 2 a 画素配列
- 3 受信装置
- 3 a ~ 3 h 受信アンテナ
- 4 画像表示装置
- 5 記録媒体
- 10 画像生成装置
- 11 前処理回路
- 12 画像生成回路
- 13 通常画像調整回路
- 14 分光画像調整回路
- 21 通常画像生成回路
- 22 色相算出回路
- 23 黄色成分検出回路
- 24 黄色成分除去回路
- 25 分光画像生成回路
- 40 粘膜表層
- 41 粘膜深部
- 42 内部組織
- 50 毛細血管
- 51 血管


10

20


【図 1】

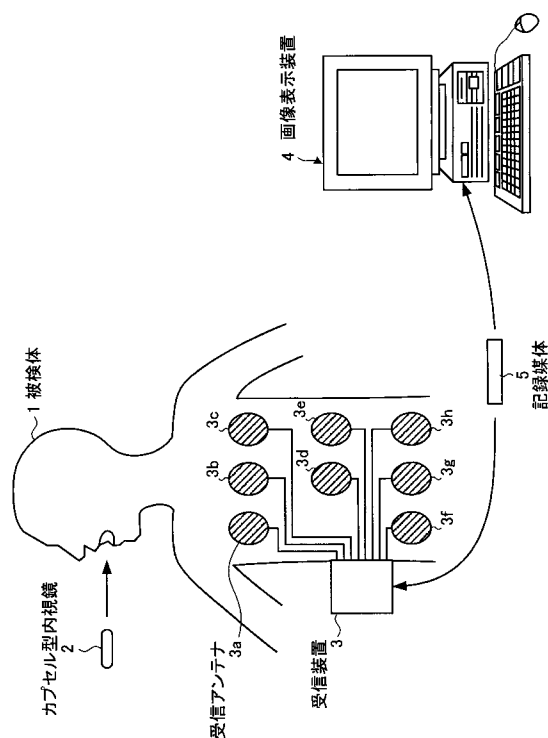


【図 2】

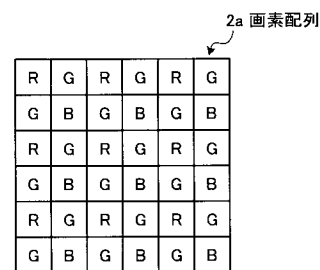


【図 3】

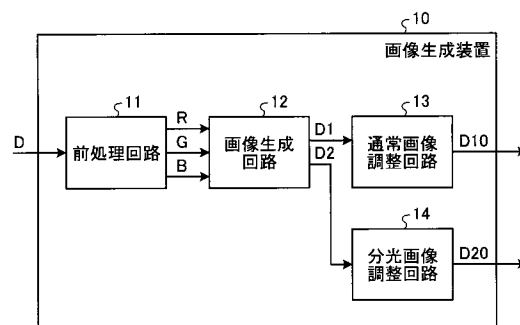


【図4】

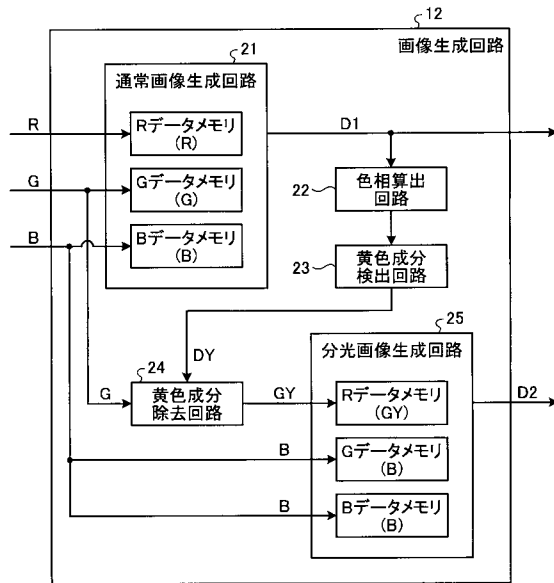


【図5】

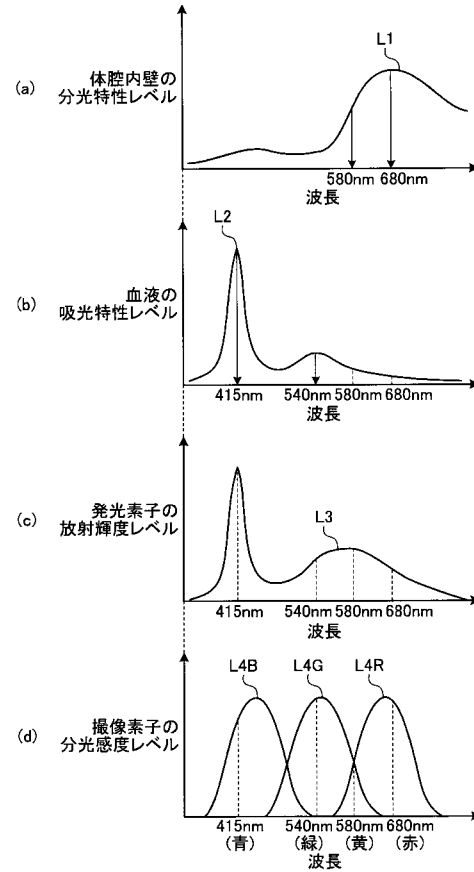

【図6】

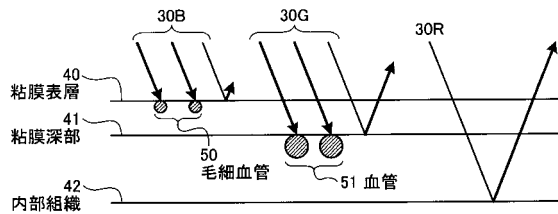

【図7】

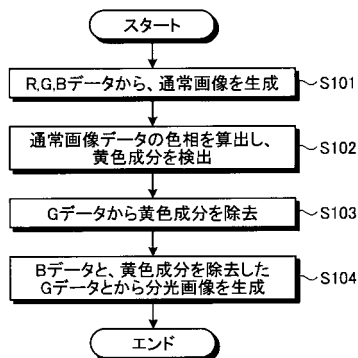

【手続補正書】

【提出日】平成22年4月19日(2010.4.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

取得された複数の色要素情報をもとに第 1 の画像情報を生成する第 1 画像情報生成部と

、

各色要素情報をもとに所定の色成分を検出する色成分検出部と、

前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出部が検出した所定の色成分を除去する色成分除去部と、

前記色成分除去部によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに第 2 の画像情報を生成する第 2 画像情報生成部と、

を備え、

前記複数の色要素情報は、赤色、緑色、青色の 3 つのデータであり、

前記色成分検出部は、黄色の色成分を検出し、

前記色成分除去部は、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、

前記第 2 画像情報生成部は、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする画像生成装置。

【請求項 2】

前記色成分検出部は、黄色の波長以上の色成分を検出し、

前記色成分除去部は、前記緑色データから前記黄色の波長以上の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成することを特徴とする請求項 1 に記載の画像生成装置。

【請求項 3】

前記第 2 画像情報生成部は、前記第 1 の画像情報の赤色データに前記黄色除去緑色データを対応づけ、前記第 1 の画像情報の緑色データおよび青色データのそれぞれに前記青色データを対応付けて生成することを特徴とする請求項 1 に記載の画像生成装置。

【請求項 4】

前記第 2 画像情報生成部は、前記黄色除去緑色データおよび前記青色データの各コントラスト情報をもとに、前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする請求項 1 に記載の画像生成装置。

【請求項 5】

取得された複数の色要素情報をもとに第 1 の画像情報を生成する第 1 画像情報生成部と、各色要素情報をもとに所定の色成分を検出する色成分検出部と、前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出部が検出した所定の色成分を除去する色成分除去部と、前記色成分除去部によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに第 2 の画像情報を生成する第 2 画像情報生成部と、を有する画像生成装置を備え、

、

前記複数の色要素情報は、赤色、緑色、青色の 3 つのデータであり、

前記色成分検出部は、黄色の色成分を検出し、

前記色成分除去部は、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、

前記第 2 画像情報生成部は、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする内視鏡システム。

【請求項 6】

被検体の体内画像を撮像する内視鏡装置と、

前記画像生成装置が生成した第１および第２の画像情報を表示する表示装置と、
をさらに備えることを特徴とする請求項５に記載の内視鏡システム。

【請求項７】

前記内視鏡装置は、カプセル型内視鏡であることを特徴とする請求項６に記載の内視鏡システム。

【請求項８】

取得された赤色データ、緑色データ、および青色データをもとに第１の画像情報を生成する第１画像情報生成ステップと、

前記第１の画像情報の色相を算出し、この算出した色相をもとに黄色成分を検出する色成分検出ステップと、

前記緑色データから前記黄色成分を除去する色成分除去ステップと、

前記色成分除去ステップによって前記黄色成分を除去した緑色データである黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに、第２の画像情報を生成する第２画像情報生成ステップと、

を含み、

前記複数の色要素情報は、赤色、緑色、青色の３つのデータであり、

前記色成分検出ステップは、黄色の色成分を検出し、

前記色成分除去ステップは、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、

前記第２画像情報生成ステップは、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第２の画像情報を生成することを特徴とする画像生成方法。

【請求項９】

取得された複数の色要素情報をもとに第１の画像情報を生成する第１画像情報生成手段部と、

各色要素情報をもとに所定の色成分を検出する色成分検出手段と、

前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出手段が検出した所定の色成分を除去する色成分除去手段と、

前記色成分除去手段によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに第２の画像情報を生成する第２画像情報生成手段と、

を備え、

前記複数の色要素情報は、赤色、緑色、青色の３つのデータであり、

前記色成分検出手段は、黄色の色成分を検出し、

前記色成分除去手段は、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、

前記第２画像情報生成手段は、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第２の画像情報を生成することを特徴とする画像生成装置。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００９

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００９】

上述した課題を解決し、目的を達成するために、この発明にかかる画像生成装置は、取得された複数の色要素情報をもとに第１の画像情報を生成する第１画像情報生成部と、各色要素情報をもとに所定の色成分を検出する色成分検出部と、前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出部が検出した所定の色成分を除去する色成分除去部と、前記色成分除去部によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに第２の画像情報を生成する第２画像情報生成部と、を備え、前記複数の色要素情報が、赤色、緑色、青色の３つのデータであり、前記色成分検出部が、黄色の色成分を検出し、前記色成分除去部が、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色デ

ータを生成し、前記第 2 画像情報生成部が、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

また、この発明にかかる画像生成装置は、上述した発明において、前記色成分検出部が、黄色の波長以上の色成分を検出し、前記色成分除去部が、前記緑色データから前記黄色の波長以上の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成することを特徴とする。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

また、この発明にかかる画像生成装置は、上述した発明において、前記第 2 画像情報生成部が、前記第 1 の画像情報の赤色データに前記黄色除去緑色データを対応づけ、前記第 1 の画像情報の緑色データおよび青色データのそれぞれに前記青色データを対応付けて生成することを特徴とする。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

また、この発明にかかる画像生成装置は、上述した発明において、前記第 2 画像情報生成部が、前記黄色除去緑色データおよび前記青色データの各コントラスト情報をもとに、前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

また、この発明にかかる内視鏡システムは、取得された複数の色要素情報をもとに第 1 の画像情報を生成する第 1 画像情報生成部と、各色要素情報をもとに所定の色成分を検出する色成分検出部と、前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出部が検出した所定の色成分を除去する色成分除去部と、前記色成分除去部によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに第 2 の画像情報を生成する第 2 画像情報生成部と、を有する画像生成装置を備え、前記複数の色要素情報が、赤色、緑色、青色の 3 つのデータであり、前記色成分検出部が、黄色の色成分を検出し、前記色成分除去部が、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、前記第 2 画像情報生成部が、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする。

【手続補正 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【００１４】

また、この発明にかかる内視鏡システムは、上記した発明において、被検体の体内画像を撮像する内視鏡装置と、前記画像生成装置が生成した第１および第２の画像情報を表示する表示装置と、をさらに備えることを特徴とする。

【手続補正８】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１５

【補正方法】変更

【補正の内容】

【００１５】

また、この発明にかかる内視鏡システムは、上述した発明において、前記内視鏡装置が、カプセル型内視鏡であることを特徴とする。

【手続補正９】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１６

【補正方法】変更

【補正の内容】

【００１６】

また、この発明にかかる画像生成方法は、取得された赤色データ、緑色データ、および青色データをもとに第１の画像情報を生成する第１画像情報生成ステップと、前記第１の画像情報の色相を算出し、この算出した色相をもとに黄色成分を検出する色成分検出ステップと、前記緑色データから前記黄色成分を除去する色成分除去ステップと、前記色成分除去ステップによって前記黄色成分を除去した緑色データである黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに、第２の画像情報を生成する第２画像情報生成ステップと、を含み、前記複数の色要素情報が、赤色、緑色、青色の３つのデータであり、前記色成分検出ステップが、黄色の色成分を検出し、前記色成分除去ステップが、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、前記第２画像情報生成ステップが、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第２の画像情報を生成することを特徴とする。

【手続補正１０】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１７

【補正方法】変更

【補正の内容】

【００１７】

また、この発明にかかる画像生成装置は、取得された複数の色要素情報をもとに第１の画像情報を生成する第１画像情報生成手段部と、各色要素情報をもとに所定の色成分を検出する色成分検出手段と、前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出手段が検出した所定の色成分を除去する色成分除去手段と、前記色成分除去手段によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに第２の画像情報を生成する第２画像情報生成手段と、を備え、前記複数の色要素情報が、赤色、緑色、青色の３つのデータであり、前記色成分検出手段が、黄色の色成分を検出し、前記色成分除去手段が、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、前記第２画像情報生成手段が、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第２の画像情報を生成することを特徴とする。

【手続補正書】

【提出日】平成22年7月26日(2010.7.26)

【手続補正１】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

取得された複数の色要素情報をもとに第 1 の画像情報を生成する第 1 画像情報生成部と、

各色要素情報をもとに所定の色成分を検出する色成分検出部と、

前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出部が検出した所定の色成分を除去する色成分除去部と、

前記色成分除去部によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに第 2 の画像情報を生成する第 2 画像情報生成部と、

を備え、

前記複数の色要素情報は、赤色、緑色、青色の 3 つのデータであり、

前記色成分検出部は、黄色の色成分を検出し、

前記色成分除去部は、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、

前記第 2 画像情報生成部は、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする画像生成装置。

【請求項 2】

前記色成分検出部は、黄色成分または黄色成分以上の赤色成分を含む長波長成分を検出し、

前記色成分除去部は、前記緑色データから前記黄色成分または黄色成分以上の赤色成分を含む長波長成分を除去した色データを生成することを特徴とする請求項 1 に記載の画像生成装置。

【請求項 3】

前記第 2 画像情報生成部は、前記第 1 の画像情報の赤色データに前記黄色除去緑色データを対応づけ、前記第 1 の画像情報の緑色データおよび青色データのそれぞれに前記青色データを対応付けて生成することを特徴とする請求項 1 に記載の画像生成装置。

【請求項 4】

前記第 2 画像情報生成部は、前記黄色除去緑色データおよび前記青色データの各コントラスト情報をもとに、前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする請求項 1 に記載の画像生成装置。

【請求項 5】

取得された複数の色要素情報をもとに第 1 の画像情報を生成する第 1 画像情報生成部と、各色要素情報をもとに所定の色成分を検出する色成分検出部と、前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出部が検出した所定の色成分を除去する色成分除去部と、前記色成分除去部によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに第 2 の画像情報を生成する第 2 画像情報生成部と、を有する画像生成装置を備え、

前記複数の色要素情報は、赤色、緑色、青色の 3 つのデータであり、

前記色成分検出部は、黄色の色成分を検出し、

前記色成分除去部は、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、

前記第 2 画像情報生成部は、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする内視鏡システム。

【請求項 6】

被検体の体内画像を撮像する内視鏡装置と、

前記画像生成装置が生成した第 1 および第 2 の画像情報を表示する表示装置と、

をさらに備えることを特徴とする請求項 5 に記載の内視鏡システム。

【請求項 7】

前記内視鏡装置は、カプセル型内視鏡であることを特徴とする請求項 6 に記載の内視鏡システム。

【請求項 8】

取得された赤色データ、緑色データ、および青色データをもとに第 1 の画像情報を生成する第 1 画像情報生成ステップと、

前記第 1 の画像情報の色相を算出し、この算出した色相をもとに黄色成分を検出する色成分検出ステップと、

前記緑色データから前記黄色成分を除去する色成分除去ステップと、

前記色成分除去ステップによって前記黄色成分を除去した緑色データである黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに、第 2 の画像情報を生成する第 2 画像情報生成ステップと、

を含み、

前記複数の色要素情報は、赤色、緑色、青色の 3 つのデータであり、

前記色成分検出ステップは、黄色の色成分を検出し、

前記色成分除去ステップは、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、

前記第 2 画像情報生成ステップは、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする画像生成方法。

【請求項 9】

取得された複数の色要素情報をもとに第 1 の画像情報を生成する第 1 画像情報生成手段と、

各色要素情報をもとに所定の色成分を検出する色成分検出手段と、

前記複数の色要素情報のうち所定の色要素情報から前記色成分検出手段が検出した所定の色成分を除去する色成分除去手段と、

前記色成分除去手段によって色成分が除去された色要素情報と他の色要素情報とをもとに第 2 の画像情報を生成する第 2 画像情報生成手段と、

を備え、

前記複数の色要素情報は、赤色、緑色、青色の 3 つのデータであり、

前記色成分検出手段は、黄色の色成分を検出し、

前記色成分除去手段は、前記緑色データから前記黄色の色成分を除去した黄色除去緑色データを生成し、

前記第 2 画像情報生成手段は、前記黄色除去緑色データと前記青色データとをもとに前記第 2 の画像情報を生成することを特徴とする画像生成装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 0】

また、この発明にかかる画像生成装置は、上述した発明において、前記色成分検出部が、黄色成分または黄色成分以上の赤色成分を含む長波長成分を検出し、前記色成分除去部が、前記緑色データから前記黄色成分または黄色成分以上の赤色成分を含む長波長成分を除去した色データを生成することを特徴とする。

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/067863

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61B1/04(2006.01)i, A61B1/00(2006.01)i, G06T1/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61B1/04, A61B1/00, G06T1/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2009
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2009	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2009

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2001-212073 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.),	1, 6
Y	07 August 2001 (07.08.2001),	7-8
A	paragraphs [0076] to [0078] (Family: none)	2-5, 9
X	JP 2003-79568 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.),	1, 6
Y	18 March 2003 (18.03.2003),	7-8
A	paragraphs [0057], [0064] to [0067], [0080] to [0087] & US 2003/0001104 A1	2-5, 9
Y	JP 2006-341078 A (Olympus Medical Systems Corp.), 21 December 2006 (21.12.2006), paragraph [0216] & US 2009/0023991 A1	7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
06 November, 2009 (06.11.09)Date of mailing of the international search report
17 November, 2009 (17.11.09)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/067863

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 4-197331 A (Fuji Photo Optical Co., Ltd.), 16 July 1992 (16.07.1992), page 3, upper left column to lower left column (Family: none)	1-9
A	JP 6-245899 A (Olympus Optical Co., Ltd.), 06 September 1994 (06.09.1994), entire text; all drawings (Family: none)	1-9

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2009/067863	
A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. A61B1/04(2006.01)i, A61B1/00(2006.01)i, G06T1/00(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. A61B1/04, A61B1/00, G06T1/00			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2009年 日本国実用新案登録公報 1996-2009年 日本国登録実用新案公報 1994-2009年			
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
X Y A	JP 2001-212073 A（富士写真フイルム株式会社）2001.08.07, 【0076】－【0078】（ファミリーなし）	1,6 7-8 2-5,9	
X Y A	JP 2003-79568 A（富士写真フイルム株式会社）2003.03.18, 【0057】, 【0064】－【0067】, 【0080】－【0087】 & US 2003/0001104 A1	1,6 7-8 2-5,9	
Y	JP 2006-341078 A（オリンパスメディカルシステムズ株式会社）2006.12.21, 【0216】 & US 2009/0023991 A1	7	
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 06.11.2009		国際調査報告の発送日 17.11.2009	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/JP） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官（権限のある職員） 谷垣 圭二	2Q 3808 電話番号 03-3581-1101 内線 3292

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 6 7 8 6 3
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 4-197331 A (富士写真光機株式会社) 1992. 07. 16, 第 3 頁左上欄 — 左下欄 (ファミリーなし)	1-9
A	JP 6-245899 A (オリンパス光学工業株式会社) 1994. 09. 06, 全文、 全図 (ファミリーなし)	1-9

フロントページの続き

(51) Int. Cl. F I テーマコード (参考)
H 0 4 N 5/225 (2006.01) H 0 4 N 5/225 C

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

F ターム (参考) 4C061 AA00 BB00 CC06 DD10 JJ19 NN01 NN03 NN05 QQ06 UU06
 WW05 WW09
 4C161 AA00 BB00 CC06 DD10 JJ19 NN01 NN03 NN05 QQ06 UU06
 WW05 WW09
 5B057 BA02 CA01 CA08 CA12 CA16 CB01 CB08 CB12 CB16 CE11
 CE17 CE18
 5C122 DA26 EA47 FH01 FH02 FH22 FK23 FK24 HB01 HB06


(注) この公表は、国際事務局 (W I P O) により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願 (日本語実用新案登録出願) の国際公開の効果は、特許法第 1 8 4 条の 1 0 第 1 項 (実用新案法第 4 8 条の 1 3 第 2 項) により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	图像生成装置，内窥镜系统和图像生成方法		
公开(公告)号	JPWO2010044446A1	公开(公告)日	2012-03-15
申请号	JP2010515306	申请日	2009-10-15
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	薬袋哲夫 田村和昭 森健		
发明人	薬袋 哲夫 田村 和昭 森 健		
IPC分类号	A61B1/04 A61B1/00 A61B5/07 G06T1/00 G06T5/00 H04N5/225		
CPC分类号	A61B1/0646 A61B1/00009 A61B1/041 A61B1/0638 A61B5/0075 A61B5/0084 G06T7/00 G06T7/90 G06T11/001 G06T2207/10068 G06T2207/30028 G06T2207/30092		
FI分类号	A61B1/04.370 A61B1/00.320.B A61B5/07 G06T1/00.290.Z G06T5/00.100 H04N5/225.C		
F-TERM分类号	4C038/CC03 4C038/CC09 4C061/AA00 4C061/BB00 4C061/CC06 4C061/DD10 4C061/JJ19 4C061/NN01 4C061/NN03 4C061/NN05 4C061/QQ06 4C061/UU06 4C061/WW05 4C061/WW09 4C161/AA00 4C161/BB00 4C161/CC06 4C161/DD10 4C161/JJ19 4C161/NN01 4C161/NN03 4C161/NN05 4C161/QQ06 4C161/UU06 4C161/WW05 4C161/WW09 5B057/BA02 5B057/CA01 5B057/CA08 5B057/CA12 5B057/CA16 5B057/CB01 5B057/CB08 5B057/CB12 5B057/CB16 5B057/CE11 5B057/CE17 5B057/CE18 5C122/DA26 5C122/EA47 5C122/FH01 5C122/FH02 5C122/FH22 5C122/FK23 5C122/FK24 5C122/HB01 5C122/HB06		
代理人(译)	酒井宏明		
优先权	2008268896 2008-10-17 JP		
其他公开文献	JP4589464B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

内窥镜系统包括：普通图像生成电路（21），该普通图像生成电路（21）基于RGB数据生成普通图像，该普通图像是白色图像，该RGB数据是获取的多个色彩元素信息。色调计算电路（22），其计算RGB数据的色调。黄色成分检测电路（23），基于计算出的色相检测黄色成分。黄色成分消除电路（24）；光谱图像生成电路（25）。黄色成分消除电路（24）通过从G数据中消除由黄色成分检测电路（23）检测出的黄色成分，生成消除了黄色的G数据（GY）。光谱图像生成电路（25）基于黄色消除的G数据（GY）和B数据，生成作为血管图像的光谱图像。

【図4】

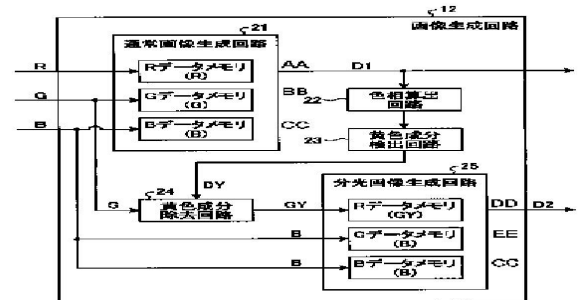

- 12 IMAGE GENERATING CIRCUIT
- 21 NORMAL IMAGE GENERATING CIRCUIT
- AA R DATA MEMORY (R)
- BB G DATA MEMORY (G)
- CC B DATA MEMORY (B)
- 24 YELLOW COMPONENT REMOVING CIRCUIT
- 22 HUE CALCULATING CIRCUIT
- 23 YELLOW COMPONENT DETECTION CIRCUIT
- 25 SPECTRAL IMAGE GENERATING CIRCUIT
- DD R DATA MEMORY (GY)
- FF G DATA MEMORY (R)