

(19)日本国特許庁（J P）

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2001－340290

(P2001－340290A)

(43)公開日 平成13年12月11日(2001.12.11)

(51)Int.Cl ⁷	識別記号	F I	テーマコード [*] (参考)
A 6 1 B 1/04	362	A 6 1 B 1/04	362 J 2 H 0 4 0
	372		372 4 C 0 6 1
G 0 2 B 23/24		G 0 2 B 23/24	B 5 C 0 2 4
H 0 4 N 5/335		H 0 4 N 5/335	Z
			F
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 10数)			

(21)出願番号 特願2000－165563(P2000－165563)

(22)出願日 平成12年6月2日(2000.6.2)

(71)出願人 000000527

旭光学工業株式会社

東京都板橋区前野町2丁目36番9号

(72)発明者 高見 敏

東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光学
工業株式会社内

(74)代理人 100090169

弁理士 松浦 孝

Fターム(参考) 2H040 GA00 GA02 GA05

4C061 CC06 JJ18 LL01 MM02 NN01
SS05 UU09 YY14

5C024 BX02 CX06 DX01 GY01 HX09


HX13 HX15 HX32 HX52 HX59

(54)【発明の名称】 電子内視鏡の映像信号サンプルパルス生成装置

(57)【要約】

【課題】 挿入部の長さが異なる電子内視鏡において常に適正なタイミングでサンプリングを行うサンプルパルスを生成する。

【解決手段】 シフトカウンタ20にクロック31からのクロックパルスを入力し0～9の値の範囲において循環的に繰り返し計数する。各係数値0～9に対応する端子にスイッチA0～A9、B0～B9を備えるスイッチ群A、Bをそれぞれ接続する。EEPROM30のデータに基づいてスイッチ群A、Bのスイッチのオン・オフを設定する。スイッチ群Aに接続された信号線をCDS回路26のクランプパルス入力端子に接続し、スイッチ群Bに接続された信号線をCDS回路26のサンプルホールド入力端子に接続する。0～4、5～9の端子の出力を水平レジスタ転送クロックH10、H20に用い、0の端子の出力をリセットゲートクロックRGOとして用いる。シフトカウンタの各計数値に対応した端子のみに計数値に合わせて信号を出力する。

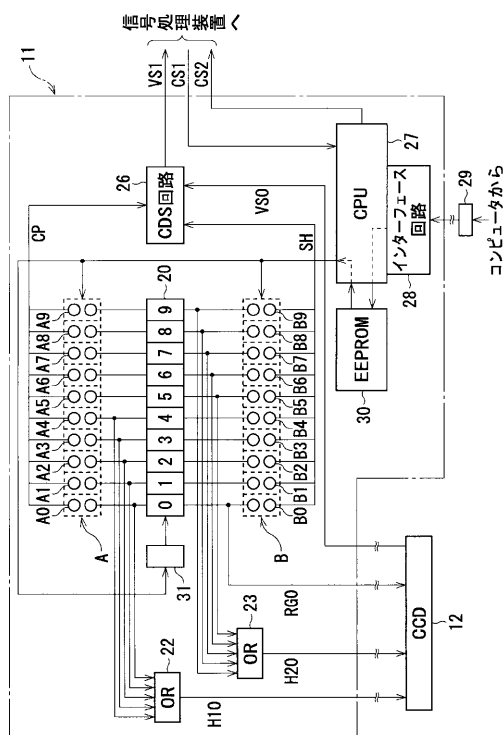

【特許請求の範囲】

【請求項1】 撮像素子と、

前記撮像素子において得られる映像信号をサンプリングするためのサンプリング回路と、

前記撮像素子を駆動するための撮像素子駆動パルス生成する撮像素子駆動パルス生成手段と、

周期的なクロックパルスを発生するクロックと、

所定の数の出力端子を備え、前記クロックパルスが発生する毎にそのパルス数を計数し、前記計数が前記所定の

数の範囲で循環的に繰り返し行われ、前記計数における各計数値と前記出力端子とが1対1に対応し、前記計数値に対応する前記出力端子のみに信号を出力するシフト

カウンタと、
前記出力端子の各々に接続されたスイッチからなる第1のスイッチ群と、

前記出力端子の各々に接続されたスイッチからなる第2のスイッチ群と、

前記第1及び第2のスイッチ群の各スイッチのオン・オフ設定を記録する記録媒体と、

前記記録媒体に記憶された設定内容に基づいて前記第1及び第2のスイッチ群の各スイッチのオン・オフ設定を行うスイッチ設定手段と、

前記記録媒体に記録される前記各スイッチの設定内容の設定または変更を行うオン・オフ設定記録手段とを備え、

前記撮像素子駆動パルス生成手段が、前記シフトカウンタの所定の出力端子から出力される信号に基づいて前記撮像素子駆動パルスを生成し、前記サンプリング回路のサンプリングを制御する少なくとも2つのサンプルパルスが、前記スイッチ設定手段によるオン状態に設定された前記第1及び第2のスイッチ群それぞれからの出力に基づくものであることを特徴とする電子内視鏡の映像信号サンプルパルス生成装置。

【請求項2】 前記サンプリング回路が相関二重サンプリング回路であり、

前記サンプルパルスがクランプパルス及びサンプルホールドパルスであり、前記クランプパルス及び前記サンプルホールドパルスの一方が前記第1のスイッチ群から出力され、他方が前記第2のスイッチ群から出力されることを特徴とした請求項1に記載のサンプルパルス生成装置。

【請求項3】 前記記録媒体が、EEPROMであることを特徴とする請求項1に記載のサンプルパルス生成装置。

【請求項4】 前記オン・オフ設定記録手段が、前記電子内視鏡の外部に設けられたコンピュータからの信号に基づいて駆動されることを特徴とする請求項1に記載のサンプルパルス生成装置。

【請求項5】 前記撮像素子駆動パルスが前記出力端子の1つから出力される信号、または複数の出力端子から

出力される信号の論理和であり、前記撮像素子駆動パルスが複数の出力端子から出力される信号の論理和であるとき、前記出力端子が前記計数の循環において連続する計数値に対応することを特徴とする請求項1に記載のサンプルパルス生成装置。

【請求項6】 前記撮像素子がCCD撮像素子であり、前記撮像素子駆動パルスの1つがCCD水平レジスタ転送クロックであり、前記CCD水平レジスタ転送クロックが前記所定の数の半分の数の出力端子から出力される信号の論理和であり、前記出力端子が前記計数の循環において連続する計数値に対応することを特徴とする請求項1に記載のサンプルパルス生成装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電子内視鏡に設けられ、映像信号のサンプリングのタイミングを調整する回路に関する。

【0002】

【従来の技術】近年医療分野では、電子内視鏡（電子スコープ）を用いた診療が広く行われている。電子内視鏡は、映像信号の処理などを行う信号処理装置（プロセッサ）やTVモニタなどの画像表示装置とともに用いられる。電子内視鏡は信号処理装置に装着され、電子内視鏡の先端において撮像された映像は、信号処理装置を介して画像表示装置に伝送され表示される。電子内視鏡の種類は多様であり、目的に応じ様々なものが使用される。しかし、電子内視鏡毎に個別に信号処理装置を設けることは無駄が多いため、信号処理の方法が同じ電子内視鏡では、信号処理装置が共有される。

【0003】撮像素子（CCD:charge coupled device）は電子内視鏡の挿入部の先端に設けられるが、挿入部の先端は小型であることが望ましい。したがって、CCDの制御信号を出力するCCD駆動回路やCCDからの映像信号をサンプルホールドするための相関二重サンプリング（CDS:correlated double sampling）回路は、電子内視鏡の外部装置である信号処理装置に設けられていた。制御信号がCCD駆動回路から出力され、その制御信号に基づく映像信号がCDS回路に到達するまでの伝搬遅延時間は、電子内視鏡の挿入部の長さに相関する。電子内視鏡の挿入部の長さは、1メートル未満のものから数メートルのものまでであるため、このときの伝搬遅延時間は映像信号の処理にとって無視できない大きさとなる。信号処理装置を共有する電子内視鏡であっても、電子内視鏡の挿入部の長さは目的に応じて様々であるため、挿入部の長さが異なるとCCDからの映像信号をCDS回路においてサンプルホールドするタイミングが異なり、適正なサンプリングを行えない。したがって、従来信号処理装置には、長さの異なる電子内視鏡それぞれに対応した遅延線が設けられていた。しかし、長さの異なる多くの電子内視鏡において信号処理装置を共

有するには、信号処理装置に多数の遅延線を備える必要があるほか、装着された電子内視鏡に応じて遅延線の切り換えを行う必要があるため、その構成や処理が煩雑になるという問題があった。

【0004】この問題に対して、特許第2790948号には、相関二重サンプリング回路と相関二重サンプリング回路へ供給するクランプパルス、サンプルパルスの位相を変えることができる回路とを電子内視鏡の操作部または信号処理装置との接続部に設けた電子内視鏡装置が開示されている。特許第2790948号に開示された電子内視鏡装置において、クランプパルスおよびサン
10 プルパルスの位相はポテンショメータ（可変抵抗）を用いたRC回路の時定数を調節することによりアナログ的に調整される。しかし、ポテンショメータを用いる構成は回路の小型化に適さないという問題があるほか、アナログ回路は互いに近接して設ける必要があるため、ポテンショメータ、CCD駆動回路、CDS回路等は一体的に近接して配置される必要がある。また、位相調整が簡便に行なえるためには、ポテンショメータを簡単に操作
20 できる位置に設け、その保護カバー等も容易に着脱できる構成にする必要がある。しかし、このような配置・構成は、頻繁に洗浄される電子内視鏡においては、ポテンショメータ、CCD駆動回路、CDS回路等の防水の点から問題がある。さらに、上述した回路の小型化の困難性、ポテンショメータの配置、カバー等の構成の問題は、電子内視鏡の操作部等の小型化、形状を制限し、操作性が重要である操作部の設計には大きな障害となる。また更に、ポテンショメータを用いた位相調整には、ポ
30 テンショメータの摘みを操作する必要があり調節操作は煩雑である。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、小型であり、回路配置の自由度が高く、位相調整が容易な電子内視鏡の映像信号サンプルパルス生成装置を得ることを目的としている。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明の電子内視鏡の映像信号サンプルパルス生成装置は、撮像素子と、撮像素子において得られる映像信号をサンプリングするためのサンプリング回路と、撮像素子を駆動するための撮像素子駆動パルスを生成する撮像素子駆動パルス生成手段と、周期的なクロックパルスを発生するクロックと、所定の数の出力端子を備えクロックパルスが発生する毎にそのパルス数を計数し、計数が出力端子の数の範囲で循環的に繰り返し行われ、計数における各計数値と出力端子とが1対1に対応し、計数値に対応する出力端子のみに信号を出力するシフトカウンタと、出力端子の各々に接続されたスイッチからなる第1のスイッチ群と、出力端子の各々に接続されたスイッチからなる第2のスイッチ群と、第1及び第2のスイッチ群の各スイッチのオン
50

・オフ設定を記録する記録媒体と、記録媒体に記憶された設定内容に基づいて第1及び第2のスイッチ群の各スイッチのオン・オフ設定を行うスイッチ設定手段と、記録媒体に記録される各スイッチの設定内容の設定または変更を行うオン・オフ設定記録手段とを備え、撮像素子駆動パルス生成手段が、シフトカウンタの所定の出力端子から出力される信号に基づいて撮像素子駆動パルスを生成し、サンプリング回路のサンプリングを制御する少なくとも2つのサンプルパルスが、スイッチ設定手段によるオン状態に設定された第1及び第2のスイッチ群それぞれからの出力に基づくものであることを特徴としている。

【0007】例えばサンプリング回路は、相関二重サンプリング回路であり、サンプルパルスがクランプパルス及びサンプルホールドパルスであり、クランプパルス及びサンプルホールドパルスの一方が第1のスイッチ群から出力され、他方が第2のスイッチ群から出力される。また例えば記録媒体は、EEPROMである。

【0008】オン・オフ設定記録手段は好ましくは、電子内視鏡の外部に設けられたコンピュータからの信号に基づいて駆動される。これにより、オン・オフ設定記録手段のためのスペースを節約することができる。

【0009】例えば、撮像素子駆動パルスは、出力端子の1つから出力される信号、または複数の出力端子から出力される信号の論理和であり、撮像素子駆動パルスが複数の出力端子から出力される信号の論理和であるとき、出力端子は計数の循環において連続する計数値に対応する。また、例えば撮像素子はCCD撮像素子であり、撮像素子駆動パルスの1つはCCD水平レジスタ転送クロックであり、CCD水平レジスタ転送クロックは、出力端子の数の半分の数の出力端子から出力される信号の論理和であり、これらの出力端子は計数の循環において連続する計数値に対応する。

【0010】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図1は本発明の実施形態である電子内視鏡を備えた電子内視鏡システムの構成を概略的に示すブロック図である。

【0011】電子内視鏡10は、信号処理装置13に着脱自在に接続されており、信号処理装置13はTVモニタ15に接続されている。電子内視鏡10の操作部にはCCD駆動制御回路11が設けられ、挿入部の先端にはCCD（撮像素子）12が設けられている。また、信号処理装置13には、プロセス処理回路14が設けられている。CCD12は、CCD駆動制御回路11から出力されるCCD駆動パルス（CCD水平レジスタ転送クロック、リセットゲートクロック等）に基づいて動作し、例えば、従来公知の面順次撮像方式により映像の検出が行われる。CCD12で検出された信号は、CCD駆動制御回路11内のCDS回路（図2参照）においてサン

プリングされ、信号処理装置13のプロセス処理回路14へ映像信号VS1として送られる。

【0012】プロセス処理回路14では電子内視鏡10から出力された映像信号VS1の処理が行われる。すなわち映像信号VS1は、適度に増幅された後、映像帯域のフィルタリング処理、S/H処理、増幅処理、クランプ処理、クリップ処理、ガンマ処理等の前段信号処理が施され、デジタルの画像信号に変換される。デジタルの画像信号はRGB毎に一時的に画像メモリ（図示せず）に記憶され、RGBの画像信号が1組揃うと再びアナログ信号に変換されて後段信号処理が行われる。後段信号処理では、フィルタリング処理、増幅処理、ガンマ処理、クランプ処理、クリップ処理、エンハンス処理、レベル調整等が行われ、例えばコンポジット映像信号など、規格化されたテレビジョン信号（TV信号）に変換されTVモニタ15へ出力される。

【0013】電子内視鏡10と信号処理装置13との間では、映像信号VS1のほかに信号CS1、CS2の送受信が行われる。信号CS1は、プロセス処理回路14から電子内視鏡10に出力される信号であり、CCDの駆動タイミングやカラーバランスの設定を行うためのデータなどである。一方、信号CS2は、CCD駆動制御回路11から信号処理装置13へ出力される信号であり、例えば、電子内視鏡の種類や電子内視鏡が信号処理装置13へ装着されたか否かを知らせるための装着信号などである。

【0014】また、工場出荷時やメンテナンスを行うときなど、CCD駆動パルスとCDS制御パルス（クランプパルス、サンプルホールドパルス）の出力タイミング、すなわち、CCD駆動パルスとCDS制御パルスとの相対的な位相を調整する際には、コンピュータ16が電子内視鏡10のCCD駆動制御回路11に接続される。このとき、電子内視鏡の伝搬遅延時間は、例えばCCD駆動パルスが出力されるCCD駆動制御回路11の出力端子aと検出された映像信号を入力するための入力端子bに、オシロスコープ（図示せず）を接続し、端子a、bにおいて検出される信号波形から算出される。オペレータは、オシロスコープを用いて算出された伝搬遅延時間をキーボード17から入力することにより、CCD駆動パルスとCDS制御パルスの位相を調整することができる。

【0015】次に図2を参照して本実施形態のCCD駆動制御回路11について説明する。図2は、図1におけるCCD駆動制御回路11の概略的な回路構成を示したブロック図である。

【0016】CCD駆動制御回路11は、シフトカウンタ20、OR回路22、23、スイッチ群A、B、CDS回路26、CPU27、インターフェース回路28、EEPROM(electrically erasable programmable read only memory)30、及びクロック31から構成され

る。

【0017】CCD12において検出された映像信号VS0は、CDS回路26においてサンプルホールドされ、映像信号VS1として信号処理装置13（図1参照）に出力される。CDS回路26は、CDS制御パルスであるクランプパルスCP及びサンプルホールドパルスSHにより制御される。クランプパルスCPは、10個のスイッチA0～A9からなるスイッチ群Aの中の1つのスイッチから出力され、サンプルホールドパルスSHは、10個のスイッチB0～B9からなるスイッチ群Bの中の1つのスイッチから出力される。

【0018】スイッチ群A、Bの各スイッチA0～A9、B0～B9は、それぞれシフトカウンタ20に接続されている。シフトカウンタ20に付された0～9までの番号は、シフトカウンタ20において計数されるカウント値に対応しており、シフトカウンタ20の機能を模式的に表わしている。シフトカウンタ20は、クロック31から出力される規則的なパルス信号（クロックパルス）の数を0から9までカウントし、現在のカウント値に対応する端子にパルス信号を出力する。カウント値が9に達するとまた0からのカウントを開始し、この循環的計数動作を繰り返す。

【0019】スイッチA0～A9及びスイッチB0～B9は、それぞれシフトカウンタ20のカウント値0～9に対応する端子に接続されている。したがって、シフトカウンタ20は、現在のカウント値に対応するスイッチにパルス信号を出力する。例えば、現在シフトカウンタ20においてカウント値が0であれば、カウント値0に対応するスイッチA0及びスイッチB0にパルス信号が出力される。その後カウント値が1になると、カウント値1に対応するスイッチA1及びスイッチB1にパルス信号が出力され、スイッチA0とスイッチB0に対するパルス信号の出力は終了する。以下同様にスイッチ群A、BのスイッチA2、B2～スイッチA9、B9に順次対毎にパルス信号が出力され、このパルス信号の出力動作は循環的に繰り返される。

【0020】クランプパルスCPは、スイッチ群Aの中でオン状態に設定されたスイッチを介してシフトカウンタ20から出力される。また、サンプルホールドパルスSHは、スイッチ群Bの中でオン状態に設定されたスイッチを介してシフトカウンタ20から出力される。スイッチ群A及びスイッチ群Bにおけるスイッチのオン・オフの設定は、EEPROM30に記録されたデータに基づいてCPU27により行われる。前述したように、このデータは電子内視鏡10にコンピュータ16（図1参照）を接続することにより、キーボード17を用いてオペレータが設定することができる。すなわち、CPU27は、コネクタ29に接続されるインターフェースケーブルによりコンピュータ16と接続でき、インターフェース回路28を介してコンピュータ16と通信できる。

CPU27はコンピュータ16からの指令に従ってEEPROM30の内容を設定・変更することができる。

【0021】OR回路22は、シフトカウンタ20のカウント値0～4に対応する4つの端子に接続されており、これらの端子から出力されるパルス信号に対して論理和をとり、CCDにおける水平転送の駆動を制御する水平レジスタ転送クロックH10としてCCD12へ出力する。すなわち、水平レジスタ転送クロックH10は、シフトカウンタ20のカウント値が0～4の期間は10 ハイレベルで、カウント値が5～9の期間はローレベルの周期的なパルス信号となる。また、OR回路23は、シフトカウンタ20のカウント値が5～9に対応する4つの端子に接続されており、これらの端子から出力されるパルス信号に対して論理和をとり、水平レジスタ転送クロックH20としてCCD12へ出力する。すなわち、水平レジスタ転送クロックH20は、水平レジスタ転送クロックH10の反転パルスであり、シフトカウンタ20のカウント値が0～4の期間はローレベルで、カウント値が5～9の期間はハイレベルの周期的なパルス信号である。また、シフトカウンタ20のカウント値020 に対応する端子は、CCD12のリセットゲートクロックを入力するため端子に接続されており、カウント値0のときシフトカウンタ20から出力されるパルス信号は、リセットゲートクロックRG0としてCCD12へ出力される。

【0022】なお、クロック31はCPU27に接続されており、CPU27からの信号指令に基づいて制御される。また、CPU27と信号処理装置13のプロセス処理回路14（図1参照）とはコネクタ（図示せず）を介して接続されており、信号CS1と信号CS2の送受30 信が行なわれる。

【0023】次に図2、図3、図4を参照して本実施形態においてCCD駆動パルス及びCDS制御パルスを出力するためのパルス信号出力動作について説明する。

【0024】図3（a）、（b）は、OR回路22、23から出力されるCCD水平レジスタ転送クロックH10、H20をそれぞれ示しており、図3（c）は、リセットゲートクロックRG0が出力されるタイミングを示している。また、図3（d）は、上記CCD水平レジスタ転送クロックH10、H20、及びリセットゲートク40 ロックRG0が遅延無くCCDへ入力されたときにCCDから出力される映像信号VSを示している。期間Trは、リセットゲートクロックRG0のパルス幅に対応するリセット期間であり、期間Tfはリセット期間に確定したリセット雑音のみが出力されるフィードスルー期間である。また、期間Tsはリセット雑音とCCDの各画素で検出される画像（映像）信号が重畳して出力される映像信号出力期間である。

【0025】シフトカウンタ20の繰り返し周期（0から9までカウントする期間）は、水平レジスタ転送クロ50

ックH10、H20の周期、すなわち映像信号のピクセルクロック期間Tp（例えば、69.8ns）に相当する。したがって、シフトカウンタ20の1カウントはTp/10であり、カウント値が0の期間出力されるリセットゲートクロックRG0のパルス幅（リセット期間Tr）は、Tp/10となる。

【0026】図3（e）は、電子内視鏡挿入部における伝搬遅延時間を考慮したときのCDS回路26に入力される映像信号VS0を示しており、図3（d）に示された遅延を考慮しない映像信号VSよりも伝搬遅延時間Td分遅れている。すなわち、図3（e）に示された映像信号VS0は、CCD駆動制御回路11から出力されたCCD駆動パルス（図3（a）～（c）のパルス）がCCD12に到達し、CCD12から出力される映像信号がCDS回路26に達するまでの時間遅延されている。なお、図3（d）に示された1周期分の映像信号S0は、図3（e）に示された1周期分の映像信号S1に対応する。伝搬遅延時間Tdは、挿入部の長さが例えば2m強（信号線は往復で4m強）のとき約14nsである。ピクセルクロック期間Tpが69.8nsであるとする、14nsはシフトカウンタ20の2カウント（14/69.8×10⁻²）の期間に相当する。

【0027】図4は、図3（d）に示された映像信号VS（遅延がないときの映像信号）とシフトカウンタ20のカウント値との関係を1周期分示したものである。図4において、例えば、シフトカウンタ20のカウント値が4のとき（リセット期間Trの開始からTc期間経過後）に信号をクランプし、カウンタ値が9のとき（リセット期間Trの開始からTs期間経過後）にサンプルホールドするのが、サンプリングのタイミングとして好適である場合、同様のタイミングで図3（e）に示された映像信号VS0（Td時間遅延された映像信号）に対してクランプ及びサンプルホールドを行おうとすれば、クランプパルスCP及びサンプルホールドパルスSHの出力タイミングを伝搬遅延時間Tdだけ遅らせなければならない。上述のように伝搬遅延時間Tdがシフトカウンタ20の2カウント分の期間に対応する場合、各信号の好適な出力タイミングは2カウント分遅れるので、クランプパルスCPの出力タイミングはカウント値が6のとき、サンプルホールドパルスSHの出力タイミングはカウント値が1のとき好適となる。すなわち、スイッチ群AではスイッチA6がオン状態に設定され、スイッチ群BではスイッチSB1がオン状態に設定される。

【0028】図3（f）、図3（g）には、図3（e）の映像信号VS0に対するクランプパルスCP、及びサンプルホールドパルスSHの出力タイミングが示されている。すなわち、信号S2、S3は、図3（e）の信号S1に対するクランプパルス信号、及びサンプルホールド信号である。ここで、期間t1はTd+Tcであり7カウント分（カウント値0～6）の期間に対応してい

る。また、期間 t_2 は $T_d + T_s$ であり12カウント分（カウント値0～9及び次の周期の0～1）の期間に対応している。なお、パルス信号 S_4 は1周期前の映像信号に対するサンプルホールドパルス信号となる。

【0029】以上の説明は、伝搬遅延時間 T_d がピクセルクロック期間 T_p よりも短い場合のパルス信号出力動作についてであるが、伝搬遅延時間がピクセルクロック期間 T_p よりも長い場合のパルス信号出力動作についても同様に行うことができる。次に、図5を参照して伝搬遅延時間がピクセルクロック期間 T_p よりも長い場合の

10
パルス信号出力動作について説明する。
【0030】図5は伝搬遅延時間 T_d' が、ピクセルクロック期間 T_p よりも δT_d （ $\delta T_d < T_p$ ）長いとき、すなわち $T_d' = T_p + \delta T_d$ のときにCDS回路26に入力される映像信号 V_0 と、この映像信号をサンプリングするためのCDS制御パルスを表している。映像信号 S_1' はリセットゲートクロック RG_0 及び伝搬遅延時間 T_d' だけ遅れた映像信号であり、パルス信号 S_2' 、 S_3' は、それぞれ映像信号 S_1' に対するクランプパルス CP 及びサンプルホールドパルス SH である。パルス信号 S_2' は t_1' 時間遅れて出力され、パルス信号 S_3' は t_2' 時間遅れて出力される。ここで、 $t_1' = T_d' + T_c$ であり、 $t_2' = T_d' + T_s$ であるので、 $t_1' = T_p + \delta T_d + T_c$ 、 $t_2' = T_p + \delta T_d + T_s$ となる。クランプパルス CP 及びサンプルホールドパルス SH は周期 T_p の周期的なパルス信号なので、期間 t_1' 、 t_2' 遅延されたクランプパルス CP 及びサンプルホールドパルス SH は、 $\delta T_d + T_c$ 、 $\delta T_d + T_s$ 遅延されたパルス信号にそれぞれ等しい。したがって、伝搬遅延時間 T_d' がピクセルクロック期間 T_p よりも δT_d 時間長いときには、 δT_d （ $< T_p$ ）を伝搬遅延時間として、これに対応するスイッチをオン状態に設定すればよい。すなわち、 δT_d が2カウントに対応するときには、スイッチ A_6 とスイッチ B_1 をオン状態に設定すれば良い。このとき、パルス信号 S_5' 、 S_4' は映像信号 S_1' の1つ前の周期の映像信号に対するクランプパルス及びサンプルホールドパルスとなり、パルス信号 S_6' は2周期前の映像信号に対するサンプルホールドパルスとなる。なお、伝搬遅延時間が2周期（ $2T_p$ ）よりも長いときも同様である。

40
【0031】以上のように、本実施形態によれば、シフトカウンタを用いて1ピクセルクロック期間を10等分することにより、任意の伝搬遅延時間を有する電子内視鏡に対応したCCD駆動パルス及びCDS制御パルスを出力できるCCD駆動制御回路を得られる。なお、本実施形態のシフトカウンタ20は、1ピクセルクロック期間 T_p を10等分していたので、設定できる遅延時間の精度は $\pm T_p / 20$ （ $T_p / 10$ の $1/2$ ）である。しかし、1ピクセルクロック期間のカウント値を増やすこ

とによりピクセルクロック期間 T_p の分割数を増やせば、その精度を向上させることができる。すなわち、1ピクセルクロック期間 T_p を n 等分するシフトカウンタを用いれば、その精度を $\pm T_p / (2 \times n)$ にすることができる。なお、各パルス信号のパルス幅は、オン状態に設定されるスイッチの数で調整することができる。

【0032】次に、図6及び図7を参照して本実施形態における位相調整動作について説明する。図6は、電子内視鏡10のCPU27（図2参照）において実行されるプログラムのフローチャートであり、図7は位相調整を行う際、コンピュータ16（図1参照）において実行されるプログラムのフローチャートである。

【0033】電子内視鏡10のCPU27では、まずステップ100において、コンピュータ（パソコン）16からの信号入力の有無が判定される。コンピュータ16からの信号入力があると判定されると、処理はステップ101に移り、CPU27はコンピュータ16との通信を開始し、位相調整に必要なデータをコンピュータ16から取得しEEPROM30に記録する。データは例えば、スイッチ群A、Bにおいてオン状態に設定されるべきスイッチを指定するためのスイッチ設定データなどである。ステップ101の処理が終了すると処理はステップ102へ移る。

【0034】一方、ステップ100においてコンピュータ16からの入力信号がないと判定されると、処理は直接ステップ102に移る。ステップ102では、EEPROM30から位相調整に必要なデータが読み出される。すなわち、スイッチ群A、Bの中で何れのスイッチをオン状態に設定すればよいかを示すデータが読み出される。その後、ステップ103、104では、ステップ102においてEEPROM30から読み出されたデータに基づいてスイッチ群A、Bのオン・オフがそれぞれ設定される。

【0035】ステップ105では、クロック31からクロックパルスが出力され、シフトカウンタ20へ入力される。ステップ106では、垂直ブランキング期間であるか否かが判定される。垂直ブランキング期間でなければ、処理はステップ105に戻り、再びクロックパルスが出力される。すなわち、垂直ブランキング期間でない間、クロック31からはクロックパルスが周期的にシフトカウンタ20へ出力され、前述した方法でCCD駆動パルス及びCDS制御パルスが繰り返し出力される。

【0036】ステップ106において垂直ブランキング期間であると判定されると、処理はステップ107に移り、信号処理装置13から信号CS1が出力されたか否かが判定される。ステップ107において、信号CS1の出力が有ると判定されると、ステップ108においてCPUは信号処理装置13からの信号CS1を取得し、その信号の種類に応じて各種の処理を行う。例えば、取得した信号CS1はカラーバランスの設定を行うための

データであれば、そのデータをEEPROM30に記録する。その後ステップ109において、CPU27からプロセス処理回路へ信号CS2が出力され、ステップ120においてコンピュータ16からの信号入力の有無が再び判定される。コンピュータ16からの信号入力が無いと判定されると処理はステップ105に戻り以下同様の処理が行われる。また、ステップ120においてコンピュータ16からの信号入力有りだと判定されると、処理はステップ101へ戻りコンピュータ16との通信が開始され以下同様の処理が行われる。

【0037】一方、ステップ107において、信号処理装置13から信号CS1が出力されていないと判定されると、処理は直ちにステップ120へ移り先に説明した処理と同様の処理が行われる。なお、図6のフローチャートから明らかなように、ステップ108、109など信号CS1、CS2に関わる処理は、垂直ブランキング期間に行われる。

【0038】次に図7に示されたコンピュータ16において実行されるプログラムのフローチャートについて説明する。

【0039】ステップ200において、キーボード17から例えば伝搬遅延時間の入力があると処理はステップ201へ進む。すなわち、コンピュータ16は、オペレータがオシロスコープを用いて検出された電子内視鏡の伝搬遅延時間をキーボード17から入力するまでステップ200で待機する。ステップ201では、入力された伝搬遅延時間に基づいて、スイッチ群A、Bのオン・オフを設定するためのスイッチ設定データが生成される。スイッチ設定データはステップ202においてインターフェース回路28を介して電子内視鏡10のCPU27へ送信される。すなわち、電子内視鏡10のCPU27の処理では、ステップ101に対応し、送信されたデータはEEPROM30に記録される。ステップ203では、ステップ202におけるデータ送信の結果や、その内容がコンピュータの画面に表示される。その後処理は再びステップ200へ戻り次のキーボード入力があるまで待機する。

【0040】以上のように、本実施形態によれば、シフトカウンタとこれに接続されたスイッチ群のオン・オフの設定のみで任意の位相をもつクランプパルスと、サン

調整する必要がない。更に、本実施形態によれば、インターフェースケーブルを接続するコネクタ部のみ位相調整時に電子内視鏡の外部に露出できればよく、ポテンシオメータを用いるアナログ回路に比べ、そのカバー部への設置の自由度が高い。すなわち、ポテンシオメータを用いたアナログ回路では、機械的な構成が複雑なポテンシオメータとCCD駆動回路やCDS回路などを距離を隔てて配置することはできないが、本実施形態の構成によれば、コネクタ部は他の回路から隔てて設けても何ら問題がないので、自由な配置・設計が可能である。また、これにより、防水上の設計も容易となる。

【0041】

【発明の効果】以上により本発明によれば、小型であり、回路配置の自由度が高く、位相調整が容易な映像信号のサンプルパルス生成装置を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態である電子内視鏡システムの回路構成を示すブロック図である。

【図2】図1に示されたブロック図におけるCCD駆動制御回路の回路構成を示すブロック図である。

【図3】CCD駆動パルス、映像信号およびサンプルパルスのタイミングチャートである。

【図4】映像信号とシフトカウンタの計数値との対応を示す図である。

【図5】伝搬遅延時間が1ピクセルクロック期間を超えるとときの映像信号とサンプルパルスのタイミングチャートである。


【図6】電子内視鏡内のCPUで実行されるプログラムのフローチャートである。

【図7】コンピュータで実行されるプログラムのフローチャートである。


【符号の説明】

- 10 電子内視鏡
- 12 CCD
- 20 シフトカウンタ
- 22、23 OR回路
- 26 CDS回路
- 27 CPU
- 28 インターフェース回路
- 29 コネクタ
- 30 EEPROM
- 31 クロック
- A スwitch群A
- B スwitch群B
- A0～A9 スイッチ
- B0～B9 スイッチ


【図1】

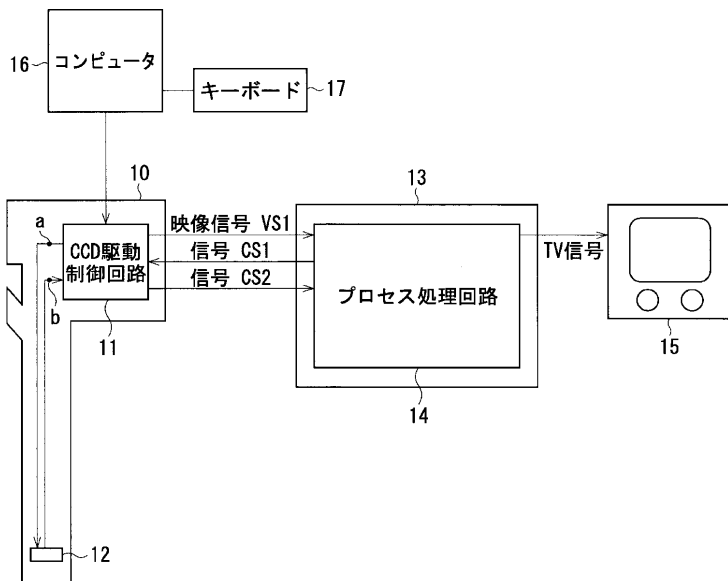


【図4】

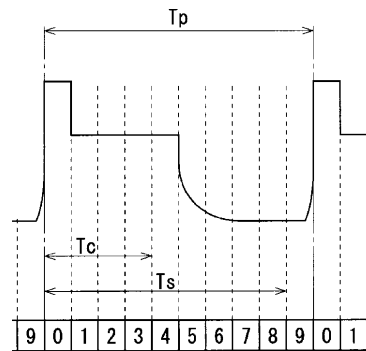


【図7】

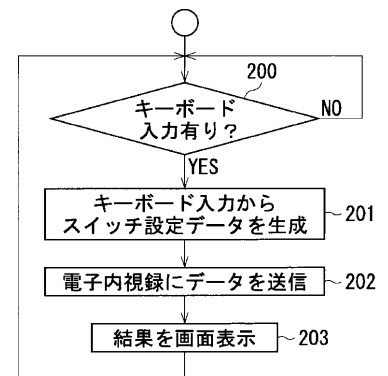


【図2】

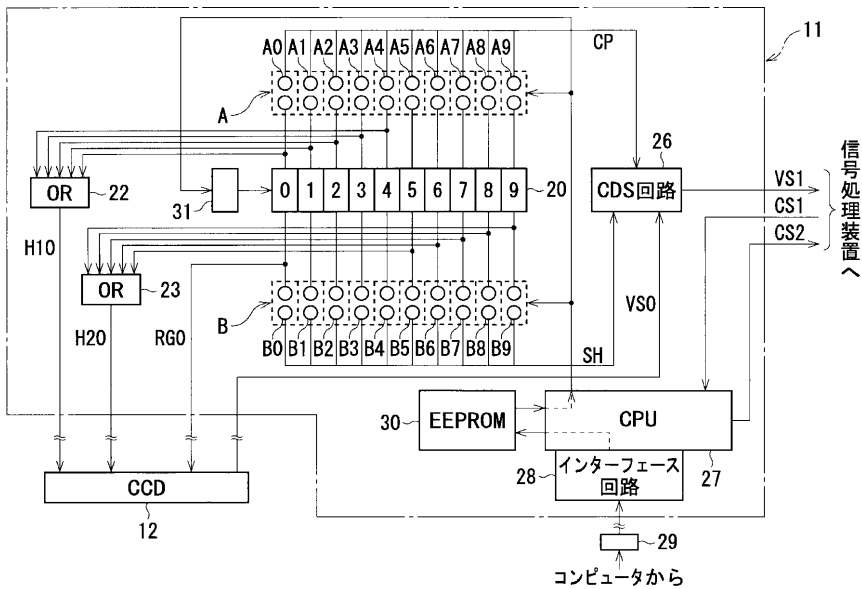


【図3】

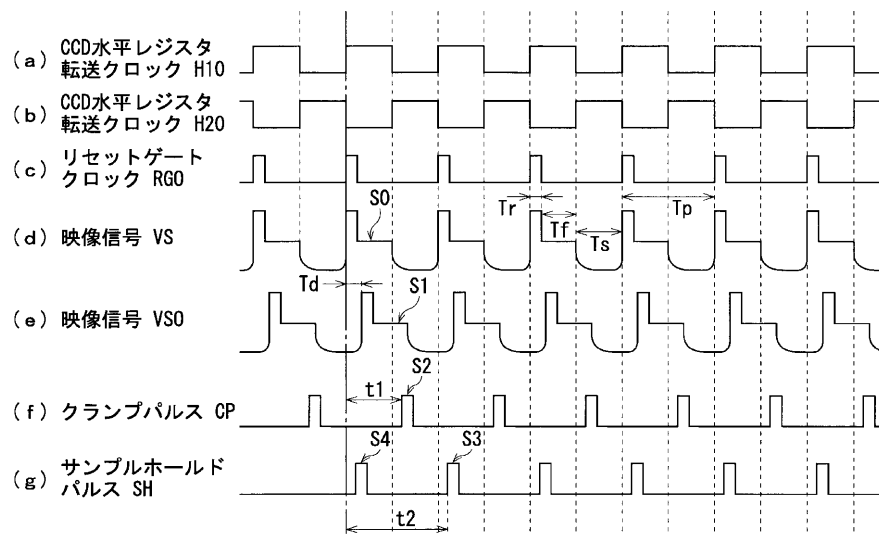

【図5】

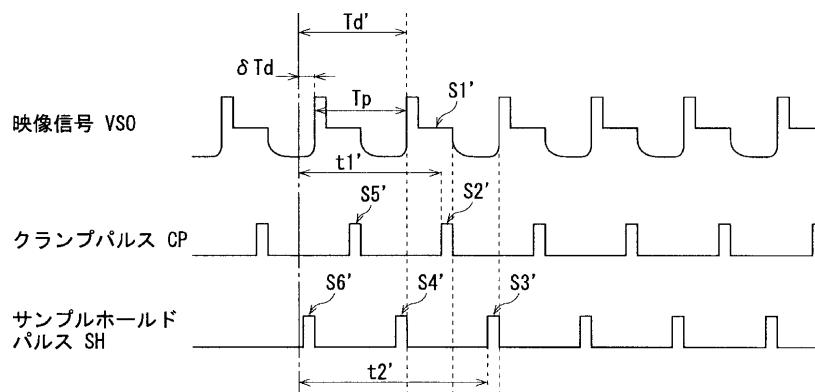

【図6】

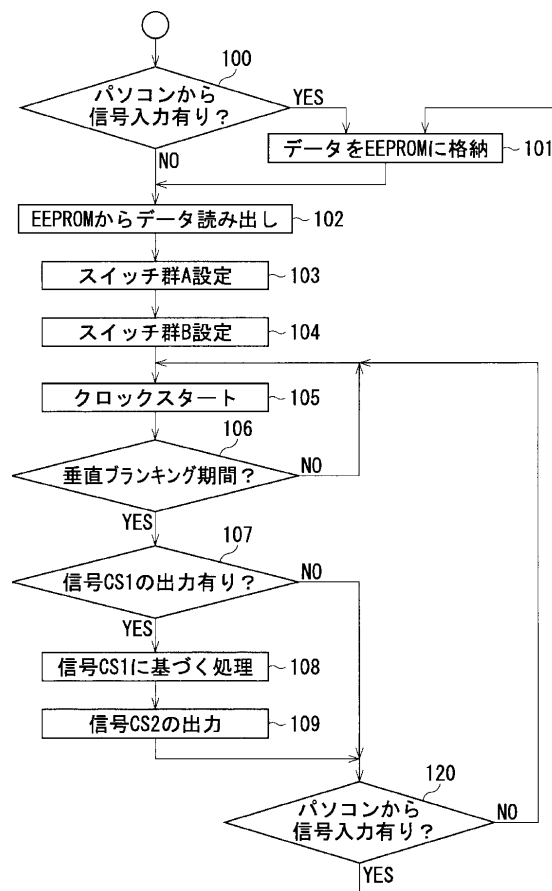

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2001340290A5	公开(公告)日	2005-06-16
申请号	JP2000165563	申请日	2000-06-02
[标]申请(专利权)人(译)	旭光学工业株式会社		
申请(专利权)人(译)	旭光学工业株式会社		
[标]发明人	高見敏		
发明人	高見 敏		
IPC分类号	G02B23/24 A61B1/04 H04N5/335 H04N5/357 H04N5/363 H04N5/372 H04N5/378		
FI分类号	A61B1/04.362.J A61B1/04.372 G02B23/24.B H04N5/335.Z H04N5/335.F		
F-TERM分类号	2H040/GA00 2H040/GA02 2H040/GA05 4C061/CC06 4C061/JJ18 4C061/LL01 4C061/MM02 4C061/NN01 4C061/SS05 4C061/UU09 4C061/YY14 5C024/BX02 5C024/CX06 5C024/DX01 5C024/GY01 5C024/HX09 5C024/HX13 5C024/HX15 5C024/HX32 5C024/HX52 5C024/HX59 4C161/CC06 4C161/JJ18 4C161/LL01 4C161/MM02 4C161/NN01 4C161/SS05 4C161/UU09 4C161/YY14		
代理人(译)	松浦 孝		
其他公开文献	JP4010744B2 JP2001340290A		

摘要(译)

解决的问题：产生采样脉冲，该采样脉冲总是在具有不同长度的插入部分的电子内窥镜中以适当的定时执行采样。来自时钟31的时钟脉冲输入到移位计数器20，并且在0-9的值范围内被循环地重复计数。包括开关A0至A9和B0至B9的开关组A和B连接到与各个系数值0至9相对应的端子。基于EEPROM 30的数据来设置开关组A和B的开关的接通/断开。连接到开关组A的信号线连接到CDS电路26的钳位脉冲输入端子，并且连接到开关组B的信号线连接到CDS电路26的采样保持输入端子。端子0至4和5至9的输出用作水平寄存器传输时钟H10和H20，端子0的输出用作复位门时钟RGO。根据计数值的信号仅输出到与移位计数器的每个计数值相对应的端子。