

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02010/055938

発行日 平成24年4月12日 (2012. 4. 12)

(43) 国際公開日 平成22年5月20日 (2010. 5. 20)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
<b>A 6 1 B 1/00 (2006.01)</b>	A 6 1 B 1/00 3 2 0 B	4 C 0 6 1
	A 6 1 B 1/00 3 0 0 D	4 C 1 6 1

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 42 頁)

出願番号	特願2010-537825 (P2010-537825)	(71) 出願人	000000376 オリンパス株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
(21) 国際出願番号	PCT/JP2009/069435	(74) 代理人	100089118 弁理士 酒井 宏明
(22) 国際出願日	平成21年11月16日 (2009.11.16)	(72) 発明者	田村 和昭 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパス株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願2008-293834 (P2008-293834)	(72) 発明者	森 健 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパス株式会社内
(32) 優先日	平成20年11月17日 (2008.11.17)	(72) 発明者	内山 昭夫 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像処理システム、その撮像装置、受信装置および画像表示装置

(57) 【要約】

画像処理システム100は、少なくとも二つ以上の観察モードを有し、いずれか一方の観察モードで画像を生成する画像生成手段101と、画像生成手段101が一方の観察モードで生成した画像の明るさを検出する明るさ検出手段106と、明るさ検出手段106で検出された画像の明るさに基づいて画像生成手段101による他方の観察モードでの画像の生成を制御する制御手段107と、を備える。

【図6】

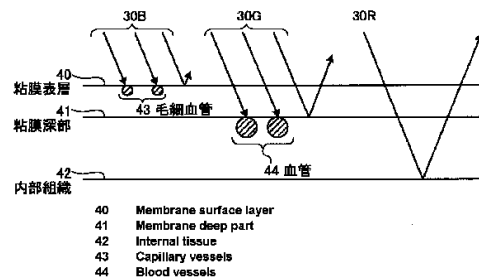

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

少なくとも二つ以上の観察モードを有し、いずれか一方の観察モードで画像を生成する画像生成手段と、

前記画像生成手段が一方の観察モードで生成した画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、

前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記画像生成手段による他方の観察モードでの画像の生成を制御する制御手段と、

を備えたことを特徴とする画像処理システム。

**【請求項 2】**

前記画像生成手段は、前記一方の観察モードと前記他方の観察モードとを交互に又は連続して画像を生成することを特徴とする請求項 1 記載の画像処理システム。

**【請求項 3】**

前記画像生成手段は、

被写体を繰り返し撮像する撮像手段と、

前記撮像手段による撮像に併せて前記被写体を照明する照明手段と、

前記撮像手段により取得された画像に所定の処理を実行する画像処理手段と、

を含み、

前記制御手段は、前記明るさ検出手段によって検出された画像の明るさに基づいて、前記照明手段、前記撮像手段および前記画像処理手段の少なくとも一つを制御することを特徴とする請求項 1 に記載の画像処理システム。

**【請求項 4】**

前記制御手段は、前回の撮像により得られた画像の明るさに基づいて次の撮像における前記撮像手段の露光時間を制御することを特徴とする請求項 3 に記載の画像処理システム。

**【請求項 5】**

前記制御手段は、前回の撮像により得られた画像の明るさに基づいて次の撮像における前記照明手段の発光時間を制御することを特徴とする請求項 3 に記載の画像処理システム。

**【請求項 6】**

前記所定の処理は、前記画像の同時化処理、圧縮処理、保存処理、動き検出処理、赤色検出処理、および、当該画像と種類が異なる画像の生成処理の少なくとも一つを含み、

前記制御手段は、前記撮像手段が取得した画像の明るさに基づいて前記画像処理手段による当該画像に対する前記所定の処理を制御することを特徴とする請求項 3 に記載の画像処理システム。

**【請求項 7】**

前記画像生成手段は、前記異なる種類の画像として通常光画像と特殊光画像とを生成することを特徴とする請求項 1 に記載の画像処理システム。

**【請求項 8】**

前記照明手段は、前記被写体を通常光で照明する通常光光源と、前記被写体を特殊光で照明する特殊光光源と、を含み、

前記画像生成手段は、前記被写体を前記通常光光源で照明した際に前記撮像手段が取得した画像を前記通常光画像として生成し、前記被写体を前記特殊光光源で照明した際に前記撮像手段が取得した画像を前記特殊光画像として生成することを特徴とする請求項 7 に記載の画像処理システム。

**【請求項 9】**

前記画像生成手段は、

前記照明手段と前記撮像手段とを含み、被検体内に導入されて該被検体内の前記被写体を前記撮像手段が撮像して得られた画像を無線信号にて送信する撮像装置と、

前記撮像装置が無線信号にて送信した前記画像を受信し、該画像を所定の記録領域に記

10

20

30

40

50

録する受信装置と、

前記受信装置に記録された画像を該受信装置から取得して表示する画像表示装置と、  
を含み、

前記画像処理手段は、前記撮像装置と前記受信装置と前記画像表示装置とのいずれか1つ以上に設けられたことを特徴とする請求項3に記載の画像処理システム。

【請求項10】

前記撮像手段は、前記被写体を観察する第1の観察モードによる撮像動作および前記第1の観察モードとは異なる第2の観察モードによる撮像動作とを同一観察モードの複数回繰り返しを含めて交互に行い、

前記制御手段は、

前記第1の観察モード時における露光時間を測定する露光時間測定部と、

前記露光時間測定部の測定結果をもとに前記第2の観察モードの撮像動作を制御する観察モード制御部と、

を含むことを特徴とする請求項1に記載の画像処理システム。

10

【請求項11】

前記撮像手段は、

前記第1の観察モードに用いる光を照射する第1の光源部と、

前記第1の観察モードとは異なる第2の観察モードに用いる光を照射する第2の光源部と、

を含み、

前記露光時間測定部は、前記第1の光源部によって照射される光の露光時間を前記第1の観察モード時の露光時間として測定することを特徴とする請求項10に記載の画像処理システム。

20

【請求項12】

前記観察モード制御部は、前記露光時間測定部の測定結果をもとに少なくとも前記第2の光源部の動作を制御することによって前記第2の観察モードの撮像動作を制御することを特徴とする請求項10に記載の画像処理システム。

【請求項13】

前記観察モード制御部は、前記第1の観察モード時における露光時間が前回まで複数回連続して所定値を超える場合、次の前記第2の観察モードによる撮像動作を停止させ、該第2の観察モードに替えて前記第1の観察モードによる撮像動作を行わせ、複数回連続して所定値を超えない場合、次の前記第2の観察モードによる撮像動作を行わせることを特徴とする請求項10に記載の画像処理システム。

30

【請求項14】

前記第1の光源部は、前記撮像手段の光軸方向に対して狭い指向性をもった狭指向性光源と広い指向性をもった広指向性光源とを有し、

前記観察モード制御部は、前記第1の観察モード時における露光時間が前回まで複数回連続して所定値を超える場合、前記広指向性光源のみから光を照射させて次の前記第2の観察モードによる撮像動作を行わせ、複数回連続して所定値を超えない場合、前記広指向性光源および前記狭指向性光源から光を照射させて次の前記第2の観察モードによる撮像動作を行わせることを特徴とする請求項11に記載の画像処理システム。

40

【請求項15】

少なくとも前記撮像手段および前記照明手段が液中内か否かを検出する状態検出手段を備え、

前記観察モード制御部は、前記第1の観察モード時における露光時間が前回まで複数回連続して所定値を超える場合であって前記状態検出手段が液中であると検出した場合には、前記広指向性光源のみから光を照射させて次の前記第2の観察モードによる撮像動作を行わせ、前記第1の観察モード時における露光時間が前回まで複数回連続して所定値を超える場合であって前記状態検出手段が液中でないと検出した場合には、次の前記第2の観察モードによる撮像動作を停止させ、該第2の観察モードに替えて前記第1の観察モード

50

による撮像動作を行わせることを特徴とする請求項 1 4 に記載の画像処理システム。

【請求項 1 6】

前記第 1 の観察モードは、白色光源を用いて前記被写体を撮像し、

前記第 2 の観察モードは、特定の色成分の分光光を照射する狭帯域光源を用いて前記被写体を撮像することを特徴とする請求項 1 0 に記載の画像処理システム。

【請求項 1 7】

前記狭帯域光源は、青色および緑色を特定の色成分とする分光光を照射することを特徴とする請求項 1 6 に記載の画像処理システム。

【請求項 1 8】

前記撮像装置は、前記被検体内に導入されるカプセル型内視鏡であることを特徴とする請求項 3 に記載の画像処理システム。 10

【請求項 1 9】

少なくとも二つ以上の観察モードを有し、被検体内に導入されていずれか一方の観察モードで画像を生成する画像生成手段と、

前記画像生成手段が一方の観察モードで生成した画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、

前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記画像生成手段による他方の観察モードでの画像の生成を制御する制御手段と、

前記画像生成手段が生成した画像を送信する送信手段と、

を備えたことを特徴とする撮像装置。 20

【請求項 2 0】

異なる種類の画像を受信する画像受信手段と、

前記画像受信手段で受信された前記画像を所定の記録領域に記録する記録手段と、

前記画像受信手段で受信された前記画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、

前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記記録手段による当該画像の記録の可否を制御する制御手段と、

を備えたことを特徴とする受信装置。

【請求項 2 1】

画像に対して所定の画像処理を実行する画像処理手段と、

前記画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、 30

前記明るさ検出手段が検出した前記画像の明るさに基づいて前記画像処理手段による当該画像に対する前記所定の画像処理を制御する制御手段と、

前記画像および / または前記画像処理手段によって前記所定の画像処理がなされた画像を表示する表示手段と、

を備えたことを特徴とする画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この発明は、画像処理システム、その撮像装置、受信装置および画像表示装置に関し、特に、白色画像などの通常画像と特定の色成分よりなる分光画像との生成を適切に行う画像処理システム、その撮像装置、受信装置および画像表示装置に関する。 40

【背景技術】

【0002】

近年、内視鏡分野においては、撮像機能と無線通信機能とを設けたカプセル型の被検体内導入装置（例えばカプセル型内視鏡）が提案され、このカプセル型内視鏡を用いて被検体内の画像を取得する被検体内導入システムが開発されている。カプセル型内視鏡は、被検体内を観察（検査）するために、例えば被検体の口から飲込まれ、その後、自然排出されるまでの間、体腔内たとえば胃、小腸等の臓器の内部をその蠕動運動に従って移動するとともに、例えば 0.5 秒間隔で被検体内の画像を撮像するように機能する。

【0003】

カプセル型内視鏡が被検体内を移動する間、このカプセル型内視鏡によって撮像された画像は、被検体の体表面に配置したアンテナを介して外部の画像表示装置に受信される。この画像表示装置は、カプセル型内視鏡に対する無線通信機能と画像のメモリ機能とを有し、被検体内のカプセル型内視鏡から受信した画像をメモリに順次格納する。医師または看護師は、かかる画像表示装置に蓄積された画像、すなわち被検体の消化管内の画像をディスプレイに表示することによって、被検体内を観察（検査）し、診断することができる。

【0004】

ここで、特許文献1には、複数の個別の光源と複数の個別の光センサとを配置し、光源動作時に被写体に反射した光を、光センサで感知した光量で、光源の動作や利得を制御する生体内撮像装置が記載されている。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2006-247404号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

ところで、カプセル型内視鏡などを撮像装置として用いた画像生成システムでは、撮像により取得される画像の明るさが一定であるとは限らない。そのため、画像データ自体の生成や生成された画像データに対する画像処理を安定して行うことが困難であるという問題が存在した。

20

【0007】

そこで本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、画像データ自体の生成や生成された画像データに対する画像処理を安定して行うことが可能な画像処理システム、その撮像装置、受信装置および画像表示装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上述した課題を解決し、目的を達成するために、この発明にかかる画像処理システムは、少なくとも二つ以上の観察モードを有し、いずれか一方の観察モードで画像を生成する画像生成手段と、前記画像生成手段が一方の観察モードで生成した画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記画像生成手段による他方の観察モードでの画像の生成を制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。

30

【0009】

上記した本発明による画像処理システムは、前記画像生成手段が、前記一方の観察モードと前記他方の観察モードとを交互に又は連続して画像を生成することを特徴とする。

【0010】

上記した本発明による画像処理システムは、前記画像生成手段が、被写体を繰り返し撮像する撮像手段と、前記撮像手段による撮像に併せて前記被写体を照明する照明手段と、前記撮像手段により取得された画像に所定の処理を実行する画像処理手段と、を含み、前記制御手段が、前記明るさ検出手段によって検出された画像の明るさに基づいて、前記照明手段、前記撮像手段および前記画像処理手段の少なくとも一つを制御することを特徴とする。

40

【0011】

上記した本発明による画像処理システムは、前記制御手段が、前回の撮像により得られた画像の明るさに基づいて次の撮像における前記撮像手段の露光時間を制御することを特徴とする。

【0012】

上記した本発明による画像処理システムは、前記制御手段が、前回の撮像により得られ

50

た画像の明るさに基づいて次の撮像における前記照明手段の発光時間を制御することを特徴とする。

【0013】

上記した本発明による画像処理システムは、前記所定の処理が、前記画像の同時化処理、圧縮処理、保存処理、動き検出処理、赤色検出処理、および、当該画像と種類が異なる画像の生成処理の少なくとも1つを含み、前記制御手段が、前記撮像手段が取得した画像の明るさに基づいて前記画像処理手段による当該画像に対する前記所定の処理を制御することを特徴とする。

【0014】

上記した本発明による画像処理システムは、前記画像生成手段が、前記異なる種類の画像として通常光画像と特殊光画像とを生成することを特徴とする。

10

【0015】

上記した本発明による画像処理システムは、前記照明手段が、前記被写体を通常光で照明する通常光光源と、前記被写体を特殊光で照明する特殊光光源と、を含み、前記画像生成手段が、前記被写体を前記通常光光源で照明した際に前記撮像手段が取得した画像を前記通常光画像として生成し、前記被写体を前記特殊光光源で照明した際に前記撮像手段が取得した画像を前記特殊光画像として生成することを特徴とする。

【0016】

上記した本発明による画像処理システムは、前記画像生成手段が、前記照明手段と前記撮像手段とを含み、被検体内に導入されて該被検体内の前記被写体を前記撮像手段が撮像して得られた画像を無線信号にて送信する撮像装置と、前記撮像装置が無線信号にて送信した前記画像を受信し、該画像を所定の記録領域に記録する受信装置と、前記受信装置に記録された画像を該受信装置から取得して表示する画像表示装置と、を含み、前記画像処理手段が、前記撮像装置と前記受信装置と前記画像表示装置とのいずれか1つ以上に設けられたことを特徴とする。

20

【0017】

上記した本発明による画像処理システムは、前記撮像手段が、前記被写体を観察する第1の観察モードによる撮像動作および前記第1の観察モードとは異なる第2の観察モードによる撮像動作とを同一観察モードの複数回繰り返しを含めて交互に行い、前記制御手段が、前記第1の観察モード時における露光時間を測定する露光時間測定部と、前記露光時間測定部の測定結果をもとに前記第2の観察モードの撮像動作を制御する観察モード制御部と、を含むことを特徴とする。

30

【0018】

上記した本発明による画像処理システムは、前記撮像手段が、前記第1の観察モードに用いる光を照射する第1の光源部と、前記第1の観察モードとは異なる第2の観察モードに用いる光を照射する第2の光源部と、を含み、前記露光時間測定部が、前記第1の光源部によって照射される光の露光時間を前記第1の観察モード時の露光時間として測定することを特徴とする。

【0019】

上記した本発明による画像処理システムは、前記観察モード制御部が、前記露光時間測定部の測定結果をもとに少なくとも前記第2の光源部の動作を制御することによって前記第2の観察モードの撮像動作を制御することを特徴とする。

40

【0020】

上記した本発明による画像処理システムは、前記観察モード制御部が、前記第1の観察モード時における露光時間が前回まで複数回連続して所定値を超える場合、次の前記第2の観察モードによる撮像動作を停止させ、該第2の観察モードに替えて前記第1の観察モードによる撮像動作を行わせ、複数回連続して所定値を超えない場合、次の前記第2の観察モードによる撮像動作を行わせることを特徴とする。

【0021】

上記した本発明による画像処理システムは、前記第1の光源部が、前記撮像手段の光軸

50

方向に対して狭い指向性をもった狭指向性光源と広い指向性をもった広指向性光源とを有し、前記観察モード制御部が、前記第1の観察モード時における露光時間が前回まで複数回連続して所定値を超える場合、前記広指向性光源のみから光を照射させて次の前記第2の観察モードによる撮像動作を行わせ、複数回連続して所定値を超えない場合、前記広指向性光源および前記狭指向性光源から光を照射させて次の前記第2の観察モードによる撮像動作を行わせることを特徴とする。

【0022】

上記した本発明による画像処理システムは、少なくとも前記撮像手段および前記照明手段が液中内か否かを検出する状態検出手段を備え、前記観察モード制御部が、前記第1の観察モード時における露光時間が前回まで複数回連続して所定値を超える場合であって前記状態検出手段が液中であると検出した場合には、前記広指向性光源のみから光を照射させて次の前記第2の観察モードによる撮像動作を行わせ、前記第1の観察モード時における露光時間が前回まで複数回連続して所定値を超える場合であって前記状態検出手段が液中でないと検出した場合には、次の前記第2の観察モードによる撮像動作を停止させ、該第2の観察モードに替えて前記第1の観察モードによる撮像動作を行わせることを特徴とする。

10

【0023】

上記した本発明による画像処理システムは、前記第1の観察モードが、白色光源を用いて前記被写体を撮像し、前記第2の観察モードが、特定の色成分の分光光を照射する狭帯域光源を用いて前記被写体を撮像することを特徴とする。

20

【0024】

上記した本発明による画像処理システムは、前記狭帯域光源が、青色および緑色を特定の色成分とする分光光を照射することを特徴とする。

【0025】

上記した本発明による画像処理システムは、前記撮像装置が、前記被検体内に導入されるカプセル型内視鏡であることを特徴とする。

【0026】

また、本発明による撮像装置は、少なくとも二つ以上の観察モードを有し、被検体内に導入されていずれか一方の観察モードで画像を生成する画像生成手段と、前記画像生成手段が一方の観察モードで生成した画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記画像生成手段による他方の観察モードでの画像の生成を制御する制御手段と、前記画像生成手段が生成した画像を送信する送信手段と、を備えたことを特徴とする。

30

【0027】

また、本発明による受信装置は、異なる種類の画像を受信する画像受信手段と、前記画像受信手段で受信された前記画像を所定の記録領域に記録する記録手段と、前記画像受信手段で受信された前記画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記記録手段による当該画像の記録の可否を制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。

【0028】

また、本発明による画像表示装置は、画像に対して所定の画像処理を実行する画像処理手段と、前記画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、前記明るさ検出手段が検出した前記画像の明るさに基づいて前記画像処理手段による当該画像に対する前記所定の画像処理を制御する制御手段と、前記画像および/または前記画像処理手段によって前記所定の画像処理がなされた画像を表示する表示手段と、を備えたことを特徴とする。

40

【発明の効果】

【0029】

この発明によれば、画像の明るさ情報に応じて制御を適切に行うことが可能となるため、画像データ自体の生成や生成された画像データに対する画像処理を安定して行うことが可能な画像処理システム、その撮像装置、受信装置および画像表示装置を実現することが

50

できる。

【図面の簡単な説明】

【0030】

【図1】図1は、この実施の形態による画像処理システムの概略構成を示すブロック図である。

【図2】図2は、この発明の実施の形態2によるカプセル型内視鏡システムの全体概要構成を示す図である。

【図3】図3は、この発明の実施の形態2によるカプセル型内視鏡の撮像部および照明部近傍の平面図である。

【図4】図4は、この発明の実施の形態2によるカプセル型内視鏡の撮像部および照明部近傍の断面図である。

【図5】図5は、血液の吸光特性レベルの波長依存性を示す図である。

【図6】図6は、体腔内壁と血管に対する光の進入と反射との関係を示す模式図である。

【図7】図7は、この発明の実施の形態2によるカプセル型内視鏡の構成を示すブロック図である。

【図8】図8は、この発明の実施の形態2によるカプセル型内視鏡内の観察モード制御部による観察モード制御処理手順を示すフローチャートである。

【図9】図9は、この発明の実施の形態2によるカプセル型内視鏡内の観察モード制御部による観察モード制御処理の一例を示すタイミングチャートである。

【図10】図10は、この発明の実施の形態3によるカプセル型内視鏡の撮像部および照明部近傍の平面図である。

【図11】図11は、この発明の実施の形態3によるカプセル型内視鏡の撮像部および照明部近傍の断面図である。

【図12】図12は、この発明の実施の形態3によるカプセル型内視鏡内の観察モード制御部による観察モード制御処理手順を示すフローチャートである。

【図13】図13は、この発明の実施の形態4によるカプセル型内視鏡内の観察モード制御部による観察モード制御処理手順を示すフローチャートである。

【図14】図14は、この発明の実施の形態5によるカプセル型内視鏡内の観察モード制御部による観察モード制御処理手順を示すフローチャートである。

【図15】図15は、この発明の実施の形態6によるカプセル型内視鏡の構成を示すブロック図である。

【図16】図16は、図15に示した発光量調整部による発光量調整処理手順を示すフローチャートである。

【図17】図17は、この発明の実施の形態7によるカプセル型内視鏡の発光量調整部による発光量調整処理手順を示すフローチャートである。

【図18】図18は、この発明の実施の形態8による受信装置の構成を示すブロック図である。

【図19】図19は、図18に示した明るさ調整部による明るさ調整処理手順を示すフローチャートである。

【図20】図20は、この発明の実施の形態9によるカプセル型内視鏡の構成を示すブロック図である。

【図21】図21は、この発明の実施の形態9によるカプセル型内視鏡の概略動作を示すフローチャートである。

【図22】図22は、この発明の実施の形態9による受信装置3の概略動作を示すフローチャートである。

【図23】図23は、この発明の実施の形態10による画像表示装置4の概略動作を示すフローチャートである。

【図24】図24は、この発明の実施の形態10において画像表示装置が実行する画像処理機能の一例（動き検出機能）の概略動作を示すフローチャートである。

【図25】図25は、この発明の実施の形態10において画像表示装置が実行する画像処

10

20

30

40

50

理機能の他の一例（赤色検出機能）の概略動作を示すフローチャートである。

【図26】図26は、この発明の実施の形態11によるカプセル型内視鏡の構成を示すブロック図である。

【図27】図27は、この発明の実施の形態11によるカプセル型内視鏡の概略動作を示すフローチャートである。

【図28】図28は、この発明の実施の形態11による受信装置の概略動作を示すフローチャートである。

【図29】図29は、この発明の実施の形態11による画像表示装置の概略動作を示すフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0031】

以下、図面を参照して、この発明にかかる画像処理システム、その撮像装置、受信装置および画像表示装置の好適な実施の形態を詳細に説明する。なお、以下に示す全ての実施の形態は、その構成の全部または一部を適宜組合せることが可能である。

【0032】

（実施の形態1）

まず、この発明の実施の形態1によるカプセル内視鏡システムを説明するにあたり、カプセル型内視鏡システムの構築概念となる画像処理システムの構成を、図面を用いて詳細に説明する。図1は、この実施の形態による画像処理システムの概略構成を示すブロック図である。図1に示すように、この実施の形態による画像処理システム100は、大別して、画像生成手段101と表示手段102と明るさ検出手段106と制御手段107と、を備える。画像生成手段101は、異なる種類の画像、たとえば色成分の組合せよりなる画像（例えば後述する通常光画像と特殊光画像）を交互または連続して生成する少なくとも二つ以上の観察モードを有し、いずれか一方の観察モードを選択してその観察モード下で画像を生成する手段である。この画像生成手段101は、被写体を撮像する撮像手段103と、撮像時に被写体を照明する照明手段104と、撮像により得られた画像データに所定の画像処理を実行する画像処理手段105と、を備える。明るさ検出手段106は、撮像手段104が一方の観察モードでの撮像により得られた画像の明るさを示す情報（以下、単に明るさ情報という）を検出する。制御手段107は、明るさ検出手段106によって検出された明るさ情報に基づいて画像生成手段101の撮像手段103、照明手段104および画像処理手段105の少なくとも一つを制御することで、画像生成手段101による他方の観察モードでの画像の生成を制御する。

【0033】

この実施の形態における明るさ情報には、たとえば撮像手段103が撮像する際の露光時間や、撮像手段103によって取得された画像の平均輝度や、撮像手段103によって取得された画像の所定領域に含まれる画素の信号強度の積分値（露光量ともいう）など、画像の明るさを示すあらゆる情報を明るさ情報として利用することが可能である。

【0034】

制御手段107は、明るさ検出手段106において検出された明るさ情報に基づいて、例えば、照明手段104の発光量（パワー）や発光時間を決定したり、駆動する光源の種類を選択したりなどの制御を行う。また、制御手段107は、同じく検出された明るさ情報に基づいて、撮像手段103による露光時間を決定したり、画像信号を読み出す画素の種類（R、G、Bのいずれか1つ以上）の選択をしたりなどの制御を行う。さらに、制御手段107は、同じく検出された明るさ情報に基づいて、画像処理手段105による画像処理における種々のパラメータを変更したり、実行する画像処理機能を選択したりする制御を行う。

【0035】

このように本実施の形態では、取得された画像の明るさ情報に基づいて画像生成手段101における撮像手段103や照明手段104や画像処理手段105を制御して画像の明るさに応じた適切な制御を行うため、画像データ自体の生成や生成された画像データに対

10

20

30

40

50

する処理を安定して行うことが可能となる。

【0036】

(実施の形態2)

つぎに、この発明の実施の形態2による画像処理システムとして、撮像装置にカプセル型内視鏡を用いたカプセル型内視鏡システムを例に挙げて説明する。なお、この実施の形態によるカプセル型内視鏡システムは、上述した実施の形態1による画像処理システムをより具体化したものであり、その概念は当該画像処理システムの概念に含まれるものである。

【0037】

図2は、この発明の実施の形態2にかかるカプセル型内視鏡システムの構成を示す模式図である。図2に示すように、この実施の形態2にかかるカプセル型内視鏡システムは、被検体1の体内画像を撮像する撮像装置としてのカプセル型内視鏡2と、カプセル型内視鏡2によって無線送信された画像信号を受信する受信装置3と、カプセル型内視鏡2によって撮像された体内画像を表示する画像表示装置4と、受信装置3と画像表示装置4との間におけるデータの受け渡しを行うための可搬型の記録媒体5とを備える。

10

【0038】

カプセル型内視鏡2は、カプセル型の筐体内部に撮像機能と無線通信機能とを備える。カプセル型内視鏡2は、経口挿入等によって被検体1の臓器内部に導入され、その後、蠕動運動等によって被検体1の臓器内部を移動しつつ、所定の間隔(例えば0.5秒間隔)で被検体1の体内画像を順次撮像する。具体的には、カプセル型内視鏡2は、白色光を用いた通常画像の撮像(通常光観察)と、体腔内壁の鮮明な血管画像などを、青色および緑色の特定の色成分からなる特殊光を用いて生成する分光画像を撮像(特殊光観察)とを、それぞれ複数回繰り返しを含めて交互に行う。カプセル型内視鏡2は、このように撮像した被検体1の体内画像の画像信号を外部の受信装置3に無線送信する。カプセル型内視鏡2は、被検体1の臓器内部に導入されてから被検体1の外部に排出されるまでの期間、かかる体内画像の撮像動作および無線送信動作を順次繰り返す。

20

【0039】

受信装置3は、例えば被検体1の体表上に分散配置される複数の受信アンテナ3a~3hを備え、複数の受信アンテナ3a~3hのうちの一つを介して被検体1内部のカプセル型内視鏡2からの無線信号を受信する。受信装置3は、カプセル型内視鏡2からの無線信号から画像信号を抽出し、この抽出した画像信号に含まれる体内画像の画像データを取得する。

30

【0040】

また、受信装置3は、取得した画像データに対して各種の画像処理を行い、予め挿着された記録媒体5に、この画像処理された体内画像群を蓄積する。また、受信装置3は、体内画像群の各画像に、撮像時刻または受信時刻等の時間データを各々対応付ける。

【0041】

なお、受信装置3の受信アンテナ3a~3hは、図2に示したように被検体1の体表上に配置してもよいし、被検体1に着用させるジャケットに配置されてもよい。また、受信装置3の受信アンテナ数は、1以上であればよく、特に8つに限定されない。

40

【0042】

画像表示装置4は、記録媒体5を介して被検体1の体内画像群等の各種データを取り込み、取り込んだ体内画像群等の各種データを表示するワークステーションのような構成を有する。具体的には、画像表示装置4は、受信装置3から取り外された記録媒体5を挿着され、この記録媒体5の保存データを取り込むことによって、被検体1の体内画像群等の各種データを取得する。画像表示装置4は、取得した体内画像をディスプレイに表示する機能を有する。この画像表示装置4による画像表示によって診断等が行われる。

【0043】

記録媒体5は、上述した受信装置3と画像表示装置4との間におけるデータの受け渡しを行うための可搬型の記録メディアである。記録媒体5は、受信装置3および画像表示装

50

置 4 に対して着脱可能であって、両者に対する挿着時にデータの出力および記録が可能な構造を有する。具体的には、記録媒体 5 は、受信装置 3 に挿着された場合、受信装置 3 によって画像処理された体内画像群および各画像の時間データ等を記録する。

#### 【 0 0 4 4 】

カプセル型内視鏡 2 は、カプセル型筐体 2 1 内に各種機能が内蔵され、一端部がドーム型透明カバー 2 0 に覆われ、この一端部側に照明部および撮像部が配置される。図 3 および図 4 に示すように、円板状の基板 2 3 の円中央部に鏡筒 2 4 が設けられ、この鏡筒 2 4 内にカプセル型筐体 2 1 の円筒軸が光軸となる光学レンズ 1 3 および撮像素子 1 4 が設けられる。基板 2 3 の周縁側には、白色光を発光する白色 LED で実現される通常光光源 1 0 a ~ 1 0 c ( 1 0 ) と、4 1 5 n m ( 青色 ) 付近にピークをもつ波長帯の光と 5 4 0 n m ( 緑色 ) 付近にピークをもつ波長帯の光とを発光する特殊光光源 1 1 a ~ 1 1 c ( 1 1 ) とが交互に異なる位置に円環状に配置される。なお、特殊光光源 1 1 は、4 1 5 n m を発光する LED チップに 5 4 0 n m を発光する蛍光体を塗布した 2 波長発光タイプとして

10

#### 【 0 0 4 5 】

ここで、特殊光光源 1 1 を用いた特殊光観察について説明する。まず、図 5 に示すように、血液の吸光特性レベルは、4 1 5 n m ( 青色 ) にピーク L 1 があり、5 4 0 n m ( 緑色 ) にピークがある以外は低い。そして、図 6 に示すように、体腔内壁には、粘膜表層 4 0 に毛細血管 4 3 が存在し、さらに粘膜深部 4 1 には、太い血管 4 4 が存在する。体腔内壁に照射される 4 1 5 n m ( 青色 ) の光 3 0 B は、波長が短いため、組織内部まで透過せず、上述した血液の吸光特性によって毛細血管 4 3 に吸収される。また、5 4 0 n m ( 緑色 ) の光 3 0 G は、青色よりも波長が長いため、粘膜深部 4 1 まで透過し、上述した血液の吸光特性によって太い血管 4 4 に吸収される。一方、赤色の光 3 0 R は、内部組織 4 2 まで透過し、散乱光としてほとんどが反射される。したがって、4 1 5 n m ( 青色 ) および 5 4 0 n m ( 緑色 ) のみの受光感度を持たせれば、毛細血管 4 3 および太い血管 4 4 などの血管画像のコントラスト情報を得ることができる。

20

#### 【 0 0 4 6 】

したがって、特殊光観察では、青色と緑色の波長をもつ光を被写体に照明し、青色と緑色の波長の感度特性をもつ撮像素子を用いることによって血管のコントラスト情報を得ることができ、血管画像である分光画像を得ることができる。

30

#### 【 0 0 4 7 】

図 7 は、カプセル型内視鏡 2 の詳細構成を示すブロック図である。図 7 に示すように、カプセル型内視鏡 2 は、被写体の照明光を発する照明部 5 1、被写体からの反射光を受光して被写体を撮像する撮像部 5 2、カプセルが内外の状態を検出する状態検出部 5 3、カプセル型内視鏡 2 全体を制御するシステム制御部 5 4、撮像部 5 2 によって撮像された画像データなどの情報をカプセル型内視鏡 2 の外部、特に被検体外に送信用アンテナ 5 6 を介して送信する送信回路 5 5、およびシステム制御部 5 4 の制御のもとに各種構成部位に電源を供給する電源回路 5 7 とを有する。

40

#### 【 0 0 4 8 】

照明部 5 1 は、上述した通常光光源 1 0、特殊光光源 1 1、および通常光光源 1 0 および特殊光光源 1 1 の駆動制御を行う光源制御回路 6 1 を有する。なお、特殊光光源 1 1 は、通常光光源 1 0 に供給する電流が同じである場合、通常光に比して光量が少ない特殊光を発光する。また、撮像部 5 2 は、上述した撮像素子 1 4 と、この撮像素子 1 4 の駆動制御を行う撮像素子制御回路 6 2 とを有する。さらに、状態検出部 5 3 は、センサ部 6 3 と、センサ部 6 3 を駆動制御するセンサ部制御回路 6 4 とを有する。センサ部 6 3 は、少なくとも、カプセル型内視鏡 2 が被検体 1 内で、水などの液中にあるか否か ( 液中にあるか気体中にあるか否か ) を検出することができる各種センサによって実現される。

#### 【 0 0 4 9 】

50

システム制御部 54 は、露光時間測定部 71 と観察モード制御部 72 とを有する。露光時間測定部 71 は、明るさ情報として、少なくとも通常光観察時における露光時間を測定する。一方、観察モード制御部 72 は、露光時間測定部 71 が測定した露光時間情報をもとに、通常光画像の撮像を行う第 1 の観察モードに対応する通常光観察モードと、特殊光画像の撮像を行う第 2 の撮像モードに対応する特殊光観察モードとの動作を制御する。

#### 【0050】

ここで、図 8 および図 9 を参照して、観察モード制御部 72 による観察モード制御処理手順について説明する。図 8 に示すように、観察モード制御部 72 は、まず、予め設定された光量の通常光を通常光光源 10 から発光する（ステップ S101）。その後、撮像部 52 によって通常光画像を撮像して取得する（ステップ S102）。そして、この通常光画像を送信回路 55 および送信用アンテナ 56 を介して被検体外部の受信装置 3 にデータ送信する（ステップ S103）。その後、特殊光観察モードであるか否かを判断する（ステップ S104）。特殊光観察モードでない場合（ステップ S104, No）には、ステップ S201 に移行し、通常光観察モードを続行する。一方、特殊光観察モードである場合（ステップ S104, Yes）には、さらに、露光時間測定部 71 の測定結果をもとに、通常光の露光時間が連続して規定値以上であったか否かを判断する（ステップ S105）。連続して規定値以上である場合（ステップ S105, Yes）には、ステップ S101 に移行し、通常光観察モードを維持して通常光観察を行う。

10

#### 【0051】

一方、通常光の露光時間が連続して規定値以上でない場合（ステップ S105, No）には、特殊光光源 11 を発光させ（ステップ S106）、ステップ S102 に移行して撮像部 52 によって特殊光画像を撮像して取得する。すなわち、特殊光観察モードの動作を行わせる。

20

#### 【0052】

すなわち、観察モード制御部 72 は、予め設定された交互順序で特殊光観察を行う場合、前回および前々回の通常光観察時の露光時間がともに規定値以上である場合、換言すれば、通常光の反射光が少ない場合、特殊光観察を行っても反射光量が少ないため、十分な明るさをもった特殊光画像を得ることができないため、この特殊光観察に替えて通常光観察を行うようにしている。

#### 【0053】

図 9 は、観察モード制御部 72 による具体的な観察モードの動作制御を示したタイミングチャートである。図 9 では、時間間隔  $T1$  で、通常光観察と特殊光観察とを行う場合を示している。時間  $t2$  は、露光時間であり、時間  $t3$  は、規定値であり、時間  $t_{max}$  は、最大露光時間設定値である。図 9 において、上段に示すように、最初の時間帯では、通常光観察 M11 特殊光観察 M21 通常光観察 M12 特殊光観察 M22 通常光観察 M13 のように通常光観察と特殊光観察とが交互に行われている。ここで、通常光観察 M13 の後に、特殊光観察を行う場合、通常光観察 M12, M13 の露光時間  $t2$  がともに規定値  $t3$  以上となり、連続して規定値  $t3$  以上となったため、特殊光観察を行わず、この特殊光観察の時間に、特殊光観察に替えて通常光観察 M14 を行う動作制御を行う。その後、通常光観察を行う時間帯には、通常光観察 M15 を行い、次の特殊光観察を行う場合には、通常光観察 M15 時の露光時間  $t2$  が規定値  $t3$  未満であるため、連続して規定値  $t3$  以上とならないため、特殊光観察 M23 が行われる。

30

40

#### 【0054】

このように、通常光観察は、交互に行う時間帯で常に通常光観察を行うが、特殊光観察は、通常光観察時の露光時間が連続して規定値以上となった場合、その直後の特殊光観察を行わずに、通常光観察を行うようにしている。これによって、十分な明るさをもたない特殊光画像に替えて十分な明るさをもった通常光画像を得ることができ、電力の効率的な利用を行うことができる。

#### 【0055】

（実施の形態 3）

50

つぎに、この発明の実施の形態 3 による画像処理システムとして、撮像装置にカプセル型内視鏡を用いたカプセル型内視鏡システムを例に挙げて説明する。なお、この実施の形態によるカプセル型内視鏡システムは、上記実施の形態 2 によるカプセル型内視鏡システムと同様、上述した実施の形態 1 による画像処理システムをより具体化したものであり、その概念は当該画像処理システムの概念に含まれるものである。

【0056】

この実施の形態 3 では、特殊光光源 11 を、撮像素子 14 の光軸に対して広指向性を有する広指向性特殊光光源 111 (111a ~ 111c) と狭指向性を有する狭指向性特殊光光源 112 (112a ~ 112c) との各対で構成している。図 10 および図 11 に示すように、広指向性特殊光光源 111 および狭指向性特殊光光源 112 は、ともに対となって円環状に配置されるが、広指向性特殊光光源 111 は、狭指向性特殊光光源 112 の内周に配置される。狭指向性特殊光光源 112 が広指向性特殊光光源 111 の内周に配置されることによって、広指向性特殊光光源 111 の光が直接、撮像素子 14 に入射するのを防止することができ、広帯域にフラットな光を照射することができる。

10

【0057】

図 12 は、この発明の実施の形態 3 による観察モード制御部による観察モード制御処理手順を示すフローチャートである。図 12 において、観察モード制御部 72 は、図 8 に示したステップ S101 ~ S105 と同様な処理を行い、ステップ 105 に対応するステップ S205 で、通常光の露光時間が連続して規定値以上になったか否かを判断する。

20

【0058】

その後、通常光の露光時間が連続して規定値以上でない場合 (ステップ S205, No) には、狭指向性特殊光光源 112 および広指向性特殊光光源 111 を発光させ (ステップ S206)、ステップ S202 に移行して特殊光観察モードの動作を行わせる。

【0059】

一方、通常光の露光時間が連続して規定値以上である場合 (ステップ S205, Yes) には、さらにセンサ部 63 の検出結果をもとに、カプセル型内視鏡 2 が液中にあるか否かを判断する (ステップ S207)。カプセル型内視鏡 2 が液中にない場合 (ステップ S207, No) には、カプセル型内視鏡 2 が気体中にあり、ステップ S201 に移行して、この特殊光観察期間に通常光観察を行わせる。一方、カプセル型内視鏡 2 が液中にある場合 (ステップ S207, Yes)、広指向性特殊光光源 111 のみを発光させ (ステップ S208)、ステップ S202 に移行して特殊光観察を行わせる。この場合、広指向性の光が照射されるため、カプセル型内視鏡 2 に近接した周辺の被写体に対する特殊光画像を得ることができる。

30

【0060】

(実施の形態 4)

上述した実施の形態 2, 3 では、いずれも露光時間測定部 71 が撮像部 52 の露光時間を測定することを前提して説明したが、これに限らず、通常光光源 10, 110 の発光量を露光時間に対応づけて測定してもよい。この場合、観察モード制御部 72 は、図 8 に示したフローチャートのステップ S105 に替えて、図 13 のステップ S305 に示すように、通常光の発光量が連続して規定値以上であるか否かを判断すればよい。

40

【0061】

(実施の形態 5)

また、上述した実施の形態 2 ~ 4 では、観察モード制御部 72 が、特殊光観察を行うか、特殊光観察を行わずに通常光観察に置き換えるかの処理を行っていたが、これに限らず、たとえば、図 14 に示すように、ステップ S305 に対応するステップ S405 における判断処理の後、通常光の発光量が連続して規定値以上である場合には、特殊光光源 11, 111, 112 の発光量を増大させた (ステップ S406) 後に、特殊光観察を行い、通常光の発光量が連続して規定値以上でない場合 (ステップ S405, No) には、特殊光光源 11, 111, 112 の発光量を初期値に戻した (ステップ S407) 後、特殊光観察を行うようにする。このような発光量制御を行うことによって、特殊光観察の電力消

50

費を抑えた観察を行うことができる。

【0062】

(実施の形態6)

つぎに、この発明の実施の形態6による画像処理システムとして、撮像装置にカプセル型内視鏡を用いたカプセル型内視鏡システムを例に挙げて説明する。なお、この実施の形態によるカプセル型内視鏡システムは、上記実施の形態2～5のいずれかによるカプセル型内視鏡システムと同様、上述した実施の形態1による画像処理システムをより具体化したものであり、その概念は当該画像処理システムの概念に含まれるものである。

【0063】

この実施の形態6では、図15に示すように、通常光画像と特殊光画像との各画像の撮像に対して、個別に通常光光源10と特殊光光源11との発光量調整を行って取得される各画像の明るさを適切なものにする、システム制御部54をカプセル型内視鏡2に備えていることを特徴とする。

10

【0064】

システム制御部54は、取得される通常光画像と特殊光画像とのそれぞれに対応して通常光光源10と特殊光光源11との発光量調整を行う発光量調整部171を有する。なお、システム制御部54は、通常光画像と特殊光画像とを撮像する各観察モードの切換等のモード制御を行う観察モード制御部172を有する。

【0065】

ここで、図16を参照して、発光量調整部171による発光量調整処理手順について説明する。まず、発光量調整部171は、観察モード制御部172の制御内容をもとに、現在撮像した画像が、通常光画像であるか否かを判断する(ステップS501)。通常光画像である場合(ステップS501, Yes)には、発光量調整部171は、前回取得した通常光画像の所定範囲内の全画素(R, G, B)の値を積算する(ステップS502)。その後、この積算値が適正範囲、すなわち適正な明るさをもつ画像であるか否かを判断する(ステップS503)。積算値が適正範囲でない場合(ステップS503, No)には、画像の明るさが適正範囲内となるように、通常光光源10の発光量を調整し(ステップS504)、ステップS508に移行する。一方、積算値が適正範囲である場合(ステップS503, Yes)には、現在設定されている通常光光源10の発光量を維持させるため、そのままステップS508に移行する。

20

30

【0066】

一方、通常光画像でない場合(ステップS501, No)には、前回取得した特殊光画像の所定範囲内の緑(G)画素と青(B)画素とを積算する(ステップS505)。その後、積算値が適正範囲であるか否かを判断する(ステップS506)。積算値が適正範囲でない場合(ステップS506, No)には、画像の明るさが適正範囲内となるように、特殊光光源11の発光量を調整し(ステップS507)、ステップS508に移行する。なお、積算値が適正範囲内である場合(ステップS506, Yes)、そのままステップS508へ移行する。その後、ステップS508では、発光量調整処理が終了か否かを判断し、終了でない場合(ステップS508, No)に限り、上述した処理を繰り返し、終了である場合(ステップS508, Yes)には、本処理を終了する。

40

【0067】

この実施の形態6では、通常光画像および特殊光画像の各画像に対して個別に発光量調整を行うようにしているので、各画像はそれぞれ適正な明るさをもった画像として取得することができる。

【0068】

なお、この実施の形態6では、通常光光源10および特殊光光源11に対する発光量調整を行うようにしていたが、これに限らず、通常光画像および特殊光画像毎に、露光時間調整を行うようにしてもよい。

【0069】

また、上述した実施の形態6では、ステップS502, S505でそれぞれ異なる積算

50

を行っていたが、これに限らず、各ステップ S 5 0 2 , S 5 0 5 がともに全画素を積算するようにしてもよい。すなわち、ステップ S 5 0 2 , S 5 0 5 の積算処理を共通化してもよい。この場合、ステップ S 5 0 3 , S 5 0 6 の各適正範囲をそれぞれ異なるように設定することが好ましい。

【 0 0 7 0 】

( 実施の形態 7 )

つぎに、この発明の実施の形態 7 による画像処理システムとして、撮像装置にカプセル型内視鏡を用いたカプセル型内視鏡システムを例に挙げて説明する。なお、この実施の形態によるカプセル型内視鏡システムは、上記実施の形態 2 ~ 6 のいずれかによるカプセル型内視鏡システムと同様、上述した実施の形態 1 による画像処理システムをより具体化したものであり、その概念は当該画像処理システムの概念に含まれるものである。

10

【 0 0 7 1 】

この実施の形態 7 では、通常光画像と特殊光画像との各画像に対して、各画像出力の特性に対応した各算出式をもとにそれぞれの輝度を明るさ情報として算出し、通常光光源 1 0 および特殊光光源 1 1 の発光量を調整することを特徴とする。

【 0 0 7 2 】

この実施の形態 7 の発光量調整部 1 7 1 は、実施の形態 6 に示した発光量調整部 1 7 1 と同様に発光量調整を行うが、図 1 7 に示した発光量調整処理手順に従って処理を行う。すなわち、発光量調整部 1 7 1 は、観察モード制御部 1 7 2 の制御内容をもとに、現在撮像した画像が、通常光画像であるか否かを判断する (ステップ S 6 0 1)。通常光画像である場合 (ステップ S 6 0 1 , Y e s ) には、発光量調整部 1 7 1 は、前回取得した通常光画像の所定範囲内の全画素 ( R , G , B ) の平均輝度 Y W を次式 ( 1 ) に従って算出する (ステップ S 6 0 2)。

20

$$Y W = 0 . 3 0 \times R + 0 . 5 9 \times G + 0 . 1 1 \times B \quad \dots ( 1 )$$

【 0 0 7 3 】

その後、この平均輝度 Y W が適正範囲、すなわち適正な明るさをもつ画像であるか否かを判断する (ステップ S 6 0 3)。平均輝度 Y W が適正範囲でない場合 (ステップ S 6 0 3 , N o ) には、画像の明るさが適正範囲内となるように、通常光光源 1 0 の発光量を調整し (ステップ S 6 0 4)、ステップ S 6 0 8 に移行する。一方、平均輝度 Y W が適正範囲である場合 (ステップ S 6 0 3 , Y e s ) には、現在設定されている通常光光源 1 0 の発光量を維持させるため、そのままステップ S 6 0 8 に移行する。

30

【 0 0 7 4 】

一方、通常光画像でない場合 (ステップ S 6 0 1 , N o ) には、前回取得した特殊光画像の所定範囲内の緑 ( G ) 画素と青 ( B ) 画素との値をもとに平均輝度を次式 ( 2 ) に従って算出する (ステップ S 6 0 5)。

$$Y N = 0 . 3 0 \times G + 0 . 7 0 \times B \quad \dots ( 2 )$$

なお、この式 ( 2 ) は、赤 ( R ) 画素を緑 ( G ) 画素として出力し、青 ( B ) 画素を青 ( B ) 画素として出力する場合に適用される算出式である。

【 0 0 7 5 】

その後、この平均輝度 Y N が適正範囲であるか否かを判断する (ステップ S 6 0 6)。平均輝度 Y N が適正範囲でない場合 (ステップ S 6 0 6 , N o ) には、画像の明るさが適正範囲内となるように、特殊光光源 1 1 の発光量を調整し (ステップ S 6 0 7)、ステップ S 6 0 8 に移行する。画像の明るさが適正範囲内である場合 (ステップ S 6 0 6 , Y e s )、そのままステップ S 6 0 8 へ移行する。その後、ステップ S 6 0 8 では、発光量調整処理が終了か否かを判断し、終了でない場合 (ステップ S 6 0 8 , N o ) に限り、上述した処理を繰り返し、終了である場合 (ステップ S 6 0 8 , Y e s ) には、本処理を終了する。なお、ステップ S 6 0 3 , S 6 0 6 の適正範囲は、同じであってもよいし、異なってもよい。

40

【 0 0 7 6 】

この実施の形態 7 では、通常光画像および特殊光画像の各画像に対してそれぞれ異なる

50

平均輝度算出式によって個別に平均輝度を算出し、この平均輝度をもとに発光量調整を行うようにしているので、各画像はそれぞれ適正な明るさをもった画像として取得することができる。

【0077】

(実施の形態8)

つぎに、この発明の実施の形態8による画像処理システムとして、撮像装置にカプセル型内視鏡を用いたカプセル型内視鏡システムを例に挙げて説明する。なお、この実施の形態によるカプセル型内視鏡システムは、上記実施の形態2～7のいずれかによるカプセル型内視鏡システムと同様、上述した実施の形態1による画像処理システムをより具体化したものであり、その概念は当該画像処理システムの概念に含まれるものである。

10

【0078】

この実施の形態8では、受信した通常光画像および特殊光画像それぞれ対応した画素データの増幅処理を施すことによって、各画像データの明るさ調整を行うことを特徴とする。

【0079】

図18は、この発明の実施の形態8である受信装置3の画像処理に関する構成を示すブロック図である。図18に示すように、この受信装置3は、カプセル型内視鏡2から無線送信された無線信号からベースバンド信号に変換されたデータDに対して前処理を行ってRGBの各色データを出力する前処理回路203と、前処理部203が処理した画像が通常光画像であるか特殊光画像であるかを判定する画像判定部204と、画像判定部204による判定結果をもとに画像の所定範囲の平均輝度を算出する平均輝度算出部205と、平均輝度算出部205の算出結果をもとに各画像データを増幅あるいは減衰する増幅部206と、増幅部206によって処理された画像に、所定の信号処理を施して外部に出力する信号処理部207とを有する。また、受信装置3は、前処理部203、画像判定部204、平均輝度算出部205、増幅部206、および信号処理部207を制御する制御部200を有する。さらに、制御部200は、明るさ調整部201を有し、明るさ調整部201は、画像判定部204および平均輝度算出部205の処理結果をもとに増幅部206による増幅処理を制御して画像の明るさ調整を行う。

20

【0080】

ここで、図19に示すフローチャートを参照して、明るさ調整処理手順について説明する。まず、明るさ調整部201は、画像判定部204の判定結果をもとに、入力された画像が通常光画像であるか否かを判断する(ステップS701)。通常光画像でない場合(ステップS701, No)には、明るさ調整部201は、平均輝度算出部205に、この特殊光画像の所定範囲内の全画素の平均輝度を算出させる(ステップS702)。

30

【0081】

その後、この算出された平均輝度が適正範囲であるか否かを判断する(ステップS703)。平均輝度が適正範囲でない場合(ステップS703, No)には、この特殊光画像の明るさが適正範囲となるように、増幅部206による画素データの増幅率を変更し、適正な明るさをもった画素データからなる特殊光画像を信号処理部207に出力し(ステップS704)、ステップS705に移行する。

40

【0082】

一方、平均輝度が適正範囲であった場合(ステップS703, Yes)には、各画素データの増幅を行わず、そのまま信号処理部207に出力し、ステップS705に移行する。また、ステップS701において、通常光画像である場合(ステップS701, Yes)には、そのままステップS705に移行する。その後、ステップS705では、明るさ調整処理が終了か否かを判断し、終了でない場合(ステップS705, No)に限り、上述した処理を繰り返し、終了である場合(ステップS705, Yes)には、本処理を終了する。

【0083】

この実施の形態8では、取得された画像の種類、すなわち通常光画像と特殊光画像にそ

50

れぞれ対応した画素データの増幅処理を行うようにしているので、適正な明るさをもった画像を取得することができる。

【0084】

なお、明るさ調整部201は、平均輝度の算出結果をもとに、信号処理部207によってさらに増幅するようにしてもよい。また、増幅部204は、増幅に限らず、減衰処理を行うようにしてもよい。

【0085】

さらに、上述した実施の形態8では、受信装置3内での処理として説明したが、これに限らず、画像表示装置4側で、受信装置3内と同様な増幅処理を行うようにしてもよい。もちろん、カプセル型内視鏡2側で増幅処理を行ってもよい。

10

【0086】

また、上述した実施の形態2～8では、いずれもカプセル型内視鏡2を例にとって説明した。カプセル型内視鏡2は、被検体内に導入された後は、カプセル型内視鏡2自体で独立して観察モードの動作制御をしなくてはならず、この発明の適用に好適である。

【0087】

(実施の形態9)

つぎに、この発明の実施の形態9による画像処理システムとして、撮像装置にカプセル型内視鏡を用いたカプセル型内視鏡システムを例に挙げて説明する。なお、この実施の形態によるカプセル型内視鏡システムは、上記実施の形態2～8のいずれかによるカプセル型内視鏡システムと同様、上述した実施の形態1による画像処理システムをより具体化したものであり、その概念は当該画像処理システムの概念に含まれるものである。

20

【0088】

この実施の形態によるカプセル型内視鏡2は、前回の撮像により得られた画像データの明るさを基準に、次の撮像における通常光光源10または特殊光光源11の発光時間を決定する。また、この撮像により得られた画像データは、送信回路55より送信用アンテナ56を介して無線信号にて被検体1外の受信装置3へ送信される。受信装置3は、カプセル型内視鏡2から受信した画像データをたとえば携帯型の記録媒体5に記録する。この際、受信装置3は、明るさが著しく小さい画像および著しく大きい画像を保存しないように動作する。これにより、全体が暗くぼやけているような露出アンダーの画像や全体が白くなってしまったような露出オーバーの画像など、被検体1内部の読影に有効でない画像(後述する許容範囲に含まれない画像)を破棄することが可能となる。

30

【0089】

つづいて、この実施の形態9によるカプセル型内視鏡システムを、図面と共に詳細に説明する。この実施の形態9によるカプセル型内視鏡システムは、上述の実施の形態のいずれかと同様である。ただし、図20に示すように、この実施の形態では、カプセル型内視鏡2のシステム制御部54における露光時間測定部71(図7参照)が、明るさ情報検出部71Aに置き換えられる。明るさ情報検出部71Aは、たとえば撮像素子14から読み出された画像信号における所定領域中の画素の信号強度を積分した値(露光量ともいう)を明るさ情報として検出する。なお、図20は、この実施の形態9によるカプセル型内視鏡の構成を示すブロック図である。

40

【0090】

つぎに、この実施の形態によるカプセル型内視鏡システムの動作について、図面を用いて詳細に説明する。図21は、この実施の形態9によるカプセル型内視鏡の概略動作を示すフローチャートである。図22は、この実施の形態9による受信装置3の概略動作を示すフローチャートである。なお、図21に示す動作は、カプセル型内視鏡2内のバッテリーが残量切れになるまで繰り返される。

【0091】

図21に示すように、カプセル型内視鏡2は、起動後、まず、通常光観察モードを選択し(ステップS901)、通常光光源10を発光する(ステップS902)。続いて、カプセル型内視鏡2は、撮像部52を駆動して画像データを取得し(ステップS903)、

50

取得した画像データを無線信号にて受信装置 3 へ送信する (ステップ S 9 0 4)。

【0092】

つぎに、カプセル型内視鏡 2 は、撮像モードを通常光観察モードと特殊光観察モードとのいずれかに切り替える (ステップ S 9 0 5)。例えば、現在の撮像モードが通常光観察モードである場合、観察モードが特殊光観察モードに切り替えられ、特殊光観察モードである場合、通常光観察モードに切り替えられる。つづいて、カプセル型内視鏡 2 は、切り替え後の観察モード、すなわち次回撮影時の観察モードが特殊光観察モードであるか否かを判定する (ステップ S 9 0 6)。

【0093】

ステップ S 9 0 6 の判定の結果、現在の観察モードが通常光観察モードである場合 (ステップ S 9 0 6 の No)、カプセル型内視鏡 2 は、前回に取得した通常光画像における R 成分と G 成分と B 成分との全ての成分から画像の明るさ情報を検出する (ステップ S 9 0 7)。つづいて、カプセル型内視鏡 2 は、検出した明るさ情報から通常光光源 1 0 の発光時間を算出し (ステップ S 9 0 8)、算出した発光時間にて通常光光源 1 0 を発光した (ステップ S 9 0 9) 後、ステップ S 9 0 3 へ帰還する。なお、ステップ S 9 0 8 において算出された発光時間が予め上限として定めておいた発光時間の最大値よりも大きい場合、カプセル内視鏡 2 は、たとえばこの最大値の発光時間で通常光抗原 1 0 を発光する。

10

【0094】

一方、ステップ S 9 0 6 の判定の結果、現在の観察モードが特殊光観察モードである場合 (ステップ S 9 0 6 の Yes)、カプセル型内視鏡 2 は、直前に取得した通常光画像または特殊光画像における G 成分と B 成分、すなわち特殊光画像を形成する色成分から画像の明るさ情報を検出し (ステップ S 9 1 0)、検出した明るさ情報から特殊光光源 1 1 の発光時間を算出し (ステップ S 9 1 1)、算出した発光時間にて特殊光光源 1 1 を発光した (ステップ S 9 1 2) 後、ステップ S 9 0 3 へ帰還する。なお、ステップ S 9 1 2 において算出された発光時間が予め上限として定めておいた発光時間の最大値よりも大きい場合、カプセル内視鏡 2 は、たとえばこの最大値の発光時間で通常光抗原 1 0 を発光する。

20

【0095】

また、図 2 2 に示すように、受信装置 3 は、カプセル型内視鏡 2 から画像データを受信するのを待機する (ステップ S 9 2 1, S 9 2 1 の No)。カプセル型内視鏡 2 から画像データを受信すると (ステップ S 9 2 1 の Yes)、受信装置 3 は、受信した画像が特殊光画像であるか否かを判定する (ステップ S 9 2 2)。受信した画像が特殊光画像でない場合、すなわち通常光画像である場合 (ステップ S 9 2 2 の No)、受信装置 3 は、通常光画像に対する明るさの許容範囲を取得する (ステップ S 9 2 3)。一方、受信した画像が特殊光画像である場合 (ステップ S 9 2 2 の Yes)、受信装置 3 は、特殊光画像に対する明るさの許容範囲を取得する (ステップ S 9 2 4)。なお、通常光画像に対する明るさの許容範囲と、特殊光画像に対する明るさの許容範囲とは、たとえばそれぞれの範囲の上限値と下限値とを予め設定しておくことで実現することができる。また、それぞれの上限値と下限値とは、例えば受信装置 3 における不図示のメモリ等に予め記憶される。

30

【0096】

つぎに、受信装置 3 は、対象の画像の所定の領域に含まれる画素の画素値より当該画像の明るさ情報を導出し (ステップ S 9 2 5)、この明るさ情報より特定される画像の明るさがステップ S 9 2 3 または S 9 2 4 で特定した許容範囲内に含まれるか否かを判定する (ステップ S 9 2 6)。ステップ S 9 2 6 の判定の結果、対象画像の明るさが許容範囲内に含まれる場合 (ステップ S 9 2 6 の Yes)、受信装置 3 は、対象画像に対する同時処理や圧縮処理などの画像処理を実行し (ステップ S 9 2 7)、画像処理後の画像データを記録媒体 5 に保存する (ステップ S 9 2 8)。一方、対象画像の明るさが許容範囲内でない場合 (ステップ S 9 2 6 の No)、受信装置 3 は、対象の画像データを破棄する (ステップ S 9 2 9)。

40

【0097】

その後、受信装置 3 は、たとえばユーザから当該動作の終了指示が入力されたか否かを

50

判定し（ステップS930）、終了指示が入力されていた場合（ステップS930のYes）、図22に示す動作を終了する。一方、終了指示が入力されていない場合（ステップS930のNo）、受信装置3は、ステップS921へ帰還して、以降の動作を実行する。

#### 【0098】

以上のように、この実施の形態では、受信装置3において適正な明るさを持っていない画像データを保存しないという適切な制御を画像の明るさに基づいて安定して行うことが可能である。この結果、読影に有効でない画像データに対する各種処理や読影に有効でない画像データを記憶しておく領域を省くことが可能となり、処理の軽量化や記憶領域の有効活用が可能となる。

10

#### 【0099】

（実施の形態10）

つぎに、この発明の実施の形態10による画像処理システムとして、撮像装置にカプセル型内視鏡を用いたカプセル型内視鏡システムを例に挙げて説明する。なお、この実施の形態によるカプセル型内視鏡システムは、上記実施の形態2～9のいずれかによるカプセル型内視鏡システムと同様、上述した実施の形態1による画像処理システムをより具体化したものであり、その概念は当該画像処理システムの概念に含まれるものである。

#### 【0100】

この実施の形態によるカプセル型内視鏡2は、前回の撮像により得られた画像データの明るさを基準に、次の撮像における通常光光源10または特殊光光源11の発光時間を決定する。また、この撮像により得られた画像データは、送信回路55より送信用アンテナ56を介して無線信号にて被検体1外の受信装置3へ送信され、所定のストレージ（例えば記録媒体5）に保存される。保存された画像データは、たとえば受信装置3を不図示のクレードルに接続した際にクレードルと画像表示装置4とを接続する通信インタフェース（たとえばUSBやLAN等）を介して画像表示装置4にロードされる。画像表示装置4は、入力した画像データに対して、画像の動き（しいては画像の変化から予測されるカプセル型内視鏡2の移動）を検出する動き検出機能や、画像中に赤い部分があるか否かや画像中の赤い部分の領域等を検出する赤色検出機能などの画像処理機能を実行する。

20

#### 【0101】

動き検出機能は、前後する画像間で動きベクトルのスカラー量（ただし、絶対値）を算出し、このスカラー量が予め設定しておいたしきい値よりも大きい場合、表示対象、すなわち読影対象の画像として対象の画像を選別する。なお、表示対象外とされた画像は、たとえば前後する画像に対する時系列情報を保ったまま所定の記憶領域にストックされる。

30

#### 【0102】

ここで、大きなスカラー量が算出される場合には、たとえばカプセル型内視鏡2の撮像窓が体内組織に近接している状態から空の方向を向いた場合（以下、第1ケースという）や、観察窓が空方向を向いていた状態から体内組織に接触した場合（以下、第2ケースという）などがある。撮像窓が体内組織に近接している状態では、少ない照明光量で被写体（体内組織）を明るく撮像することができる。このため、第1のケースでは、観察窓が空を向いた直後に撮像される1または数枚の画像が露出アンダーの暗い画像となってしまう。この暗い画像は、読影には適さない画像であるが、直前に撮像された観察窓が体内組織に近接している際の画像に対して大きな動きベクトルを持つため、そのスカラー量が大きな値となる。この結果、この暗い画像が表示対象画像として選別されてしまう。一方で、撮像窓が空を向いた状態では、撮像部と被写体との距離が長いため、多くの照明光量で照明しなければ明るい画像を得ることができない。このため、第2のケースでは、観察窓が体内組織に近接した直後に撮像される1または数枚の画像が露出オーバーの明るすぎる画像となってしまう。この明るすぎる画像は、読影には適さない画像であるが、直前に撮像された観察窓が空を向いている際の画像に対して大きな動きベクトルを持つため、そのスカラー量が大きな値となる。この結果、この明るすぎる画像が表示対象画像として選別されてしまう。

40

50

## 【0103】

そこでこの実施の形態では、前後する画像間における動きベクトルのスカラー量に加え、各画像の明るさ情報に基づいて、対象の画像を表示対象として選別するか否かを判定する。これにより、読影には適さない、暗い画像や明るすぎる画像が表示対象として選別されることを防止できる。

## 【0104】

また、赤色検出機能は、明るさが不足する画像や過多となった画像に対してそのアルゴリズムが誤作動する可能性がある。これは、暗い画像ではR成分（赤色成分）が他の成分（G、B成分）に対して支配的になるなど、明暗の程度によって画像のホワイトバランスが変化してしまうためである。すなわち、各色成分の相対値に基づいたアルゴリズムによって赤色の強い画像（赤色領域を多く含む画像やR成分の強い画像など）を検出する赤色検出機能は、画像のホワイトバランスが崩れると、このホワイトバランスが崩れた画像に対して実空間の色とは異なる評価をしてしまう可能性がある。この結果、実空間では赤色が強い場合であってもそれを撮像した画像が赤色の強い画像として評価されたり、あるいは、実空間では赤色が強くない場合であってもそれを撮像した画像が赤色の強い画像として評価されたりする場合がある。

10

## 【0105】

そこでこの実施の形態では、ある程度均一な明るさを持った画像に対してのみ赤色検出を行うように構成する。これにより、ホワイトバランスが大きく崩れた画像に対して赤色検出が実行されることを回避できるため、赤色検出機能の動作を安定させることが可能となる。

20

## 【0106】

以下、この実施の形態によるカプセル内視鏡システムの動作について、図面を用いて詳細に説明する。図23は、この実施の形態10による画像表示装置4の概略動作を示すフローチャートである。図24は、この実施の形態10において画像表示装置が実行する画像処理機能の一例（動き検出機能）の概略動作を示すフローチャートである。図25は、この実施の形態10において画像表示装置が実行する画像処理機能の他の一例（赤色検出機能）の概略動作を示すフローチャートである。

## 【0107】

まず、図23に示すように、画像表示装置4は、クレードルを介した受信装置3からの画像データの入力を待機し（ステップS1001、S1001のNo）、画像データが入力されると（ステップS1001のYes）、この画像データに対する画像処理機能を実行する（ステップS1002）。なお、ステップS1001において入力される画像データは、1つの画像データに限らず、例えば時系列に沿って配列した一群の画像データであってもよい。また、ステップS1002において実行される画像処理機能には、たとえば動き検出機能や赤色検出機能などがある。

30

## 【0108】

つぎに、画像表示装置4は、画像処理機能を用いて画像処理した画像を表示する画像表示処理を実行する（ステップS1003）ことで、ユーザに被検体内画像を読影させる。その後、画像表示装置4は、例えばユーザから本動作の終了指示が入力されたか否かを判定し（ステップS1004）、入力されていた場合（ステップS1004のYes）、本動作を終了する。一方、終了指示が入力されていなかった場合（ステップS1004のNo）、画像表示装置4は、ステップS1001へ帰還し、以降の動作を実行する。ただし、ステップS1001に限らず、ステップS1002やS1003へ帰還してもよい。

40

## 【0109】

つぎに、図23のステップS1002において実行される画像処理機能の一例として、動き検出機能を説明する。図24に示すように、動き検出機能が実行されると、画像表示装置4は、入力された画像データのうち1つを選択し（ステップS1011）、この画像の明るさ情報を検出する（ステップS1012）。なお、画像データの選択は、例えば画像データが時系列に沿って配列している場合、この時系列順とする。

50

## 【0110】

つぎに、画像表示装置4は、検出した画像の明るさ情報に基づいて、対象の画像の明るさが予め設定された許容範囲内であるか否かを判定し(ステップS1013)、許容範囲内に無い場合(ステップS1013のNo)、対象の画像データを表示対象外の画像データとし(ステップS1017)、その後、ステップS1018へ移行する。

## 【0111】

一方、対象の画像の明るさが許容範囲内である場合(ステップS1013のYes)、画像表示装置4は、対象の画像データと時系列における直前の画像データとの間の動きベクトルを算出する(ステップS1014)。つづいて、画像表示装置4は、算出した動きベクトルのスカラー量(絶対値)が予め設定しておいたしきい値以上であるか否かを判定し(ステップS1015)、しきい値以上で無い場合(ステップS1015のNo)、対象の画像データを表示対象外の画像データとし(ステップS1017)、その後、ステップS1018へ移行する。

10

## 【0112】

一方、算出した動きベクトルのスカラー量(絶対値)がしきい値以上である場合(ステップS1015のYes)、画像表示装置4は、対象の画像を表示対象画像として選別する(ステップS1016)。なお、表示対象画像の選別は、例えば画像データに表示対象であることを示すフラグを添付したり、表示対象とする画像を別のフォルダ等の記録領域に記録したりなどで実現することができる。

## 【0113】

その後、画像表示装置4は、入力された全ての画像データに対して以上の処理を実行済みであるか否かを判定し(ステップS1018)、実行済みである場合(ステップS1018のYes)、図23に示す動作へリターンする。一方、未だ処理していない画像データがある場合(ステップS1018のNo)、画像表示装置4は、ステップS1011へ帰還し、以降の動作を実行する。

20

## 【0114】

つぎに、図23のステップS1002において実行される画像処理機能の一例として、赤色検出機能を説明する。図25に示すように、赤色検出機能が実行されると、画像表示装置4は、入力された画像データのうち1つを選択し(ステップS1021)、この画像の明るさ情報を検出する(ステップS1022)。なお、画像データの選択は、例えば画像データが時系列に沿って配列している場合、この時系列順とする。

30

## 【0115】

つぎに、画像表示装置4は、検出した画像の明るさ情報に基づいて、対象の画像の明るさが予め設定された許容範囲内であるか否かを判定し(ステップS1023)、許容範囲内に無い場合(ステップS1023のNo)、対象の画像データを赤色検出の対象外とし(ステップS1027)、その後、ステップS1028へ移行する。

## 【0116】

一方、対象の画像の明るさが許容範囲内である場合(ステップS1023のYes)、画像表示装置4は、予め不図示のメモリ等において管理しておいた明るさ情報に応じた色評価関数のしきい値を特定し(ステップS1024)、このしきい値を用いて対象画像に対する赤色検出を実行する(ステップS1025)。また、画像表示装置4は、検出した結果を画像データの時系列と同じ時系列に沿って保存する(ステップS1026)。

40

## 【0117】

その後、画像表示装置4は、入力された全ての画像データに対して以上の処理を実行済みであるか否かを判定し(ステップS1028)、未だ処理していない画像データがある場合(ステップS1028のNo)、ステップS1021へ帰還し、以降の動作を実行する。一方、全ての画像データに対する処理が実行済みである場合(ステップS1028のYes)、画像表示装置4は、ステップS1026において時系列に沿って保存しておいた赤色検出結果から赤色バーのイメージを生成し(ステップS1029)、その後、図23に示す動作をリターンする。なお、赤色バーとは、時系列に沿った画像の赤色検出結果

50

を一目で認識できるようにイメージ化したバー状の画像である。

【0118】

以上のように、この実施の形態では、画像処理機能が画像の明るさに基づいて動作することで画像の明るさに応じた適切な制御が可能となるため、画像データに対する画像処理を安定して行うことが可能となる。

【0119】

なお、この実施の形態10では、明るさ情報の値が予め設定した上限値と下限値との範囲（許容範囲）内にあるか否かに基づいて、画像表示装置4が動作を制御するように構成されたが、本発明はこれに限定されず、種々変形することが可能である。たとえば、前後する画像間における画像の明るさ情報の値の変化量を算出し、この変化量に応じて画像表示装置4が動作するように構成することも可能である。この場合、例えば前の画像に対する変化量が予め設定したしきい値よりも大きい画像は、表示対象画像として選別されたり、赤色検出対象画像として選別されたりする。

10

【0120】

また、この実施の形態10では、明るさ情報の値が許容範囲内に含まれる画像を赤色検出の対象として赤色検出を行うように構成したが、本発明はこれに限定されず、種々変形することが可能である。たとえば、赤色検出機能が、赤色検出に使用する色評価係数のしきい値を明るさ情報の値に応じて変化させるように構成してもよい。これにより、赤色検出機能の動作精度をより向上させることが可能となる。なお、色評価関数のしきい値と明るさ情報との対応関係は、予め導出しておいたものをメモリにおいてテーブル管理しておくともよい。

20

【0121】

（実施の形態11）

つぎに、この発明の実施の形態11による画像処理システムとして、撮像装置にカプセル型内視鏡を用いたカプセル型内視鏡システムを例に挙げて説明する。なお、この実施の形態によるカプセル型内視鏡システムは、上記実施の形態2～10のいずれかによるカプセル型内視鏡システムと同様、上述した実施の形態1による画像処理システムをより具体化したものであり、その概念は当該画像処理システムの概念に含まれるものである。

【0122】

この実施の形態によるカプセル内視鏡システムでは、たとえばカプセル内視鏡2が通常光画像を取得する。これにより得られた画像は、受信装置を介して画像表示装置4へ入力される。画像表示装置4は、入力された通常光画像からそのG成分とB成分とを用いて特殊光画像を生成する。また、画像表示装置4は、通常光画像および特殊光画像に対する所定の画像処理を実行し、この結果および画像をユーザに表示する。

30

【0123】

ここで、通常光光源10を用いた通常光観察モードで撮像された画像データは、これにR成分が多く含まれていると、その一方でG、B成分が不足している場合がある。この場合、通常光画像の明るさは十分なものの、この通常光画像から生成した特殊光画像の明るさは小さい。そこで本実施の形態では、前回の撮像により得られた画像の明るさに基づいて、次の撮像により得られる画像におけるG、B成分が特殊光画像の生成に十分な大きさとなるように、照明部51Bを制御する。これにより、一度の撮像で得られた画像から通常光画像と特殊光画像とを取得することが可能となる。

40

【0124】

以下、この実施の形態によるカプセル内視鏡システムを、図面を用いて詳細に説明する。この実施の形態によるカプセル型内視鏡システムは、上述の実施の形態のいずれかと同様である。ただし、図26に示すように、この実施の形態では、カプセル型内視鏡2の照明部51における特殊光光源11が省略されている。また、システム制御部54Bが、画像の明るさ情報を検出する明るさ情報検出部73と検出した明るさ情報に基づいて画像にフラグ（通常光画像フラグ、特殊光画像フラグ）を添付するフラグ付加部74とを備えたシステム制御部54Bに置き換えられている。なお、図26は、この実施の形態11によ

50

るカプセル型内視鏡の構成を示すブロック図である。

【0125】

つぎに、この実施の形態によるカプセル内視鏡システムの動作について、図面を用いて詳細に説明する。図27は、この実施の形態11によるカプセル型内視鏡の概略動作を示すフローチャートである。図28は、この実施の形態11による受信装置の概略動作を示すフローチャートである。図29は、この実施の形態11による画像表示装置の概略動作を示すフローチャートである。なお、図27に示す動作は、カプセル型内視鏡2内のバッテリーが残量切れになるまで繰り返される。

【0126】

図27に示すように、カプセル内視鏡2は、起動後、まず、通常光光源10を発光し（ステップS1101）、続いて、撮像部52を駆動して画像データを取得する（ステップS1102）。つづいて、カプセル型内視鏡2は、取得した画像データのR、G、B成分から通常光画像の明るさ情報（以下、通常光画像明るさ情報という）を検出し（ステップS1103）、つづいて、同画像データのG、B成分からこれらよりなる特殊光画像の明るさ情報（以下、特殊光画像明るさ情報という）を検出する（ステップS1104）。

【0127】

つぎに、カプセル型内視鏡2は、ステップS1103で検出した通常光画像明るさ情報の値が予め設定しておいた許容範囲内であるか否かを判定し（ステップS1105）、許容範囲内である場合（ステップS1105のYes）、画像データに当該画像データが読影に有効な通常光画像であることを示す通常光画像フラグを添付する（ステップS1106）。一方、通常光画像明るさ情報の値が許容範囲内でない場合（ステップS1105のNo）、カプセル型内視鏡2は、そのままステップS1107へ移行する。

【0128】

つぎに、カプセル型内視鏡2は、ステップS1104で検出した特殊光画像明るさ情報の値が予め設定しておいた許容範囲内であるか否かを判定し（ステップS1107）、許容範囲内である場合（ステップS1107のYes）、画像データに当該画像データが特殊光画像を生成可能な画像データであることを示す特殊光画像フラグを添付する（ステップS1108）。一方、特殊光画像明るさ情報の値が許容範囲内でない場合（ステップS1107のNo）、カプセル型内視鏡2は、そのままステップS1109へ移行する。なお、上述の通常光画像フラグおよび特殊光画像生成フラグに代えて、算出した通常光画像明るさ情報および/または特殊光画像明るさ情報を画像データに添付するように構成してもよい。

【0129】

つぎに、カプセル型内視鏡2は、画像データを受信装置3へ送信する（ステップS1109）。つづいて、カプセル型内視鏡2は、特殊光画像明るさ情報から次の撮像における通常光光源10の発光時間を算出し（ステップS1110）、この算出した発光時間で通常光光源10を発光する（ステップS1111）。その後、カプセル型内視鏡2は、ステップS1102へ帰還して、以降、同様の動作を実行する。なお、ステップS1110において算出された発光時間が予め上限として定めておいた発光時間の最大値よりも大きい場合、カプセル型内視鏡2は、たとえばこの最大値の発光時間で通常光光源10を発光する。

【0130】

また、図28に示すように、受信装置3は、カプセル型内視鏡2から画像データを受信するのを待機する（ステップS1121、S1121のNo）。カプセル型内視鏡2から画像データを受信すると（ステップS1121のYes）、受信装置3は、受信した画像データに通常光画像フラグと特殊光画像フラグとのうち少なくとも一方が添付されているか否かを判定し（ステップS1122）、添付されていない場合（ステップS1122のNo）、この画像データを保存せずに破棄する（ステップS1125）。

【0131】

一方、画像データに特殊光画像生成フラグが添付されている場合（ステップS1122

10

20

30

40

50

の Yes)、受信装置 3 は、この画像データに対して同時化処理や圧縮処理などの所定の画像処理を実行し(ステップ S 1 1 2 3)、画像処理後の画像データを記録媒体 5 に保存する(ステップ S 1 1 2 4)。

【0132】

その後、受信装置 3 は、たとえばユーザから当該動作の終了指示が入力されたか否かを判定し(ステップ S 1 1 2 6)、終了指示が入力されていた場合(ステップ S 1 1 2 6 の Yes)、図 2 8 に示す動作を終了する。一方、終了指示が入力されていない場合(ステップ S 1 1 2 6 の No)、受信装置 3 は、ステップ S 1 1 2 1 へ帰還して、以降の動作を実行する。

【0133】

また、図 2 9 に示すように、画像表示装置 4 は、クレードルを介した受信装置 3 からの画像データの入力を待機し(ステップ S 1 1 3 1, S 1 1 3 1 の No)、画像データが入力されると(ステップ S 1 1 3 1 の Yes)、入力された画像データのうち 1 つを選択し(ステップ S 1 1 3 2)、この画像データに特殊光画像フラグが添付されているか否かを判定する(ステップ S 1 1 3 3)。ステップ S 1 1 3 3 の判定の結果、画像データに特殊光画像フラグが添付されていない場合(ステップ S 1 1 3 3 の No)、画像表示装置 4 は、そのままステップ S 1 1 3 5 へ移行する。一方、画像データに特殊光画像フラグが添付されている場合(ステップ S 1 1 3 3 の Yes)、画像表示装置 4 は、この画像データにおける G, B 成分から特殊光画像を生成し(ステップ S 1 1 3 4)、ステップ S 1 1 3 5 へ移行する。

【0134】

ステップ S 1 1 3 5 では、画像表示装置 4 は、画像データを保存する。したがって、通常光画像の他にステップ S 1 1 3 4 において特殊光画像が生成されていた場合、画像表示装置 4 は、ステップ S 1 1 3 5 において通常光画像と特殊光画像とを保存する。

【0135】

つぎに、画像表示装置 4 は、入力された全ての画像データに対して以上の処理を実行済みであるか否かを判定し(ステップ S 1 1 3 6)、未だ処理していない画像データがある場合(ステップ S 1 1 3 6 の No)、画像表示装置 4 は、ステップ S 1 1 3 2 へ帰還し、以降の動作を実行する。一方、全ての画像データに対する処理が実行済みである場合(ステップ S 1 1 3 6 の Yes)、画像表示装置 4 は、例えばユーザから本動作の終了指示が入力されたか否かを判定し(ステップ S 1 1 3 7)、入力されていた場合(ステップ S 1 1 3 7 の Yes)、本動作を終了する。一方、終了指示が入力されていなかった場合(ステップ S 1 1 3 7 の No)、画像表示装置 4 は、ステップ S 1 1 3 1 へ帰還し、以降の動作を実行する。

【0136】

以上のように、この実施の形態では、カプセル型内視鏡 2 のみならず、受信装置 3 および画像表示装置 4 が、カプセル型内視鏡 2 によって画像データに付加された明るさに基づく情報(フラグや明るさ情報等)に基づいて動作することが可能であるため、画像データ自体の生成や生成された画像データに対する処理を安定して行うことが可能となる。

【0137】

なお、上記した実施の形態 2 ~ 8 では、画像の明るさに応じて撮像部 5 2 の露光時間を制御することで撮像部 5 2 が取得する画像の明るさを調整し、上述した実施の形態 9 ~ 1 1 では、画像の明るさに応じて照明部 5 1 の照明時間を制御することで撮像部 5 2 が取得する画像の明るさを調整していた。ただし、本発明はこれに限定されず、実施の形態 2 ~ 8 において画像の明るさに応じて照明部 5 1 の照明時間を制御することで撮像部 5 2 が取得する画像の明るさを調整し、実施の形態 9 ~ 1 1 において画像の明るさに応じて撮像部 5 2 の露光時間を制御することで撮像部 5 2 が取得する画像の明るさを調整するなど、上述の実施の形態間でその構成を部分的に種々組み換えることは当業者にとって容易であるため、ここでは詳細な説明を省略する。

【符号の説明】

10

20

30

40


50

## 【 0 1 3 8 】


1 0 0	画像処理システム	
1 0 1	画像生成手段	
1 0 2	表示手段	
1 0 3	照明手段	
1 0 4	撮像手段	
1 0 5	画像処理手段	
1 0 6	明るさ検出手段	
1 0 7	制御手段	
1	被検体	10
2	カプセル型内視鏡	
3	受信装置	
3 a ~ 3 h	受信アンテナ	
4	画像表示装置	
1 0 , 1 1 0	通常光光源	
1 1	特殊光光源	
1 2	透明カバー	
1 3	光学レンズ	
1 4	撮像素子	
2 0	ドーム型透明カバー	20
2 1	カプセル型筐体	
2 3	基板	
4 0	粘膜表層	
4 1	粘膜深部	
4 2	内部組織	
4 3	毛細血管	
4 4	血管	
5 1	照明部	
5 2	撮像部	
5 3	状態検出部	30
5 4 , 5 4 B	システム制御部	
5 5	送信回路	
5 6	送信用アンテナ	
5 7	電源回路	
6 1	光源制御回路	
6 2	撮像素子制御回路	
6 3	センサ部	
6 4	センサ部制御回路	
7 1	露光時間測定部	
7 2 , 1 7 2	観察モード制御部	40
7 3	明るさ情報検出部	
7 4	フラグ付加部	
1 1 1	広指向性特殊光光源	
1 1 2	狭指向性特殊光光源	
1 7 1	発光量調整部	
2 0 1	明るさ調整部	
2 0 3	前処理部	
2 0 4	画像判定部	
2 0 5	平均輝度算出部	
2 0 6	増幅部	50

2 0 7 信号処理部


【 図 1 】

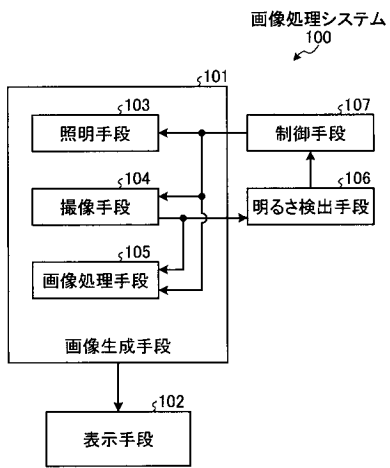


【 図 2 】

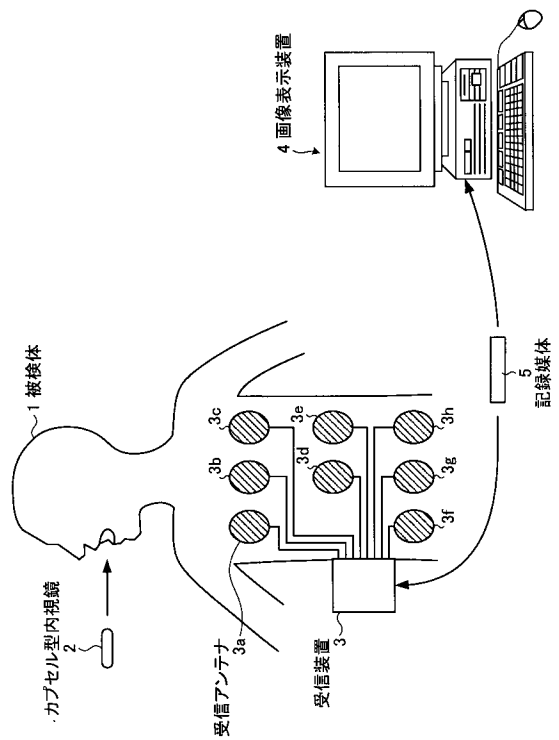


【図3】

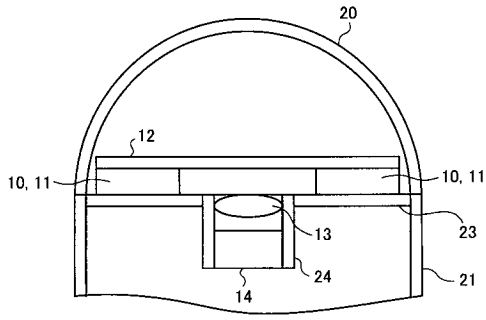


【図4】

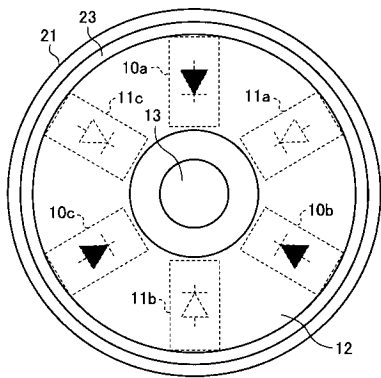


【図7】

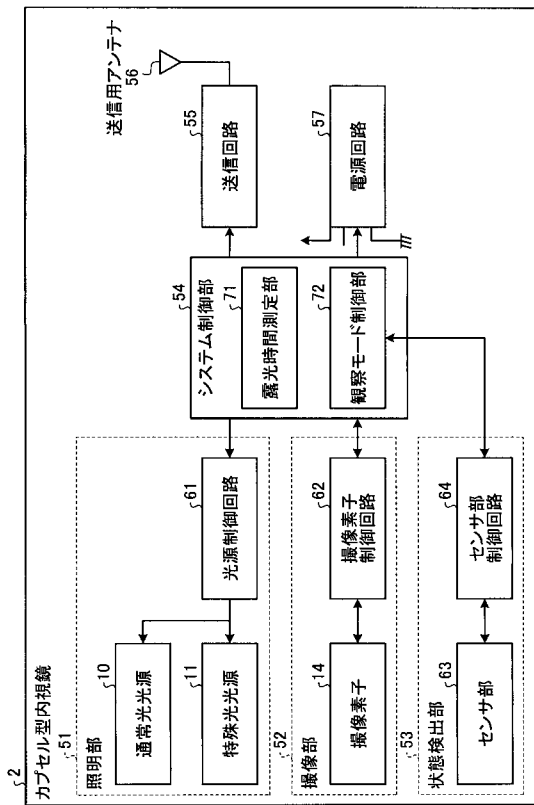


【図5】

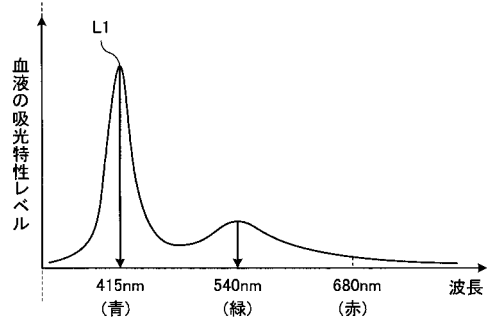


【図6】

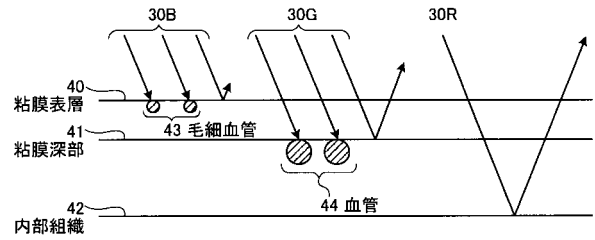


【図8】

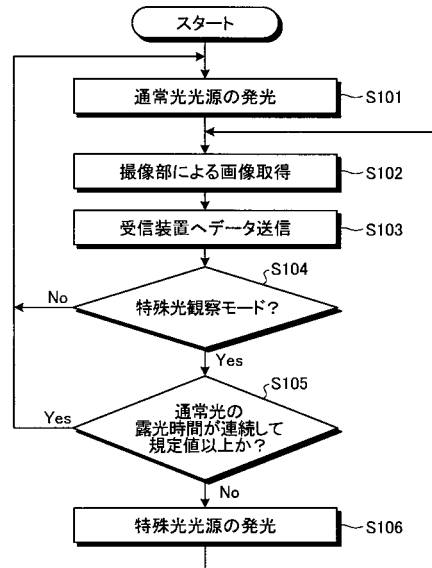


【図 9】

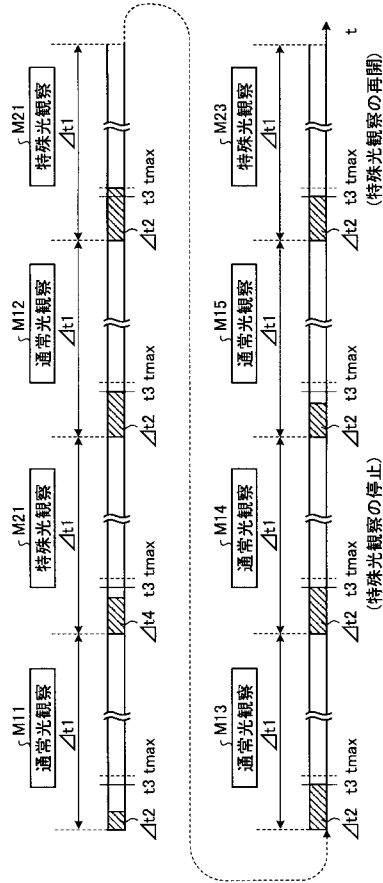


【図 10】

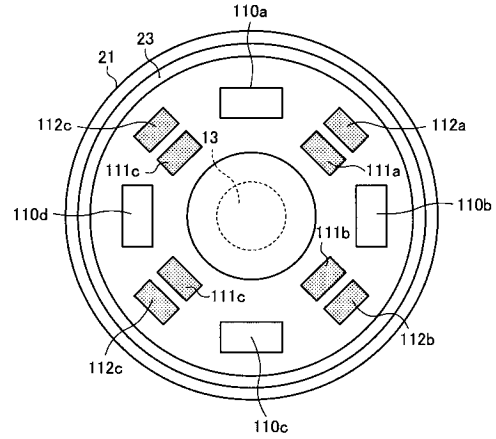


【図 11】

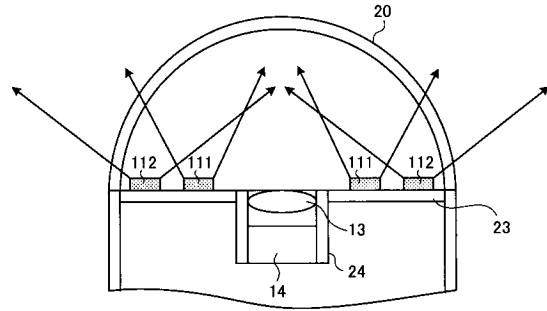


【図 12】

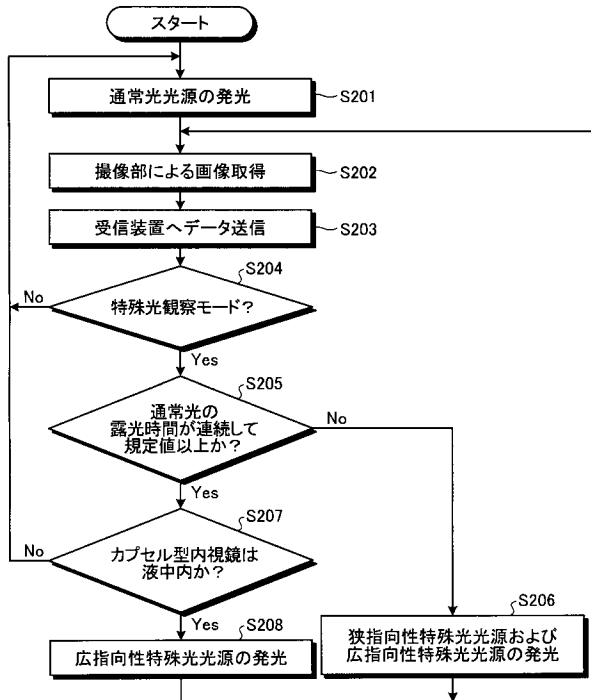


【図 13】

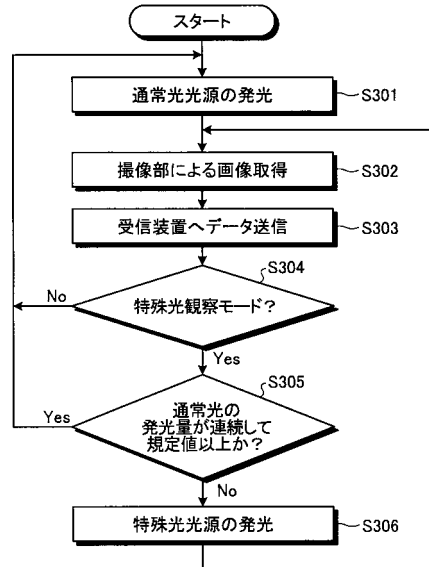


【 図 1 4 】

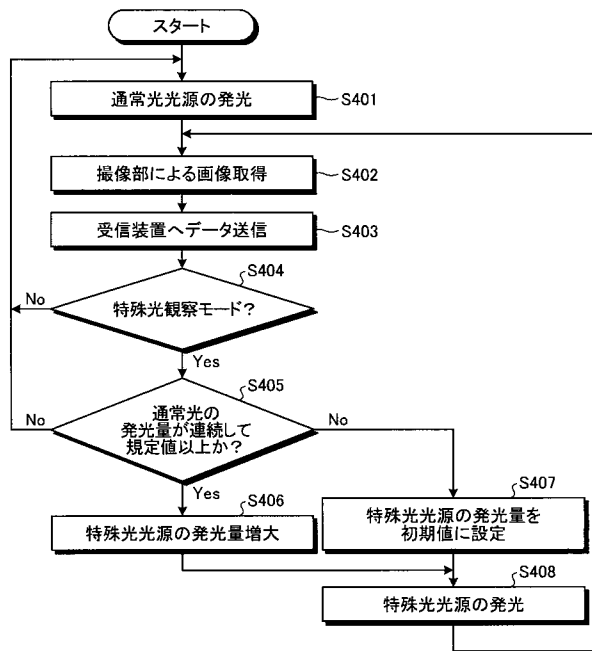


【 図 1 5 】

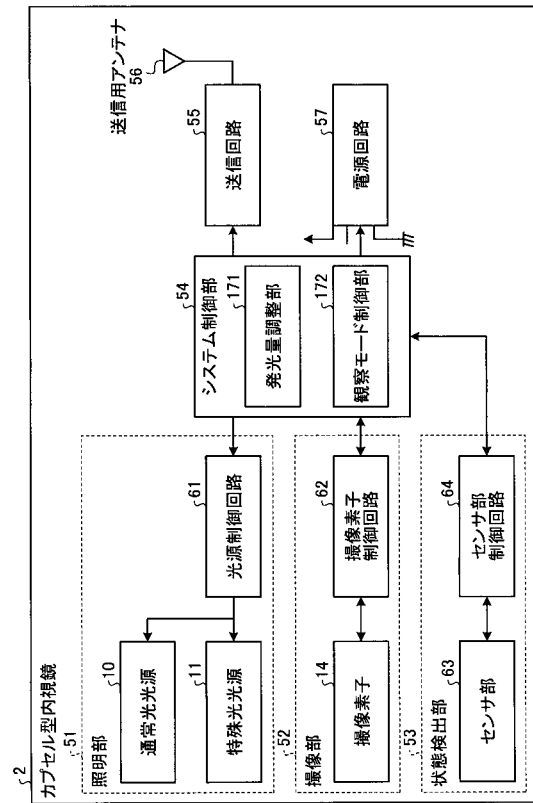


【 図 1 6 】

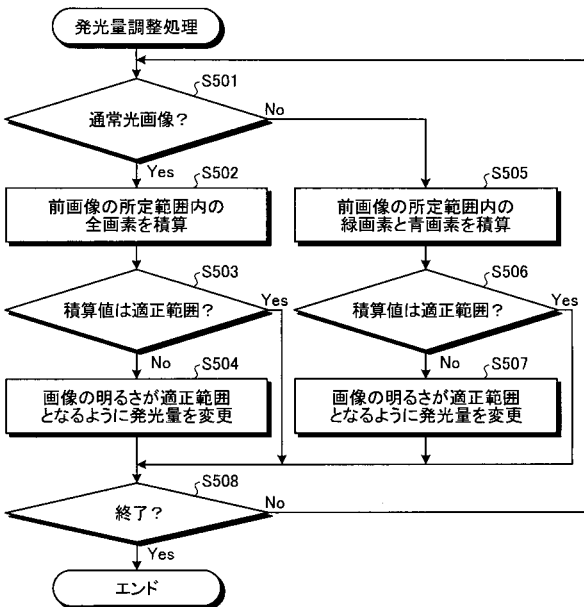


【 図 1 7 】

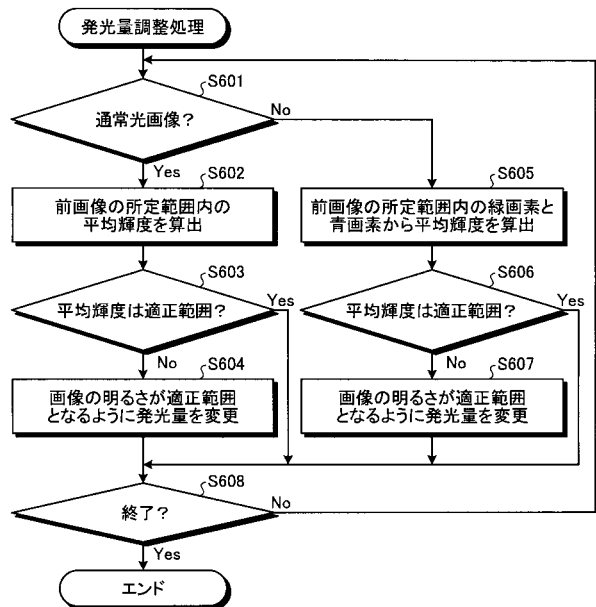


【 図 1 8 】

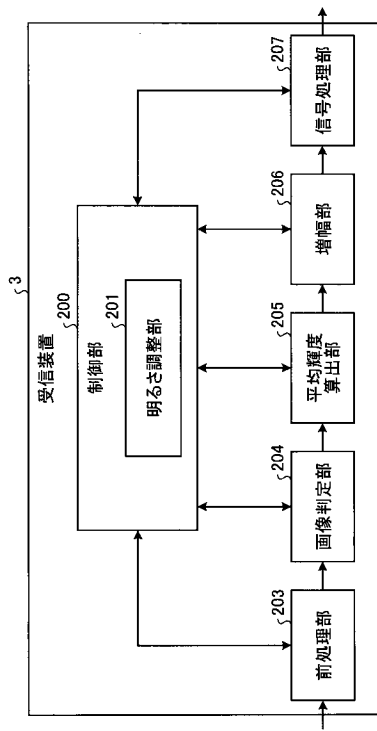


【 図 1 9 】

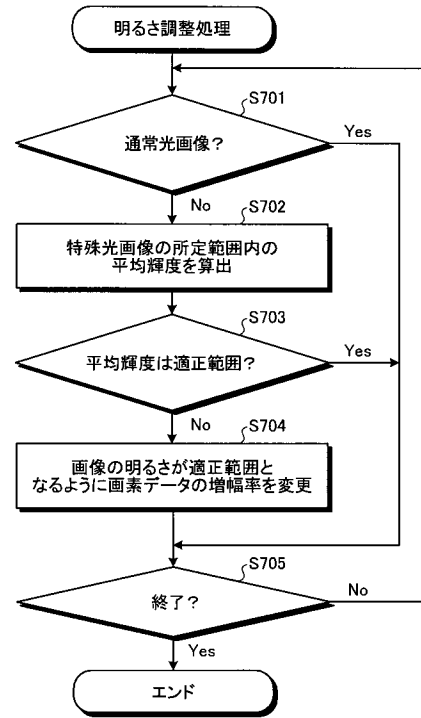


【 図 2 0 】

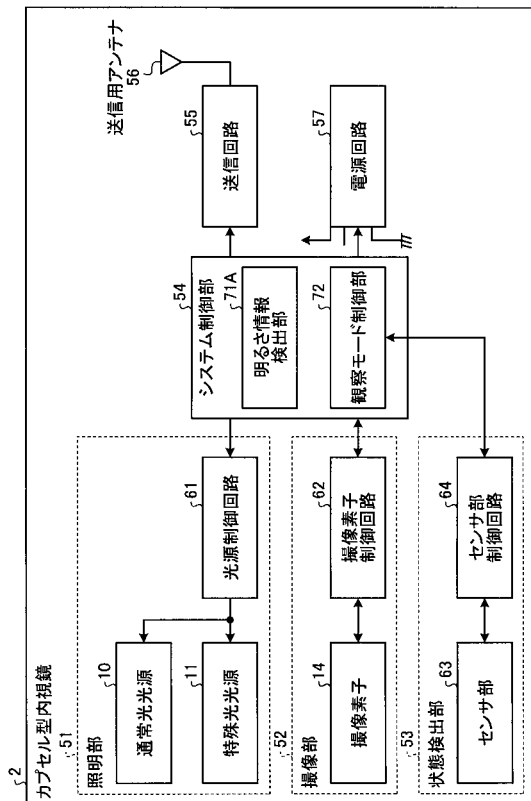


【 図 2 1 】

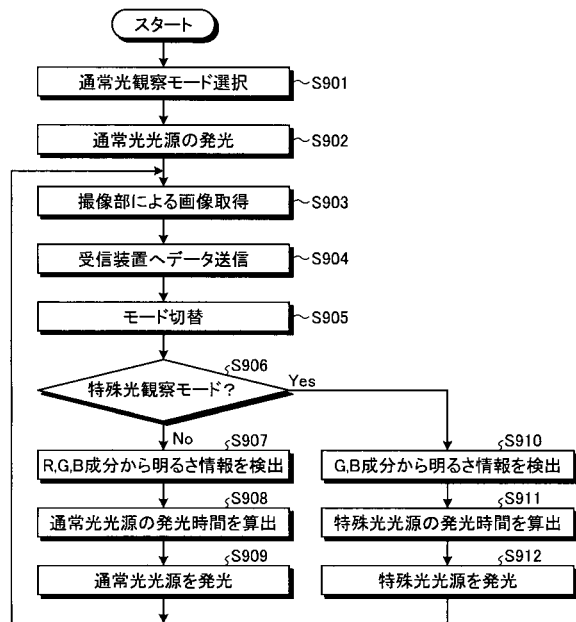


【 図 2 2 】

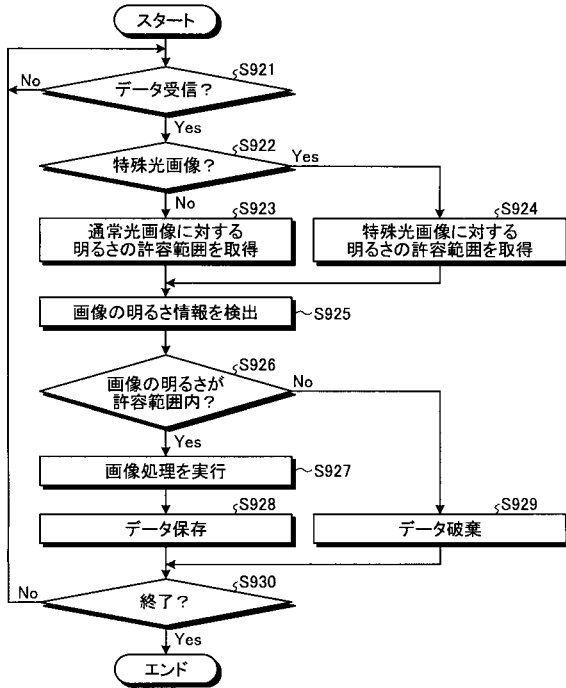


【 図 2 3 】

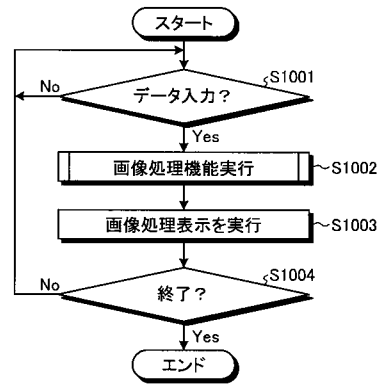


【 図 2 4 】

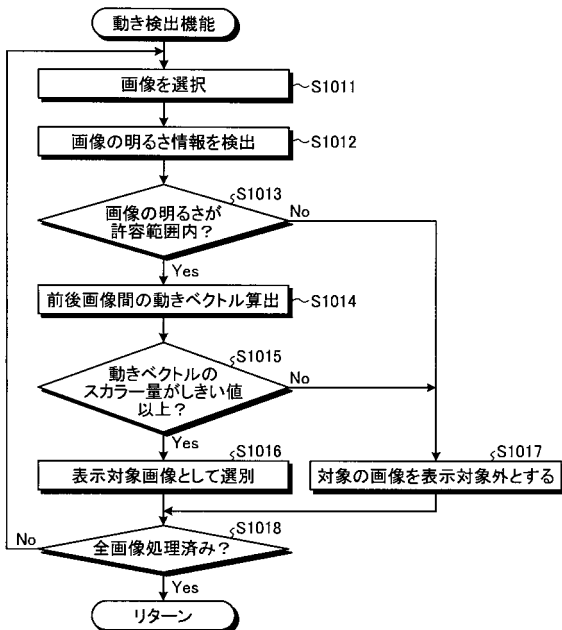


【 図 2 5 】

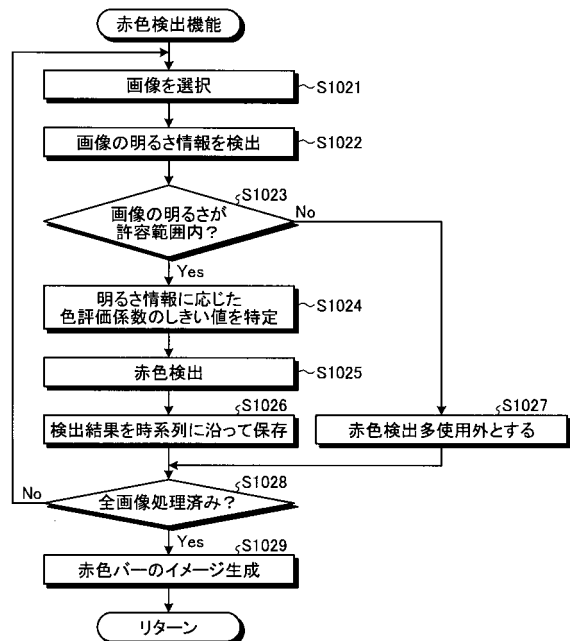


【図 26】

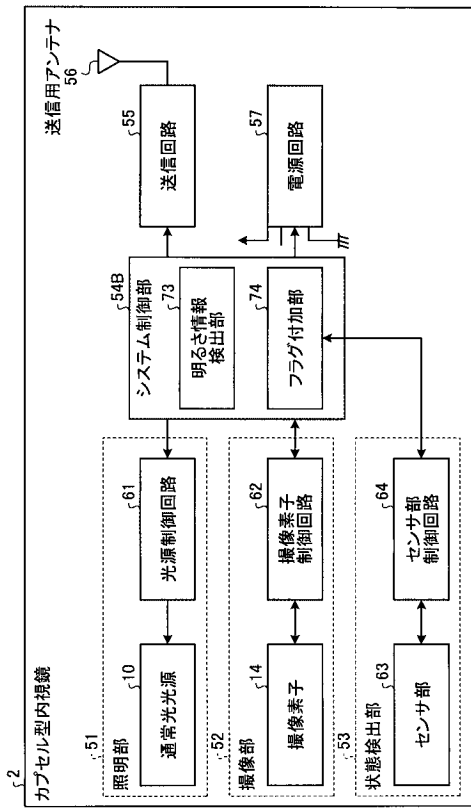


【図 27】

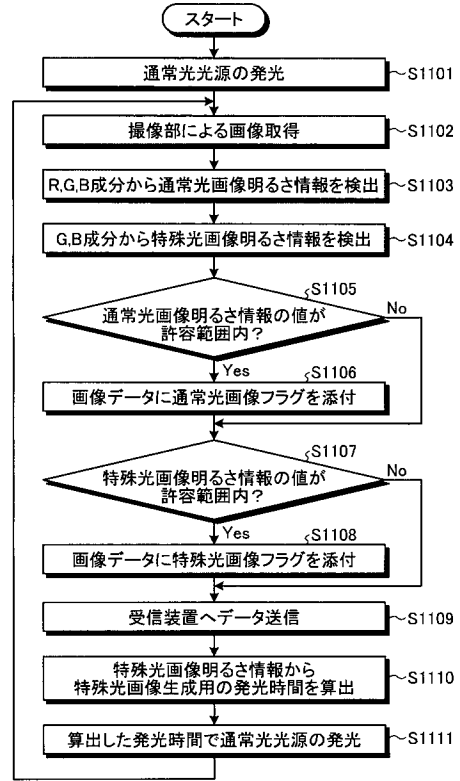

【図 28】

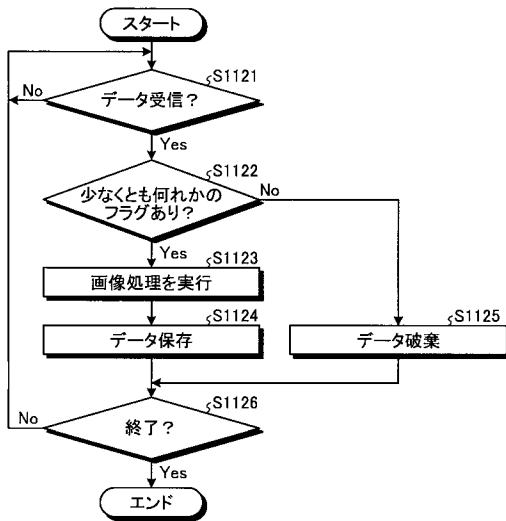

【図 29】

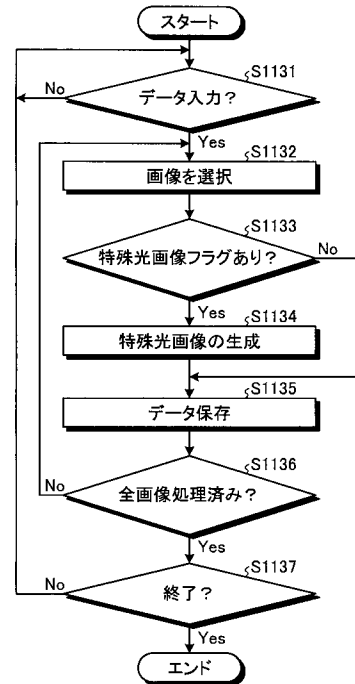

## 【手続補正書】

【提出日】平成22年10月19日(2010.10.19)

## 【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の光源で照明しつつ画像を撮像する第1の観察モードと、前記第1の光源とは異なる第2の光源で照明しつつ画像を撮像する第2の観察モードとの二つの観察モードを有し、いずれか一方の観察モードを選択して撮像された画像に基づいて表示を行うための画像を生成する画像生成手段と、

一方の観察モードで撮像した画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、

前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記一方の観察モードでの観察に続いて行われる他方の観察モードでの露光動作または画像処理を制御する制御手段と

を備えたことを特徴とする画像処理システム。

【請求項2】

前記第1の観察モードは、白色照明光による通常光観察であり、

前記第2の観察モードは、特定の波長帯の照明光による特殊光観察であることを特徴とする請求項1に記載の画像処理システム。

【請求項3】

前記画像生成手段は、前記一方の観察モードと前記他方の観察モードとを交互に又は連続して画像を生成することを特徴とする請求項1に記載の画像処理システム。

【請求項4】

前記画像生成手段は、

被写体を繰り返し撮像する撮像手段と、

前記撮像手段による撮像に併せて前記被写体を照明する照明手段と、

前記撮像手段により取得された画像に所定の処理を実行する画像処理手段と、

を含み、

前記制御手段は、前記明るさ検出手段によって検出された画像の明るさに基づいて、前記照明手段、前記撮像手段および前記画像処理手段の少なくとも1つを制御することを特徴とする請求項1に記載の画像処理システム。

【請求項5】

前記制御手段は、前回の撮像により得られた画像の明るさに基づいて次の撮像における前記撮像手段の露光時間を制御することを特徴とする請求項4に記載の画像処理システム。

【請求項6】

前記制御手段は、前回の撮像により得られた画像の明るさに基づいて次の撮像における前記照明手段の発光時間を制御することを特徴とする請求項4に記載の画像処理システム。

【請求項7】

前記所定の処理は、前記画像の同時化处理、圧縮処理、保存処理、動き検出処理、赤色検出処理、および、当該画像と種類が異なる画像の生成処理の少なくとも1つを含み、

前記制御手段は、前記撮像手段が取得した画像の明るさに基づいて前記画像処理手段による当該画像に対する前記所定の処理を制御することを特徴とする請求項4に記載の画像処理システム。

【請求項8】

前記画像生成手段は、前記異なる種類の画像として通常光画像と特殊光画像とを生成す

ることを特徴とする請求項 1 に記載の画像処理システム。

【請求項 9】

前記照明手段は、前記被写体を通常光で照明する通常光光源と、前記被写体を特殊光で照明する特殊光光源と、を含み、

前記画像生成手段は、前記被写体を前記通常光光源で照明した際に前記撮像手段が取得した画像を前記通常光画像として生成し、前記被写体を前記特殊光光源で照明した際に前記撮像手段が取得した画像を前記特殊光画像として生成することを特徴とする請求項 8 に記載の画像処理システム。

【請求項 10】

前記画像生成手段は、

前記照明手段と前記撮像手段とを含み、被検体内に導入されて該被検体内の前記被写体を前記撮像手段が撮像して得られた画像を無線信号にて送信する撮像装置と、

前記撮像装置が無線信号にて送信した前記画像を受信し、該画像を所定の記録領域に記録する受信装置と、

前記受信装置に記録された画像を該受信装置から取得して表示する画像表示装置と、を含み、

前記画像処理手段は、前記撮像装置と前記受信装置と前記画像表示装置とのいずれか 1 つ以上に設けられたことを特徴とする請求項 4 に記載の画像処理システム。

【請求項 11】

前記撮像手段は、前記被写体を観察する第 1 の観察モードによる撮像動作および前記第 1 の観察モードとは異なる第 2 の観察モードによる撮像動作とを同一観察モードの複数回繰り返しを含めて交互に行い、

前記制御手段は、

前記第 1 の観察モード時における露光時間を測定する露光時間測定部と、

前記露光時間測定部の測定結果をもとに前記第 2 の観察モードの撮像動作を制御する観察モード制御部と、

を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の画像処理システム。

【請求項 12】

前記撮像手段は、

前記第 1 の観察モードに用いる光を照射する第 1 の光源部と、

前記第 1 の観察モードとは異なる第 2 の観察モードに用いる光を照射する第 2 の光源部と、

を含み、

前記露光時間測定部は、前記第 1 の光源部によって照射される光の露光時間を前記第 1 の観察モード時の露光時間として測定することを特徴とする請求項 11 に記載の画像処理システム。

【請求項 13】

前記観察モード制御部は、前記露光時間測定部の測定結果をもとに少なくとも前記第 2 の光源部の動作を制御することによって前記第 2 の観察モードの撮像動作を制御することを特徴とする請求項 11 に記載の画像処理システム。

【請求項 14】

前記観察モード制御部は、前記第 1 の観察モード時における露光時間が前回まで複数回連続して所定値を超える場合、次の前記第 2 の観察モードによる撮像動作を停止させ、該第 2 の観察モードに替えて前記第 1 の観察モードによる撮像動作を行わせ、複数回連続して所定値を超えない場合、次の前記第 2 の観察モードによる撮像動作を行わせることを特徴とする請求項 11 に記載の画像処理システム。

【請求項 15】

前記第 1 の光源部は、前記撮像手段の光軸方向に対して狭い指向性をもった狭指向性光源と広い指向性をもった広指向性光源とを有し、

前記観察モード制御部は、前記第 1 の観察モード時における露光時間が前回まで複数回

連続して所定値を超える場合、前記広指向性光源のみから光を照射させて次の前記第2の観察モードによる撮像動作を行わせ、複数回連続して所定値を超えない場合、前記広指向性光源および前記狭指向性光源から光を照射させて次の前記第2の観察モードによる撮像動作を行わせることを特徴とする請求項1 2に記載の画像処理システム。

【請求項16】

少なくとも前記撮像手段および前記照明手段が液中内か否かを検出する状態検出手段を備え、

前記観察モード制御部は、前記第1の観察モード時における露光時間が前回まで複数回連続して所定値を超える場合であって前記状態検出手段が液中であると検出した場合には、前記広指向性光源のみから光を照射させて次の前記第2の観察モードによる撮像動作を行わせ、前記第1の観察モード時における露光時間が前回まで複数回連続して所定値を超える場合であって前記状態検出手段が液中でないと検出した場合には、次の前記第2の観察モードによる撮像動作を停止させ、該第2の観察モードに替えて前記第1の観察モードによる撮像動作を行わせることを特徴とする請求項1 5に記載の画像処理システム。

【請求項17】

前記第1の観察モードは、白色光源を用いて前記被写体を撮像し、

前記第2の観察モードは、特定の色成分の分光光を照射する狭帯域光源を用いて前記被写体を撮像することを特徴とする請求項1 1に記載の画像処理システム。

【請求項18】

前記狭帯域光源は、青色および緑色を特定の色成分とする分光光を照射することを特徴とする請求項1 7に記載の画像処理システム。

【請求項19】

前記撮像装置は、前記被検体内に導入されるカプセル型内視鏡であることを特徴とする請求項4に記載の画像処理システム。

【請求項20】

第1の光源で照明しつつ画像を撮像する第1の観察モードと、前記第1の光源とは異なる第2の光源で照明しつつ画像を撮像する第2の観察モードとの二つの観察モードを有し、いずれか一方の観察モードを選択して撮像された画像に基づいて表示を行うための画像を生成する画像生成手段と、

一方の観察モードで撮像した画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、

前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記一方の観察モードでの観察に続いて行われる他方の観察モードでの露光動作または画像処理を制御する制御手段と

前記画像生成手段が生成した画像を送信する送信手段と、

を備えたことを特徴とする撮像装置。

【請求項21】

第1の光源で照明しつつ撮像した画像と、前記第1の光源とは異なる第2の光源で照明しつつ撮像した画像との二つの画像をそれぞれ受信する画像受信手段と、

前記画像受信手段で受信された前記画像を所定の記録領域に記録する記録手段と、

前記画像受信手段で受信された前記画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、

前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記記録手段による当該画像の記録の可否を制御する制御手段と、

を備えたことを特徴とする受信装置。

【請求項22】

第1の光源で照明しつつ撮像した画像と、前記第1の光源とは異なる第2の光源で照明しつつ撮像した画像との二つの画像それぞれに対して所定の画像処理を実行する画像処理手段と、

前記画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、

前記明るさ検出手段が検出した前記画像の明るさに基づいて前記画像処理手段による当該画像に対する前記所定の画像処理を制御する制御手段と、

前記画像および/または前記画像処理手段によって前記所定の画像処理がなされた画像を表示する表示手段と、

を備えたことを特徴とする画像表示装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

上述した課題を解決し、目的を達成するために、この発明にかかる画像処理システムは、第1の光源で照明しつつ画像を撮像する第1の観察モードと、前記第1の光源とは異なる第2の光源で照明しつつ画像を撮像する第2の観察モードとの二つの観察モードを有し、いずれか一方の観察モードを選択して撮像された画像に基づいて表示を行うための画像を生成する画像生成手段と、一方の観察モードで撮像した画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記一方の観察モードでの観察に続いて行われる他方の観察モードでの露光動作または画像処理を制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。

上記した本発明による画像処理システムは、前記第1の観察モードが、白色照明光による通常光観察であり、前記第2の観察モードが、特定の波長帯の照明光による特殊光観察であることを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0026

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0026】

また、本発明による撮像装置は、第1の光源で照明しつつ画像を撮像する第1の観察モードと、前記第1の光源とは異なる第2の光源で照明しつつ画像を撮像する第2の観察モードとの二つの観察モードを有し、いずれか一方の観察モードを選択して撮像された画像に基づいて表示を行うための画像を生成する画像生成手段と、一方の観察モードで撮像した画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記一方の観察モードでの観察に続いて行われる他方の観察モードでの露光動作または画像処理を制御する制御手段と、前記画像生成手段が生成した画像を送信する送信手段と、を備えたことを特徴とする。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0027】

また、本発明による受信装置は、第1の光源で照明しつつ撮像した画像と、前記第1の光源とは異なる第2の光源で照明しつつ撮像した画像との二つの画像をそれぞれ受信する画像受信手段と、前記画像受信手段で受信された前記画像を所定の記録領域に記録する記録手段と、前記画像受信手段で受信された前記画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、前記明るさ検出手段で検出された画像の明るさに基づいて前記記録手段による当該画像の記録の可否を制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

## 【補正の内容】

## 【0028】

また、本発明による画像表示装置は、第1の光源で照明しつつ撮像した画像と、前記第1の光源とは異なる第2の光源で照明しつつ撮像した画像との二つの画像それぞれに対して所定の画像処理を実行する画像処理手段と、前記画像の明るさを検出する明るさ検出手段と、前記明るさ検出手段が検出した前記画像の明るさに基づいて前記画像処理手段による当該画像に対する前記所定の画像処理を制御する制御手段と、前記画像および/または前記画像処理手段によって前記所定の画像処理がなされた画像を表示する表示手段と、を備えたことを特徴とする。

## 【 国際調査報告 】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/069435

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> A61B1/04(2006.01)i, A61B1/00(2006.01)i, A61B1/06(2006.01)i, G02B23/24 (2006.01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b>		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61B1/04, A61B1/00, A61B1/06, G02B23/24		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2010 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2010 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2010		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
<b>Category*</b>	<b>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</b>	<b>Relevant to claim No.</b>
Y A	JP 2005-74034 A (Olympus Corp.), 24 March 2005 (24.03.2005), entire text; all drawings & JP 2006-68488 A & US 2005/0124858 A1 & US 2007/0055105 A1 & US 2008/0146877 A1	1-12, 16-21 13-15
Y	JP 2007-21039 A (Olympus Corp.), 01 February 2007 (01.02.2007), paragraphs [0058] to [0061] & US 2008/0167523 A1 & EP 1905345 A1 & WO 2007/010997 A & WO 2007/010997 A1 & CN 101203169 A	1-3, 6-9, 19
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 04 February, 2010 (04.02.10)		Date of mailing of the international search report 16 February, 2010 (16.02.10)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/069435

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2006-75331 A (Mitsubishi Electric Corp.), 23 March 2006 (23.03.2006), paragraph [0031] & US 2006/0050145 A1 & KR 10-2006-0051099 A & CN 1745695 A	1-12,16-19
Y	JP 2006-122502 A (Olympus Corp.), 18 May 2006 (18.05.2006), paragraphs [0040] to [0043], [0123] & US 2007/0191677 A1 & EP 1806091 A1 & WO 2006/046637 A1 & CN 101043841 A	20,21

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2009/069435									
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61B1/04(2006.01)i, A61B1/00(2006.01)i, A61B1/06(2006.01)i, G02B23/24(2006.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61B1/04, A61B1/00, A61B1/06, G02B23/24											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2010年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2010年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2010年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2010年	日本国実用新案登録公報	1996-2010年	日本国登録実用新案公報	1994-2010年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2010年										
日本国実用新案登録公報	1996-2010年										
日本国登録実用新案公報	1994-2010年										
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
Y A	JP 2005-74034 A (オリンパス株式会社) 2005.03.24, 全文全図 & JP 2006-68488 A & US 2005/0124858 A1 & US 2007/0055105 A1 & US 2008/0146877 A1	1-12, 16-21 13-15									
Y	JP 2007-21039 A (オリンパス株式会社) 2007.02.01, 段落【0058】-【0061】 & US 2008/0167523 A1 & EP 1905345 A1 & WO 2007/010997 A & WO 2007/010997 A1 & CN 101203169 A	1-3, 6-9, 19									
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。											
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献									
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの									
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの									
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの									
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」同一パテントファミリー文献									
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願											
国際調査を完了した日 04.02.2010		国際調査報告の発送日 16.02.2010									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 谷垣 圭二	2Q 3010								
		電話番号 03-3581-1101 内線 3292									

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 9 / 0 6 9 4 3 5
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2006-75331 A (三菱電機株式会社) 2006.03.23, 段落【0031】 & US 2006/0050145 A1 & KR 10-2006-0051099 A & CN 1745695 A	1-12, 16-19
Y	JP 2006-122502 A (オリンパス株式会社) 2006.05.18, 段落【0040】-【0043】 【0123】 & US 2007/0191677 A1 & EP 1806091 A1 & WO 2006/046637 A1 & CN 101043841 A	20, 21

## フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

Fターム(参考) 4C061 AA03 CC06 LL02 QQ02 QQ06 QQ07 RR02 RR22 RR23 TT01  
UU06 WW20  
4C161 AA03 CC06 LL02 QQ02 QQ06 QQ07 RR02 RR22 RR23 TT01  
UU06 WW20

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	图像处理系统，图像捕获设备，接收设备和图像显示设备		
公开(公告)号	<a href="#">JPWO2010055938A1</a>	公开(公告)日	2012-04-12
申请号	JP2010537825	申请日	2009-11-16
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	田村和昭 森健 内山昭夫		
发明人	田村 和昭 森 健 内山 昭夫		
IPC分类号	A61B1/00		
CPC分类号	A61B1/041 A61B1/045 A61B1/0607 A61B2576/00 G02B23/24 G06T1/0007 G16H30/40		
FI分类号	A61B1/00.320.B A61B1/00.300.D		
F-TERM分类号	4C061/AA03 4C061/CC06 4C061/LL02 4C061/QQ02 4C061/QQ06 4C061/QQ07 4C061/RR02 4C061/RR22 4C061/RR23 4C061/TT01 4C061/UU06 4C061/MW20 4C161/AA03 4C161/CC06 4C161/LL02 4C161/QQ02 4C161/QQ06 4C161/QQ07 4C161/RR02 4C161/RR22 4C161/RR23 4C161/TT01 4C161/UU06 4C161/MW20		
代理人(译)	酒井宏明		
优先权	2008293834 2008-11-17 JP		
其他公开文献	JP5277253B2		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

图像处理系统 (100) 包括图像产生单元 (101)，图像产生单元 (101) 具有至少两个观察模式并以其中一种观察模式产生图像。亮度检测单元 (106) 检测由图像生成单元 (101) 以一种观察模式生成的图像的亮度；控制单元 (107) 基于由亮度检测单元 (106) 检测到的图像的亮度来控制图像生成单元 (101) 的另一观察模式下的图像生成。

