

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2015-80620

(P2015-80620A)

(43) 公開日 平成27年4月27日(2015.4.27)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 Y	4 C 1 6 1
A 6 1 B 1/06 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 U	
	A 6 1 B 1/06 A	
	A 6 1 B 1/00 3 0 0 P	

審査請求 未請求 請求項の数 13 O L (全 11 頁)

(21) 出願番号	特願2013-220192 (P2013-220192)	(71) 出願人	000000376
(22) 出願日	平成25年10月23日 (2013.10.23)		オリンパス株式会社
			東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
		(74) 代理人	100076233
			弁理士 伊藤 進
		(74) 代理人	100101661
			弁理士 長谷川 靖
		(74) 代理人	100135932
			弁理士 篠浦 治
		(72) 発明者	中島 翔
			東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
			リンパスメディカルシステムズ株式会社内
		Fターム(参考)	4C161 BB02 CC07 FF40 FF46 FF47
			GG01 JJ11 MM05 QQ01 QQ09
			RR19 UU05


(54) 【発明の名称】 走査型内視鏡の光射出プローブ及び走査型内視鏡

(57) 【要約】

【課題】使用中に照明レンズの汚れの影響に左右されずに、常に適した明るさで被写体を撮像することができる走査型内視鏡の光射出プローブを提供する。

【解決手段】内視鏡2の挿入部10は、先端に照明レンズが設けられた筒状体40aと、レーザ光源31から発せられる照明光を照明レンズを介して観察対象部位に向けて射出する光ファイバ14と、光ファイバ14と共に振動し、光ファイバ14により射出される照明光が観察対象部位で走査するよう、光ファイバ14を径方向に駆動するアクチュエータ15と、筒状体40aに連設され、アクチュエータ15と光ファイバ14とを収納する筒状体40bと、アクチュエータ15の振動を、筒状体40bを介して筒状体40aに設けられた照明レンズに伝達する弾性体45及び46と、を有する。

【選択図】図2

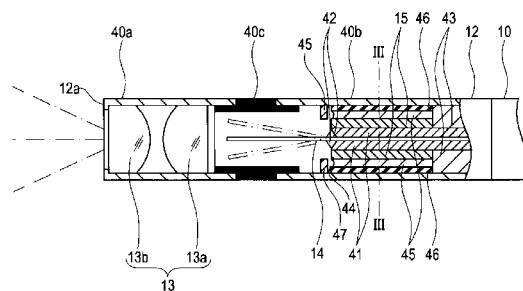

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

先端に照明レンズが設けられた筒状体と、
前記筒状体内に設けられ、光源から発せられる照明光を前記照明レンズを介して観察対象部位に向けて射出する光ファイバと、
前記光ファイバと共に振動し、該光ファイバにより射出される前記照明光が前記観察対象部位で走査するよう、前記光ファイバを径方向に駆動する駆動部と、
前記筒状体に連設され、前記駆動部と前記光ファイバとを収納する外装体と、
前記駆動部の振動を、前記外装体を介して前記筒状体に設けられた照明レンズに伝達する振動伝達部と、
を備えることを特徴とする走査型内視鏡の光射出プローブ。

10

【請求項 2】

前記振動伝達部は、前記駆動部の動作に応じて弾性変形するとともに、該弾性変形する際に発生する力を前記外装体に伝達する弾性体を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の走査型内視鏡の光射出プローブ。

【請求項 3】

前記振動伝達部は、前記光ファイバを保持するフェルールと前記外装体の内面との間に前記弾性体を充填するための充填部を含むことを特徴とする請求項 2 に記載の走査型内視鏡の光射出プローブ。

【請求項 4】

前記振動伝達部は、前記充填部の端部において、前記弾性体が振動により変形して流出することを防止する流出防止部を更に備えることを特徴とする請求項 3 に記載の走査型内視鏡の光射出プローブ。

20

【請求項 5】

前記流出防止部は、前記外装体の内面から前記光ファイバの中心方向に向けて突出させた壁面を含むことを特徴とする請求項 4 に記載の走査型内視鏡の光射出プローブ。

【請求項 6】

前記流出防止部は、前記外装体の内面から前記フェルールにかけて前記充填部の端部を覆う、前記弾性体より弾性の低い第 2 の弾性体を含むことを特徴とする請求項 4 に記載の走査型内視鏡の光射出プローブ。

30

【請求項 7】

前記駆動部は、前記光ファイバを保持するフェルールを取り囲むように複数配置された圧電素子を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の走査型内視鏡の光射出プローブ。

【請求項 8】

前記振動伝達部は、前記外装体の内面と前記フェルール及び該フェルールに取り付けられた圧電素子との間に、前記駆動部の動作に応じて弾性変形するとともに、該弾性変形する際に発生する力を前記外装体に伝達する弾性体を充填した充填部を含むことを特徴とする請求項 7 に記載の走査型内視鏡の光射出プローブ。

【請求項 9】

前記充填部は、前記外装体の内面側と前記フェルール及び前記圧電素子側とで弾性を変えた複層構造を含むことを特徴とする請求項 8 に記載の走査型内視鏡の光射出プローブ。

40

【請求項 10】

前記複層構造を含む充填部は、前記フェルール及び前記圧電素子側より前記外装体の内面側の方が弾性が高い層が形成されることを特徴とする請求項 9 に記載の走査型内視鏡の光射出プローブ。

【請求項 11】

前記外装体と前記筒状体との接続部、又は前記筒状体内面と前記照明レンズとの接続部のうち少なくとも 1 つには、前記駆動部が前記光ファイバを駆動する際の振動周波数と異なる周波数で前記照明レンズを振動させるように、前記弾性体と弾性が異なる第 3 の弾性体を含む第 2 の振動伝達部が設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の走査型内

50

視鏡の光射出プローブ。

【請求項 1 2】

請求項 1 に記載の走査型内視鏡の光射出プローブと、
前記光ファイバから射出されて前記観察対象部位で反射した戻り光を受光する受光ファイバと、
を備えることを特徴とする走査型内視鏡。

【請求項 1 3】

前記光ファイバの中心軸と前記照明レンズの中心軸とが一致するタイミングで画像のサンプリングを行うことを特徴とする請求項 1 2 に記載の走査型内視鏡。

【発明の詳細な説明】

10

【技術分野】

【0001】

本発明は、レーザ光を走査させる走査型内視鏡の光射出プローブ及び走査型内視鏡に関する。

【背景技術】

【0002】

周知の如く、CCD、CMOS等の固体撮像素子を有した撮像装置により被検体像を光電変換して、モニタに取得画像を表示する電子内視鏡がある。近年、このような固体撮像素子の技術を用いず、被写体像を画像表示する装置として、走査型内視鏡がある。この走査型内視鏡は、光源からの照明光を導光する照明ファイバの先端を走査させ、被検体からの戻り光を照明ファイバの周囲に配置された光ファイババンドルで受光し、経時的に検出した光強度信号を用いて被写体像を画像化する。

20

【0003】

この走査型内視鏡は、照明ファイバを変位させて照明光を走査させるアクチュエータ等の駆動部を挿入部の先端部に設け、挿入部の先端の照明レンズからレーザ光等の照明光を照射することで、被写体を照明する。

【0004】

例えば、特許文献 1 には、照明光を体腔内まで伝送するシングルモードファイバを備え、このシングルモードファイバの先端を共振させた状態で照明光を射出することにより、対象物を所定の走査パターンで走査する走査型医療用プローブが開示されている。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献 1】特開 2011 - 115252 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら、このような走査型医療用プローブを、例えば体腔内等の物質が付着しやすい部分に対して用いると、照明レンズに物質が汚れとして付着し、照明光が遮られてしまう。また、この汚れが照明レンズに付着したままにしておくと、照明光の熱によって、汚れが照明レンズに焼き付いてしまうという問題がある。

40

【0007】

さらに、照明レンズに付着した汚れの影響が無視できる程度に照明光の光量を上げると、被写体に対して規定以上のレーザ光量が照射される虞がある。

【0008】

そこで、本発明は、使用中に照明レンズの汚れの影響に左右されずに、常に適した明るさで被写体を撮像することができる走査型内視鏡の光射出プローブ及び走査型内視鏡を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

50

本発明の一態様の走査型内視鏡の光射出プローブは、先端に照明レンズが設けられた筒状体と、前記筒状体内に設けられ、光源から発せられる照明光を前記照明レンズを介して観察対象部位に向けて射出する光ファイバと、前記光ファイバと共に振動し、該光ファイバにより射出される前記照明光が前記観察対象部位で走査するよう、前記光ファイバを径方向に駆動する駆動部と、前記筒状体に連設され、前記駆動部と前記光ファイバとを収納する外装体と、前記駆動部の振動を、前記外装体を介して前記筒状体に設けられた照明レンズに伝達する振動伝達部と、を有する。

【 0 0 1 0 】

また、本発明の一態様の走査型内視鏡は、先端に照明レンズが設けられた筒状体と、前記筒状体内に設けられ、光源から発せられる照明光を前記照明レンズを介して観察対象部位に向けて射出する光ファイバと、前記光ファイバと共に振動し、該光ファイバにより射出される前記照明光が前記観察対象部位で走査するよう、前記光ファイバを径方向に駆動する駆動部と、前記筒状体に連設され、前記駆動部と前記光ファイバとを収納する外装体と、前記駆動部の振動を、前記外装体を介して前記筒状体に設けられた照明レンズに伝達する振動伝達部と、を有する走査型内視鏡の光射出プローブと、前記光ファイバから射出されて前記観察対象部位で反射した戻り光を受光する受光ファイバと、を有する。

10

【発明の効果】

【 0 0 1 1 】

本発明によれば、使用中に照明レンズの汚れの影響に左右されずに、常に適した明るさで被写体を撮像することができる走査型内視鏡の光射出プローブ及び走査型内視鏡を提供することができる。

20

【図面の簡単な説明】

【 0 0 1 2 】

【図 1】第 1 の実施の形態に係る内視鏡装置の構成を示す図である。

【図 2】第 1 の実施の形態に係る挿入部の先端部の構成について説明するための断面図である。

【図 3】図 2 の III - III 線に沿う断面図である。

【図 4】第 2 の実施の形態に係る挿入部の先端部の構成について説明するための断面図である。

【図 5】図 4 の V - V 線に沿う断面図である。

30

【図 6】光ファイバの中心軸と先端光学系の中心軸との関係を説明するための図である。

【図 7】先端光学系の振動波形の例を説明するための図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 1 3 】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

【 0 0 1 4 】

(第 1 の実施の形態)

まず、図 1 を用いて、第 1 の実施の形態の内視鏡装置の全体構成について説明する。

【 0 0 1 5 】

図 1 は、第 1 の実施の形態に係る内視鏡装置の構成を示す図である。

40

【 0 0 1 6 】

図 1 に示すように、走査型内視鏡装置としての内視鏡装置 1 は、レーザ光（照明光）を走査させながら被検体に照射し、被検体からの戻り光を得る走査型の内視鏡 2 と、この内視鏡 2 に接続される本体装置 3 と、本体装置 3 で得られる被検体像を表示するモニタ 4 とを有して構成されている。

【 0 0 1 7 】

走査型内視鏡としての内視鏡 2 は、所定の可撓性を備えたチューブ体を主体として構成され、生体内に挿通される細長な挿入部 10 を有する。走査型内視鏡の光射出プローブとしての挿入部 10 の基端側は、コネクタ 11 が設けられており、内視鏡 2 は、このコネクタ 11 を介して、本体装置 3 と着脱自在に構成されている。また、挿入部 10 の先端側に

50

は、先端部 12 が設けられている。

【0018】

先端部 12 の先端面 12a には、照明レンズ 13a 及び 13b により構成される先端光学系 13 が設けられている。また、挿入部 10 の内部には、基端側から先端側へ挿通され、後述する光源ユニット 24 からの光を導光し、生体にレーザ光を照射する光学素子としての光ファイバ 14 と、光ファイバ 14 の先端側に設けられ、後述するドライバユニット 25 からの駆動信号に基づき、光ファイバ 14 の先端を所望の方向に走査させるアクチュエータ 15 とが設けられている。このような構成により、照明ファイバとしての光ファイバ 14 によって導光された光源ユニット 24 からのレーザ光が被写体に照射される。

【0019】

また、挿入部 10 の内部には、挿入部 10 の内周に沿って基端側から先端側へ挿通され、被検体からの戻り光を受光する受光ファイバとしての検出ファイバ 16 が設けられている。検出ファイバ 16 の先端面は、先端部 12 の先端面 12a の先端光学系 13 の周囲に配置される。この検出ファイバ 16 は、少なくとも 2 本以上のファイババンドルであってもよい。内視鏡 2 が本体装置 3 に接続された際に、検出ファイバ 16 は後述する分波器 36 に接続される。

【0020】

また、挿入部 10 の内部には、内視鏡 2 に関する各種情報を記憶したメモリ 17 が設けられている。メモリ 17 は、内視鏡 2 が本体装置 3 に接続された際に、図示しない信号線を介して、後述するコントローラ 23 に接続され、内視鏡 2 に関する各種情報がコントローラ 23 によって読み出される。

【0021】

光ファイバ 14 には、コネクタ 11 から先端部 12 のアクチュエータ 15 にかけて、例えば線状の金属で構成された複数の導線 18 が蒸着されている。複数の導線 18 の先端にはアクチュエータ 15 が設けられている。そして、これらの複数の導線 18 は、コネクタ 11 が本体装置 3 に装着された際に、本体装置 3 のアンプ 35 に接続される。これらの複数の導線 18 は、アクチュエータ 15 を駆動するための駆動信号を導電する導電部を構成する。

【0022】

本体装置 3 は、電源 21 と、メモリ 22 と、コントローラ 23 と、光源ユニット 24 と、ドライバユニット 25 と、検出ユニット 26 とを有して構成されている。

【0023】

光源ユニット 24 は、レーザ光源 31 を有して構成されている。また、ドライバユニット 25 は、信号発生器 33 と、デジタルアナログ（以下、D/A という）変換器 34a 及び 34b と、アンプ 35 とを有して構成されている。

【0024】

検出ユニット 26 は、分波器 36 と、検出器 37a ~ 37c と、アナログデジタル（以下、A/D という）変換器 38a ~ 38c とを有して構成されている。

【0025】

電源 21 は、図示しない電源スイッチ等の操作に応じて、コントローラ 23 への電源の供給を制御する。メモリ 22 には、本体装置 3 全体の制御を行うための制御プログラム等が記憶されている。

【0026】

コントローラ 23 は、電源 21 から電源が供給されると、メモリ 22 から制御プログラムを読み出し、光源ユニット 24、ドライバユニット 25 の制御を行うとともに、検出ユニット 26 で検出された被写体からの戻り光の光強度の解析を行い、得られた被写体像をモニタ 4 に表示させる制御を行う。

【0027】

光源ユニット 24 のレーザ光源 31 は、コントローラ 23 の制御に基づき、所定の波長帯域のレーザ光（照明光）を光ファイバ 14 に出射する。この光ファイバ 14 は、レーザ

10

20

30

40

50

光源 31 からのレーザ光（照明光）を対象物に出射する。より具体的には、光ファイバ 14 は、後述する筒状体 40 内に設けられ、レーザ光源 31 から発せられる照明光を照明レンズ 13a 及び 13b を介して観察対象部位に向けて射出する。

【0028】

ドライバユニット 25 の信号発生器 33 は、コントローラ 23 の制御に基づき、光ファイバ 14 の先端を所望の方向、例えば、螺旋状に走査（スキャン駆動）させるための駆動信号を出力する。具体的には、信号発生器 33 は、光ファイバ 14 の先端を挿入部 10 の挿入軸に対して左右方向（X 軸方向）に駆動させる駆動信号を D/A 変換器 34a に出力し、挿入部 10 の挿入軸に対して上下方向（Y 軸方向）に駆動させる駆動信号を D/A 変換器 34b に出力する。

10

【0029】

D/A 変換器 34a 及び 34b は、それぞれ入力された駆動信号をデジタル信号からアナログ信号に変換し、アンプ 35 に出力する。アンプ 35 は、入力された駆動信号を増幅してアクチュエータ 15 に出力する。アンプ 35 から出力された駆動信号は、光ファイバ 14 に蒸着されている複数の導線 18 を介してアクチュエータ 15 に供給される。

【0030】

アクチュエータ 15 は、アンプ 35 からの駆動信号に基づいて、光ファイバ 14 の先端（自由端）を揺動させ、螺旋状に走査させる。より具体的には、駆動部としてのアクチュエータ 15 は、光ファイバ 14 と共に振動し、光ファイバ 14 により射出される照明光が観察対象部位で走査するよう、光ファイバ 14 を径方向に駆動する。これにより、光源ユニット 24 のレーザ光源 31 から光ファイバ 14 に出射された光は、被検体に対して螺旋状に順次照射される。なお、光ファイバ 14 の先端は、振動するとき、厳密には後述するフェルール 41 の先端部で保持された光ファイバ 14 の中心を中心にした球の周面を走査することになるが、実際の走査範囲は非常に狭いため、ある平面上を走査するものと近似することができる。

20

【0031】

検出ファイバ 16 は、被検体の表面領域で反射された戻り光を受光し、受光した戻り光を分波器 36 に導光する。

【0032】

分波器 36 は、例えば、ダイクロイックミラー等であり、所定の波長帯域で戻り光を分波する。具体的には、分波器 36 は、検出ファイバ 16 により導光された戻り光を、R, G, B の波長帯域の戻り光に分波し、それぞれ検出器 37a、37b 及び 37c に出力する。

30

【0033】

検出器 37a、37b 及び 37c は、それぞれ R, G, B の波長帯域の戻り光の光強度を検出する。検出器 37a、37b 及び 37c で検出された光強度の信号は、それぞれ A/D 変換器 38、38b 及び 38c に出力される。

【0034】

A/D 変換器 38a ~ 38c は、それぞれ検出器 37a ~ 37c から出力された光強度の信号をアナログ信号からデジタル信号に変換し、コントローラ 23 に出力する。

40

【0035】

コントローラ 23 は、A/D 変換器 38a ~ 38c からのデジタル信号に所定の画像処理を施して被写体像を生成し、モニタ 4 に表示する。

【0036】

ここで、図 2 及び図 3 を用いて、挿入部 10 の先端部 12 の詳細な構成について説明する。図 2 は、第 1 の実施の形態に係る挿入部の先端部の構成について説明するための断面図であり、図 3 は、図 2 の III - III 線に沿う断面図である。

【0037】

図 2 に示すように、挿入部 10 の先端部 12 は、それぞれがステンレス等の金属部材で構成される筒状体 40a、筒状体 40b、及び、筒状体 40a 及び 40b を連結する筒状

50

体 4 0 c により構成される。なお、以下の説明では、筒状体 4 0 a、4 0 b、及び 4 0 c を単に筒状体 4 0 ともいう。また、筒状体 4 0 a 及び 4 0 b を接続する接続部としての筒状体 4 0 c は、金属部材に限定されることなく、後述する弾性体 4 5 及び 4 6 とは弾性が異なる弾性体を用いてもよい。

【 0 0 3 8 】

また、挿入部 1 0 の先端部 1 2 には、光ファイバ 1 4 と、アクチュエータ 1 5 との間に接合部材としてのフェルール 4 1 が配置されている。フェルール 4 1 は、光通信の分野で用いられる部材であり、材質はジルコニア（セラミック）、ニッケル等が用いられ、光ファイバ 1 4 の外径（例えば、 $125\mu\text{m}$ ）に対して高精度（例えば、 $\pm 1\mu\text{m}$ ）での中心孔加工が容易に実現できる。そして、フェルール 4 1 の略中心には、光ファイバ 1 4 の径に基づいた貫通孔が設けられ、中心孔加工が施され、光ファイバ 1 4 が接着剤等の固定部材 4 2 により固定される。

10

【 0 0 3 9 】

フェルール 4 1 は、四角柱の形状であり、アクチュエータ 1 5 は、図 3 に示すように、四角柱のフェルール 4 1 の各側面にそれぞれに配置される。また、フェルール 4 1 及び光ファイバ 1 4 は、先端部 1 2 において、固定部材 4 3 により、先端部 1 2 の略中央、より具体的には、筒状体 4 0 b の略中央に固定されている。このように、フェルール 4 1 は、アクチュエータ 1 5 が固着されるとともに、光ファイバ 1 4 の外周を把持する。

【 0 0 4 0 】

図 1 に示す複数の導線 1 8 は、図示を省略しているが、それぞれフェルール 4 1 の各側面に配置されたアクチュエータ 1 5 に接続されている。これにより、ドライバユニット 2 5 からの駆動信号が導線 1 8 を介してアクチュエータ 1 5 に供給されることになる。アクチュエータ 1 5 は、例えば、圧電素子（ピエゾ素子）であり、ドライバユニット 2 5 からの駆動信号に応じて伸縮する。これにより、光ファイバ 1 4 の先端を螺旋状に走査させることができる。そして、光ファイバ 1 4 から出射されるレーザ光は、先端光学系 1 3 で集光され、被写体に照射される。

20

【 0 0 4 1 】

この先端光学系 1 3（照明光学系）は、光ファイバ 1 4 と対向配置され、平凸レンズの照明レンズ 1 3 a と、凸平レンズの照明レンズ 1 3 b とから構成される。また、先端光学系 1 3 は、レーザ光源 3 1 側から平凸レンズの照明レンズ 1 3 a、凸平レンズの照明レンズ 1 3 b の順に配置されている。照明レンズ 1 3 a 及び 1 3 b は、筒状体 4 0 a 内の先端に設けられ、固定される。筒状体 4 0 a の先端面は開口しており、先端光学系 1 3 で集光されたレーザ光がこの開口から出射され、被写体に照射される。なお、先端光学系 1 3 は、2 枚の照明レンズ 1 3 a 及び 1 3 b で構成されているが、これに限定されるものではなく、1 枚あるいは 3 枚以上の照明レンズで構成されていてもよい。また、筒状体 4 0 a と照明レンズ 1 3 b とを接続する図示しない接続部に、後述する弾性体 4 5 及び 4 6 とは弾性が異なる弾性体を用いてもよい。

30

【 0 0 4 2 】

本実施の形態では、アクチュエータ 1 5 と、アクチュエータ 1 5 及び光ファイバ 1 4 を収納する外装体としての筒状体 4 0 b との間に、充填部 4 4 が設けられている。そして、アクチュエータ 1 5 と筒状体 4 0 b との間に設けられた充填部 4 4 に、複数の弾性体、すなわち、2 層以上の弾性体が設けられている。図 2 及び図 3 は、アクチュエータ 1 5 と筒状体 4 0 b との間に、弾性体 4 5 及び 4 6 の 2 層の弾性体が設けられている例であるが、3 層以上の弾性が設けられていてもよい。これらの弾性体 4 5 及び 4 6 は、アクチュエータ 1 5 の動作に応じて弾性変形するとともに、弾性変形した際に発生する力を筒状体 4 0 b に伝達する。また、これらの弾性体 4 5 及び 4 6 では、弾性に違いを持たせている。

40

【 0 0 4 3 】

具体的には、アクチュエータ 1 5 側に設けられている弾性体 4 5 は、アクチュエータ 1 5 の動作を妨げないように、例えば接着剤等の弾性の高い弾性体で構成されている。一方、筒状体 4 0 b 側に設けられている弾性体 4 6 は、筒状体 4 0 b に振動を効率的に伝達さ

50

せるために、例えばゴムチューブ等の、弾性体 4 5 よりも弾性の低い弾性体で構成されている。

【 0 0 4 4 】

なお、3 層以上の弾性体が設けられている場合、アクチュエータ 1 5 側から筒状体 4 0 b 側に向けて、弾性が順次低くなるような弾性体を用いるようにすればよい。これにより、アクチュエータ 1 5 の動作を妨げないようにするとともに、より効率的に筒状体 4 0 b に振動を伝達させることができる。

【 0 0 4 5 】

また、筒状体 4 0 b には、内面から光ファイバ 1 4 の中心方向に向けて突出させた壁面を含む係止部 4 7 が設けられている。この係止部 4 7 は、充填部 4 4 の端部において、弾性体 4 5 及び 4 6 が振動により変形して流出することを防止する。なお、壁面を含む係止部 4 7 に代えて、弾性体 4 5 及び 4 6 より弾性の低い弾性体で、筒状体 4 0 b の内面からフェルール 4 1 にかけて充填部 4 4 の端部を覆うようにしてもよい。

10

【 0 0 4 6 】

本実施の形態では、充填部 4 4、充填部 4 4 に充填された弾性体 4 5 及び 4 6、係止部 4 7 により振動伝達部が構成される。

【 0 0 4 7 】

次に、照明レンズ 1 3 b に汚れが付着した際の動作について説明する。

【 0 0 4 8 】

術者が内視鏡 2 の挿入部 1 0 を体腔内等に挿入し、被写体の観察をしていると、照明レンズ 1 3 b の平面に血液、脂肪、水滴、粘膜等の汚れが付着することがある。このような被写体の観察を行っている場合、ドライバユニット 2 5 からの駆動信号が信号線 1 8 を介してアクチュエータ 1 5 に供給される。そして、アクチュエータ 1 5 は、供給された駆動信号に応じて伸縮し、光ファイバ 1 4 の先端を螺旋状に走査させる。

20

【 0 0 4 9 】

このように、アクチュエータ 1 5 が駆動すると、その振動が弾性体 4 5、弾性体 4 6 を介して筒状体 4 0 b に伝搬する。このとき、弾性体 4 5 として、弾性が高い弾性体を用いることで、アクチュエータ 1 5 の駆動を妨げないようにしている。そして、弾性体 4 6 として、弾性体 4 5 より弾性が低い弾性体を用いることで、弾性体 4 6 の振動を筒状体 4 0 b に効率的に伝達させる。

30

【 0 0 5 0 】

そして、この振動は、筒状体 4 0 c を介して、照明レンズ 1 3 b が格納されている筒状体 4 0 a に伝搬し、筒状体 4 0 a に固定されている照明レンズ 1 3 b を振動させ、汚れの付着を防ぐようになっている。

【 0 0 5 1 】

以上のように、内視鏡 2 の挿入部 1 0 は、アクチュエータ 1 5 と筒状体 4 0 b との間に、アクチュエータ 1 5 の動作に応じて弾性変形する弾性体 4 5 及び 4 6 を設け、弾性変形した際に発生する力（振動）を筒状体 4 0 b、4 0 c を介して、照明レンズ 1 3 b が設けられている筒状体 4 0 a に伝達するようにした。この結果、筒状体 4 0 a に設けられた照明レンズ 1 3 b に汚れが付着した場合でも、伝達された振動により、照明レンズ 1 3 b に付着した汚れを落とすことができる。

40

【 0 0 5 2 】

よって、本実施の形態の走査型内視鏡の光射出プローブとしての挿入部 1 0 及び走査型内視鏡としての内視鏡 2 によれば、使用中に照明レンズの汚れの影響に左右されずに、常に適した明るさで被写体を撮像することができる。

【 0 0 5 3 】

また、本実施の形態の走査型内視鏡の光射出プローブとしての挿入部 1 0 及び走査型内視鏡としての内視鏡 2 によれば、光ファイバ 1 4 を走査させるためのアクチュエータ 1 5 の振動を利用して、照明レンズ 1 3 b の汚れを落とすようにしている。そのため、照明レンズ 1 3 b を振動させるための振動子や照明レンズ 1 3 を洗浄するための洗浄用ノズルを

50

挿入部 10 に新たに設ける必要がないため、挿入部 10 を細径化することができる。

【0054】

(第2の実施の形態)

次に、第2の実施の形態について説明する。

【0055】

図4は、第2の実施の形態に係る挿入部の先端部の構成について説明するための断面図であり、図5は、図4のV-V線に沿う断面図である。なお、図4及び図5において、それぞれ図2及び図3と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。

【0056】

第2の実施の形態では、第1の実施の形態の先端部12に代わり、先端部12bを用いて構成されている。そして、アクチュエータ15と筒状体40bとの間に、弾性体48が設けられている。この弾性体48は、ゴムチューブ、またはゴムチューブを設けずに筒状体40bに光ファイバ14、アクチュエータ15及びフェルル41を配置した後に充填させる接着剤等である。弾性体48は、アクチュエータ15の動作に応じて弾性変形するとともに、弾性変形した際に発生する力を筒状体40bに伝達する。その他の構成及び照明レンズ13bに汚れが付着した際の動作は、第1の実施の形態と同様である。

【0057】

よって、本実施の形態の走査型内視鏡の光射出プローブとしての挿入部10及び走査型内視鏡としての内視鏡2によれば、第1の実施の形態と同様に、使用中に照明レンズの汚れの影響に左右されずに、常に適した明るさで被写体を撮像することができる。

【0058】

(第3の実施の形態)

次に、第3の実施の形態について説明する。

【0059】

第3の実施の形態では、画像をサンプリングするタイミングについて説明する。なお、第3の実施の形態の内視鏡装置1の構成は、第1の実施の形態の内視鏡装置1の構成と同様のため、説明を省略する。

【0060】

図6は、光ファイバの中心軸と先端光学系の中心軸との関係を説明するための図である。

【0061】

正確な画像化を行うために、図6(a)に示すように、光ファイバ14の中心軸50と先端光学系13(照明レンズ13a及び13b)の中心軸51とが一致するように、光学設計が行われている。しかしながら、アクチュエータ15を駆動して、光ファイバ14を螺旋駆動させる場合、筒状体40aの振動に合わせて先端光学系13も振動する。この場合、図6(b)に示すように、光ファイバ14の中心軸50と先端光学系13の中心軸51とが一致しなくなる。このような光学設計のずれが生じると、正確な画像化が行えなくなる。

【0062】

そこで、光ファイバ14の中心軸50と先端光学系13の中心軸51とが一致しているときのみ画像のサンプリングを行い、一致していないときは画像のサンプリングを行わないようにする。

【0063】

図7は、先端光学系の振動波形の例を説明するための図である。

【0064】

図7において、縦軸は先端光学系13の照明レンズ13bの位置を示し、横軸は時間を示しており、照明レンズ13bの位置が0のとき、光ファイバ14の中心軸50と先端光学系13の中心軸51とが一致する。すなわち、画像のサンプリングの時間を図7に示すグラフの照明レンズ13bの位置が0のときのタイミング(具体的には、時間t0、t1、t2、...)に同期させる。この結果、光ファイバ14の中心軸50と先端光学系1

3の中心軸51とが一致しているときのみ、画像化に必要な情報を取得することができるため、正確な画像化が行える。

【0065】

よって、本実施の形態の走査型内視鏡の光射出プローブとしての挿入部10及び走査型内視鏡としての内視鏡2によれば、第1の実施の形態と同様の効果を有するとともに、正確な画像化を行うことができるという効果を有する。

【0066】

本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。

【符号の説明】


【0067】

1...内視鏡装置、2...内視鏡、3...本体装置、4...モニタ、10...挿入部、11...コネクタ、12, 12b, 12c, 12d...先端部、12a...先端面、13...先端光学系、13a, 13b...照明レンズ、14...光ファイバ、15...アクチュエータ、16...検出ファイバ、17...メモリ、18...導線、21...電源、22...メモリ、23...コントローラ、24...光源ユニット、25...ドライバユニット、26...検出ユニット、31...レーザ光源、33...信号発生器、34a~34c...D/A変換器、35...アンプ、36...分波器、37a~37c...検出器、38a~38c...A/D変換器、40a, 40b, 40c...筒状体、41...フェルール、42, 43...固定部材、44...充填部、45, 46, 48...弾性体、47...係止部、50, 51...中心軸。


10

20


【図1】

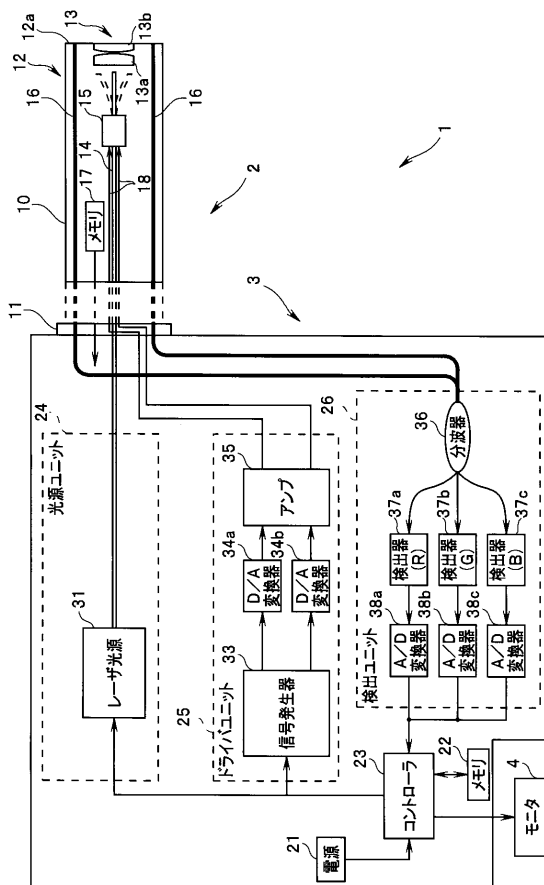


【図2】

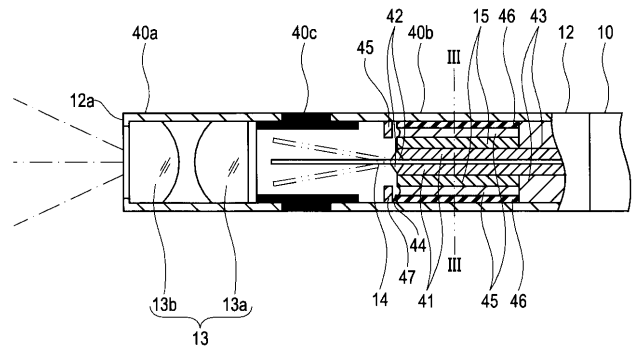


【図 3】

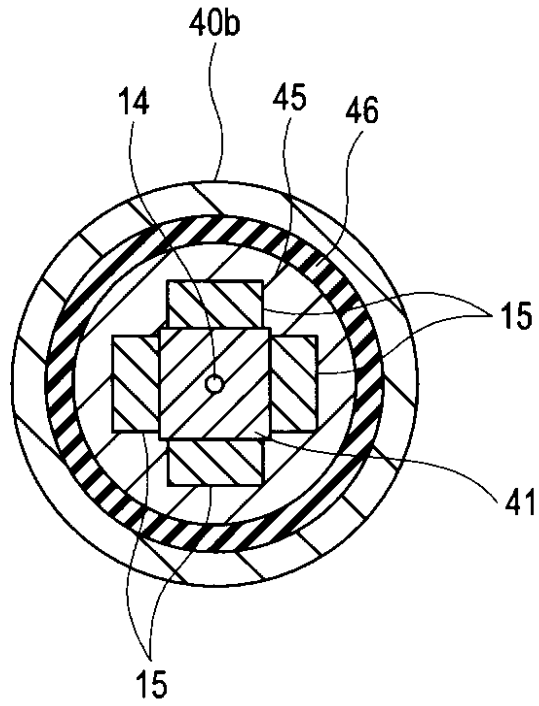


【図 4】

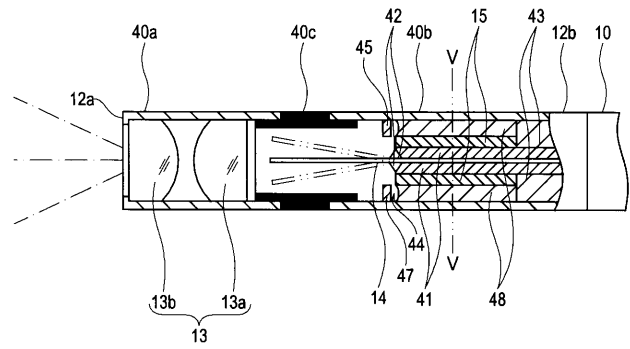


【図 5】

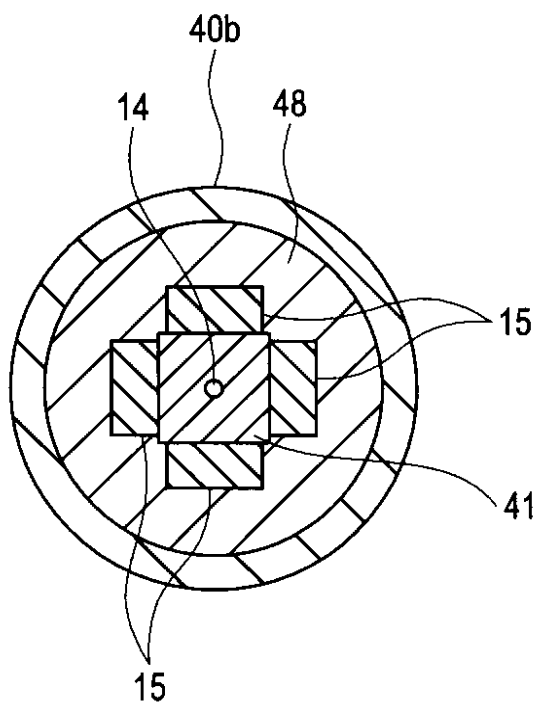

【図 6】

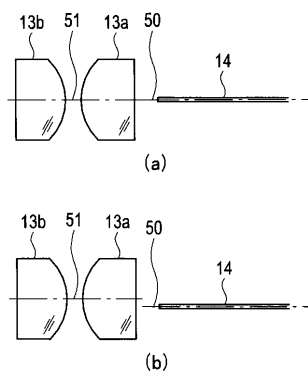

【図 7】

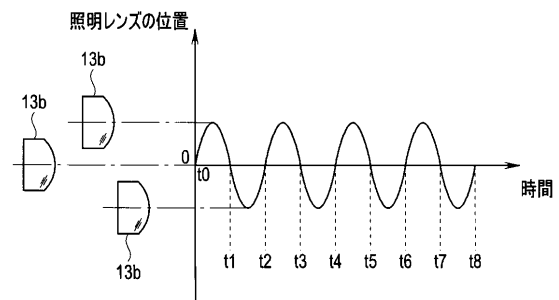

专利名称(译)	扫描内窥镜和扫描内窥镜的发光探头		
公开(公告)号	JP2015080620A	公开(公告)日	2015-04-27
申请号	JP2013220192	申请日	2013-10-23
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	中島翔		
发明人	中島 翔		
IPC分类号	A61B1/00 A61B1/06		
FI分类号	A61B1/00.300.Y A61B1/00.300.U A61B1/06.A A61B1/00.300.P A61B1/00.524 A61B1/00.715 A61B1/00.731 A61B1/00.732 A61B1/045.610 A61B1/07.730 A61B1/07.733 A61B1/12.530		
F-TERM分类号	4C161/BB02 4C161/CC07 4C161/FF40 4C161/FF46 4C161/FF47 4C161/GG01 4C161/JJ11 4C161/MM05 4C161/QQ01 4C161/QQ09 4C161/RR19 4C161/UU05		
代理人(译)	伊藤 进 长谷川 靖 ShinoUra修		
其他公开文献	JP6210837B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种扫描内窥镜的发光探针，其能够在使用期间始终以适当的亮度捕获被摄体的图像而不会受到照明透镜的污物的影响。内窥镜（2）的插入部（10）从具有顶端的照明透镜和激光光源（31）的圆柱体（40a）经由照明透镜射出照明光。光纤14，致动器15沿径向方向驱动光纤14，并与光纤14一起振动，并且致动器15连接至管状体40a，从而由光纤14发出的照明光扫描观察对象部位。并容纳有致动器15和光纤14的管状体40b，以及经由管状体40b将致动器15的振动传递到设置在管状体40a上的照明透镜的弹性体45和46。用。[选择图]图2

