

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02018/070509

発行日 令和1年7月4日(2019.7.4)

(43) 国際公開日 平成30年4月19日(2018.4.19)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード(参考)
A 6 1 B 1/018 (2006.01)	A 6 1 B 1/018 5 1 4	2 H 0 4 0
G 0 2 B 23/24 (2006.01)	G 0 2 B 23/24 A	4 C 1 6 1

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 28 頁)

出願番号	特願2018-545070 (P2018-545070)	(71) 出願人	000113263 H O Y A 株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目 1 〇 番 1 号
(21) 国際出願番号	PCT/JP2017/037111	(74) 代理人	100114557 弁理士 河野 英仁
(22) 国際出願日	平成29年10月13日(2017.10.13)	(74) 代理人	100078868 弁理士 河野 登夫
(31) 優先権主張番号	特願2016-202919 (P2016-202919)	(72) 発明者	細越 泰嗣 東京都新宿区西新宿六丁目 1 〇 番 1 号 H O Y A 株式会社内
(32) 優先日	平成28年10月14日(2016.10.14)	(72) 発明者	齋藤 恵一 東京都新宿区西新宿六丁目 1 〇 番 1 号 H O Y A 株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	Fターム(参考)	2H040 DA52

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 起上台および内視鏡

(57) 【要約】

内視鏡先端への着脱が容易な起上台等を提供すること

。

起上台(80)は、内視鏡(10)の挿入部(30)の先端に回動可能に設けられたレバー(60)と、該レバー(60)を回動させる回動部(24)とを備える内視鏡(10)に着脱可能な起上台において、一面に窪み部(84)を有する第1起上部(831)と、前記第1起上部(831)の端から突出する第2起上部(832)と、前記第2起上部(832)の端部に設けられており、前記レバー(60)に連結するレバー連結部(81)とを備える。

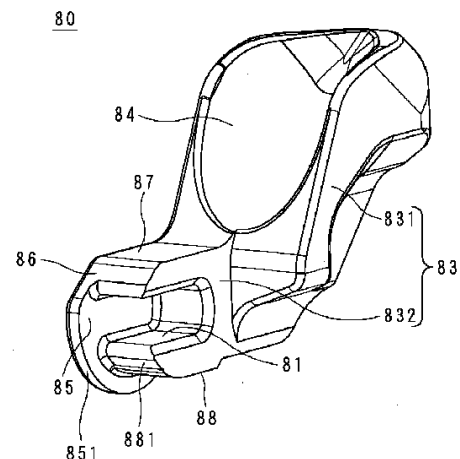

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

内視鏡の挿入部の先端に回動可能に設けられたレバーと、該レバーを回動させる回動部とを備える内視鏡に着脱可能な起上台において、

一面に窪み部を有する第 1 起上部と、

前記第 1 起上部の端から突出する第 2 起上部と、

前記第 2 起上部の端部に設けられており、前記レバーに連結するレバー連結部とを備える起上台。

【請求項 2】

前記レバー連結部は、前記第 2 起上部の先端側に開口を有する U 字型の溝であり、

前記第 2 起上部は、前記溝の一方の端面を覆う板状部を有する

請求項 1 に記載の起上台。

【請求項 3】

前記内視鏡の先端部に着脱可能な有底筒型のカバーの内部に設けられた起上台取付孔に回動可能に取付可能な起上台軸を有する

請求項 1 または請求項 2 に記載の起上台。

【請求項 4】

挿入部の先端の表面に露出する回動可能な起上台連結部と、

一面にスプーン状の窪み部を有する第 1 起上部と、前記第 1 起上部の端から前記窪み部と同じ側に突出する第 2 起上部と、前記第 2 起上部の端部に設けられており、前記起上台連結部に連結するレバー連結部とを備える起上台と、

を備える内視鏡。

【請求項 5】

前記起上台は、前記内視鏡の先端部に着脱可能な有底筒型のカバーの内部に設けられた起上台取付孔に回動可能に取付可能な起上台軸を有する

請求項 4 に記載の内視鏡。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、起上台および内視鏡に関する。

【背景技術】**【0002】**

挿入部の内部を通るチャンネルの先端に起上台を有する内視鏡が使用されている。起上台は、チャンネルに通した処置具等を屈曲させて、所望の向きに誘導する際に使用される。

【0003】

起上台を動かす起上ワイヤと起上台との間に壁を設けた内視鏡が開示されている（特許文献 1）。

【先行技術文献】**【特許文献】****【0004】**

【特許文献 1】特開平 8 - 5 6 9 0 0 号公報

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0005】**

特許文献 1 に開示された内視鏡では、起上台の周囲の構造が複雑なため、洗浄に手間が掛かる。

【0006】

一つの側面では、内視鏡先端への着脱が容易な起上台等を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

10

20

30

40

50

【 0 0 0 7 】

起上台は、内視鏡の挿入部の先端に回転可能に設けられたレバーと、該レバーを回転させる回転部とを備える内視鏡に着脱可能な起上台において、一面に窪み部を有する第 1 起上部と、前記第 1 起上部の端から突出する第 2 起上部と、前記第 2 起上部の端部に設けられており、前記レバーに連結するレバー連結部とを備える。

【 発明の効果 】

【 0 0 0 8 】

一つの側面では、内視鏡先端への着脱が容易な起上台等を提供することができる。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 0 9 】

10

【 図 1 】 内視鏡の外観図である。

【 図 2 】 挿入部の先端の斜視図である。

【 図 3 】 挿入部の先端から処置具先端部が突出した状態を示す説明図である。

【 図 4 】 挿入部の先端の正面図である。

【 図 5 】 内視鏡用キャップを挿入部の先端から取り外した状態を説明する正面図である。

【 図 6 】 内視鏡用キャップを挿入部の先端から取り外した状態を説明する背面図である。

【 図 7 】 内視鏡用キャップを取り外した挿入部の先端の斜視図である。

【 図 8 】 内視鏡用キャップおよびレバー室蓋を取り外した挿入部の先端の斜視図である。

【 図 9 】 内視鏡用キャップを内視鏡への取付側からみた斜視図である。

【 図 1 0 】 内視鏡用キャップをカバーの底側からみた斜視図である。

20

【 図 1 1 】 起上台の斜視図である。

【 図 1 2 】 起上台の正面図である。

【 図 1 3 】 起上台の側面図である。

【 図 1 4 】 台座の斜視図である。

【 図 1 5 】 起上台と台座とを組み付けた正面図である。

【 図 1 6 】 起上台と台座とを組み付けた背面図である。

【 図 1 7 】 図 5 の X V I I - X V I I 線による内視鏡用キャップの断面図である。

【 図 1 8 】 レバーの斜視図である。

【 図 1 9 】 図 4 の X I X - X I X 線による挿入部の断面図である。

【 図 2 0 】 図 4 の X X - X X 線による挿入部の断面図である。

30

【 図 2 1 】 起上台を起上した挿入部の断面図である。

【 図 2 2 】 実施の形態 2 の挿入部の断面図である。

【 図 2 3 】 図 2 2 の X X I I I - X X I I I 線による挿入部の断面図である。

【 図 2 4 】 実施の形態 3 の挿入部の断面図である。

【 図 2 5 】 実施の形態 4 の挿入部の先端の正面図である。

【 図 2 6 】 実施の形態 5 の挿入部の先端の正面図である。

【 発明を実施するための形態 】

【 0 0 1 0 】

[実施の形態 1]

図 1 は、内視鏡の外観図である。本実施の形態の内視鏡 1 0 は、上部消化管向けの軟性鏡である。内視鏡 1 0 は、操作部 2 0 および挿入部 3 0 を有する。操作部 2 0 は、起上操作レバー 2 1、チャンネル入口 2 2 および湾曲ノブ 2 3 を有する。操作部 2 0 は、図示しないビデオプロセッサ、光源装置および表示装置等に接続されている。

40

【 0 0 1 1 】

挿入部 3 0 は長尺であり、一端が操作部 2 0 に接続されている。挿入部 3 0 は、操作部 2 0 側から順に軟性部 1 2、湾曲部 1 3 および内視鏡用キャップ 5 0 を有する。軟性部 1 2 は、軟性である。湾曲部 1 3 は、湾曲ノブ 2 3 の操作に応じて湾曲する。内視鏡用キャップ 5 0 は、湾曲部 1 3 に連続する硬性の先端部 3 1 (図 2 参照) を覆っている。

【 0 0 1 2 】

本実施の形態の内視鏡 1 0 は、内視鏡用キャップ 5 0 を先端部 3 1 から着脱することが

50

可能である。内視鏡用キャップ５０は、外装部材であるカバー５２および起上台８０（図２参照）を有する。内視鏡用キャップ５０の構成の詳細については後述する。

【００１３】

以後の説明では、挿入部３０の長手方向を挿入方向と記載する。同様に、挿入方向に沿って操作部２０に近い側を操作部側、操作部２０から遠い側を先端側と記載する。

【００１４】

図２は、挿入部３０の先端の斜視図である。図３は、挿入部３０の先端から処置具先端部４１が突出した状態を示す説明図である。図１から図３を使用して、本実施の形態の内視鏡１０の構成を説明する。

【００１５】

湾曲部１３の先端に配置された先端部３１は、一方の側に挿入方向に沿って並んだ観察窓３６および照明窓３７を有する。照明窓３７は、観察窓３６よりも先端側に配置されている。先端部３１は、他方の側の操作部側に、チャンネル出口３５を有する。チャンネル出口３５の先端側に、起上部８３が配置されている。先端部３１を覆うカバー５２は、観察窓３６、照明窓３７および起上部８３に対応する部分に略長方形の窓部５３を有する。窓部５３の操作部側の辺は、起上部８３側が操作部側に、観察窓３６側が先端側にそれぞれ位置する一段の階段状であり、中央部分にストッパ部５３１を有する。

【００１６】

照明窓３７は、図示しない光源装置から出射した照明光を照射する。観察窓３６を通して、照明光により照らされた範囲を光学観察することが可能である。本実施の形態の内視鏡１０は、光学観察が可能な視野方向が挿入方向に対して交差する方向である、いわゆる側視型である。内視鏡１０は、視野方向が若干先端側に傾いた前方斜視型、または視野方向が若干操作部側に傾いた後方斜視型であっても良い。

【００１７】

チャンネル入口２２とチャンネル出口３５との間は、軟性部１２および湾曲部１３の内部を通るチャンネル３４により接続されている。チャンネル入口２２から処置具４０を処置具先端部４１側から挿入することにより、チャンネル出口３５から処置具先端部４１を突出させることができる。

【００１８】

図３に実線で示すように、処置具先端部４１は起上部８３の上で緩く曲がりながら突出する。図１に矢印で示すように、起上操作レバー２１を操作すると、後述するようにレバー６０（図８参照）が動き、レバー６０に連動して起上台８０が動く。起上台８０が動くことにより、図１中および図３中に矢印および二点鎖線で示すように、起上台８０の上の処置具先端部４１が操作部２０側に屈曲する。処置具先端部４１の動きは、観察窓３６を介して図示しない撮像素子等により撮影され、図示しない表示装置に表示される。

【００１９】

処置具４０は、たとえば高周波ナイフ、鉗子または造影チューブ等の処置用の機器である。なお、チャンネル３４に挿入する機器は処置用の機器に限定されない。たとえば、超音波プローブ、極細内視鏡等の観察用の機器をチャンネル３４に挿入して使用する場合もある。以後の説明では、観察用の機器も含めて処置具４０と記載する。

【００２０】

以上に説明したように起上台８０が動くことを、以下の説明では「起上台８０が起上する」と表現する場合がある。起上した起上台８０に押されて処置具先端部４１が屈曲することを、以下の説明では「処置具４０が起上する」と表現する場合がある。起上操作レバー２１の操作により、処置具４０の起上の程度を調整することができる。

【００２１】

図４は、挿入部３０の先端の正面図である。カバー５２は、開口端部５６の近傍に長方形の凹部４８を有する。凹部４８の各辺は、カバー５２の表面から略垂直に立ち下がっている。凹部４８は、カバー５２の周方向の他の部分に比べて薄肉であり、指で押さえる等により外力を加えると撓み易い部分である。凹部４８は、本実施の形態の可撓部の一例で

10

20

30

40

50

ある。

【 0 0 2 2 】

図 5 は、内視鏡用キャップ 5 0 を挿入部 3 0 の先端から取り外した状態を説明する正面図である。図 6 は、内視鏡用キャップ 5 0 を挿入部 3 0 の先端から取り外した状態を説明する背面図である。内視鏡 1 0 のユーザは、一方の手で湾曲部 1 3 を保持し、他方の手の二本の指でカバー 5 2 を摘む。この際、二本の指の一方で凹部 4 8 を押さえると、もう一方の指は自然に図 6 に P で示す領域を押さえる。ユーザは、二本の指でカバー 5 2 を押圧して、軽く変形させた後に、先端側に引っ張ることにより、後述するように挿入部 3 0 の先端から内視鏡用キャップ 5 0 を外すことができる。

【 0 0 2 3 】

図 7 は、内視鏡用キャップ 5 0 を取り外した挿入部 3 0 の先端の斜視図である。図 5 から図 7 を使用して、挿入部 3 0 の先端の構成を説明する。先端部 3 1 は、略円柱形状であり、中心からずれた位置に先端側から操作部側に向けて設けられた溝により、光学収容部 3 3 とレバー室 6 9 とに分かれている。チャンネル出口 3 5 は、溝の底に開口している。チャンネル出口 3 5 の近傍に、曲げ部 2 7 が設けられている。曲げ部 2 7 の形状については後述する。

【 0 0 2 4 】

先端部 3 1 は、周面の一部を平坦に切り欠いて形成される第 1 平面部 3 2 1 を有する。第 1 平面部 3 2 1 の、光学収容部 3 3 とレバー室 6 9 とを隔てる溝の底に沿った部分に、第 3 係合部 2 9 が設けてある。第 3 係合部 2 9 は、長円形の窪みである。先端部 3 1 は、第 3 係合部 2 9 の裏側に第 4 係合部 2 8 (図 1 9 参照) を有する。第 4 係合部 2 8 は、長方形の窪みである。

【 0 0 2 5 】

第 1 平面部 3 2 1 の光学収容部 3 3 側には、観察窓 3 6 および照明窓 3 7 が配置されている。観察窓 3 6 の操作部側には、観察窓 3 6 に水および空気を噴射して清掃するノズル 3 8 が設けられている。光学収容部 3 3 の外側には、先端部 3 1 の周面の一部を平坦に切り欠いて形成される第 2 平面部 3 2 2 および第 3 平面部 3 2 3 が設けられている。第 2 平面部 3 2 2 と第 3 平面部 3 2 3 とは、角度をもって連続している。

【 0 0 2 6 】

レバー室 6 9 は中空であり、先端部 3 1 の外周面に沿った長方形の薄板状のレバー室蓋 6 7 で覆われている。レバー室蓋 6 7 は、蓋ねじ 6 6 により四隅で固定されている。蓋ねじ 6 6 は、本実施の形態の固定部材の一例である。レバー室 6 9 は、光学収容部 3 3 側に支持壁 6 8 を有する。支持壁 6 8 から光学収容部 3 3 に向けて起上台連結部 6 1 が突出する。起上台連結部 6 1 は、長方形断面の軸である。起上台連結部 6 1 については後述する。

【 0 0 2 7 】

図 8 は、内視鏡用キャップ 5 0 およびレバー室蓋 6 7 を取り外した挿入部 3 0 の先端の斜視図である。レバー室 6 9 の内部に、レバー 6 0 が設けられている。レバー 6 0 は、一端にワイヤ固定部 6 5 を有し、他端に後述するようにレバー軸 6 3 (図 1 9 参照) および起上台連結部 6 1 を有する。レバー 6 0 は、支持壁 6 8 に設けた孔に回転可能に支持されている。なお、回転は、所定の角度の範囲内での回転運動を意味する。

【 0 0 2 8 】

ワイヤ固定部 6 5 は、起上ワイヤ 2 4 の端部に連結されている。起上ワイヤ 2 4 は、挿入部 3 0 を通って起上操作レバー 2 1 (図 1 参照) に連結されている。さらに具体的には、起上ワイヤ 2 4 は、起上ワイヤ 2 4 の外径よりも若干太い内径を有する図示しない案内管に挿通されている。図示しない案内管は、挿入部 3 0 を長手方向に貫通する。そのため、起上操作レバー 2 1 の操作に連動して起上ワイヤ 2 4 の先端が進退する。起上ワイヤ 2 4 は、本実施の形態の回転部の一例である。起上ワイヤ 2 4 は、起上操作レバー 2 1 により遠隔操作される。

【 0 0 2 9 】

10

20

30

40

50

起上操作レバー 21 が動くことにより、起上操作レバー 21 に接続された起上ワイヤ 24 が操作部側に引っ張られる。起上ワイヤ 24 に引っ張られて、レバー 60 がレバー軸 63 を軸として回転する。

【0030】

図 9 は、内視鏡用キャップ 50 を内視鏡 10 への取付側からみた斜視図である。図 10 は、内視鏡用キャップ 50 をカバー 52 の底側からみた斜視図である。前述したように、内視鏡用キャップ 50 は、カバー 52 および起上台 80 を有する。カバー 52 は、一端に開口部を有する有底筒型である。以下の説明では、カバー 52 の一端の開口部を開口端部 56 と記載する。

【0031】

前述したようにカバー 52 は、筒部に窓部 53 を有する。窓部 53 は、カバー 52 の周面の一箇所に、略全長にわたって開口している。カバー 52 は、窓部 53 に対向する内面に、開口端部 56 から底に向けて延びる台座溝 45 を有する。台座溝 45 に固定された台座 70 を介して、カバー 52 の内部に、起上台 80 が取り付けられている。台座 70 については後述する。

【0032】

カバー 52 は、窓部 53 の開口端部 56 側の縁に沿って内側に向けて突出する板状の突出部 49 を有する。突出部 49 の先端の一部から、板状の第 1 係合部 46 がさらに突出する。突出部 49 と第 1 係合部 46 は、窓部 53 の縁に沿って同一平面になっている。

【0033】

図 11 は、起上台 80 の斜視図である。図 12 は、起上台 80 の正面図である。図 13 は、起上台 80 の側面図である。図 11 から図 13 を使用して、起上台 80 の構成を説明する。

【0034】

起上台 80 は、略 L 字型の起上部 83 を有する。起上部 83 は、一面にスプーン状の窪み部 84 を有する第 1 起上部 831 と、第 1 起上部 831 の端から第 1 起上部 831 の窪み部 84 を有する面と同じ側に突出する第 2 起上部 832 とを有する。第 2 起上部 832 の端部にレバー連結部 81 が設けられている。レバー連結部 81 は、第 2 起上部 832 の端部に向けて開口する U 字形の溝である。

【0035】

レバー連結部 81 の一方は、板状のフランジ 85 に覆われている。フランジ 85 の反対側の面から起上台軸 82 が突出する。すなわち、フランジ 85 の一方の面から起上台軸 82 が突出し、フランジ 85 の他方の面から起上台軸 82 の中心軸と交差する方向に、起上部 83 が突出している。起上部 83 の基端部側に、レバー連結部 81 が設けられている。

【0036】

図 13 に破線で示すように、レバー連結部 81 は、起上台軸 82 の中心軸を挟む様に配置されている。フランジ 85 は、起上台軸 82 と略同軸の円筒面 851 を有する。

【0037】

第 2 起上部 832 は、第 1 起上部 831 の窪み部 84 を有する面に隣接する部分に、平面状の第 2 逃げ面 87 を有する。第 2 逃げ面 87 は、レバー連結部 81 の U 字形の 2 本の縦線に相当する面と平行な平面である。

【0038】

第 2 起上部 832 は、第 2 逃げ面 87 とレバー連結部 81 の入口との間に、第 1 逃げ面 86 を有する。第 1 逃げ面 86 は、フランジ 85 に設けられた円筒面 851 の延長面よりも起上台軸 82 の中心軸側に配置された平面である。第 1 逃げ面 86 のフランジ 85 側の端は、円筒面 851 に連続している。

【0039】

第 2 起上部 832 は、レバー連結部 81 を挟んで第 2 逃げ面 87 の反対側に、停止面 88 を有する。停止面 88 は、第 2 逃げ面 87 と平行な平面である。停止面 88 は、円筒面 851 の延長面よりも起上台軸 82 の中心軸側に配置されている。停止面 88 は、略円筒

10

20

30

40

50

形の回動逃げ面 8 8 1 を介してレバー連結部 8 1 の入口に連続している。

【 0 0 4 0 】

図 1 4 は、台座 7 0 の斜視図である。図 1 4 を使用して、台座 7 0 の構成を説明する。

【 0 0 4 1 】

台座 7 0 は、長方形板状の土台部 9 5 と、土台部 9 5 の長手方向の中央部から立ち上がる支持足から土台部 9 5 の長手方向に沿って延びる略長方形板状の第 1 壁 7 7 とを有する。

【 0 0 4 2 】

さらに土台部 9 5 から、略長方形板状の第 2 壁 7 8 が第 1 壁 7 7 と平行に立ち上がる。第 1 壁 7 7 と第 2 壁 7 8 とは、土台部 9 5 の幅方向に離れている。第 2 壁 7 8 は、土台部 9 5 と平行な第 2 壁端面 7 8 1 を有する。第 2 壁端面 7 8 1 は、第 1 壁 7 7 の縁よりも土台部 9 5 側にある。

【 0 0 4 3 】

第 1 壁 7 7 の端部には、第 1 壁 7 7 と第 2 壁 7 8 とを掛け渡す長方形板状の第 3 壁 7 9 が接続している。第 3 壁 7 9 には、第 1 壁 7 7 と反対側の面に、第 1 固定突起 7 3 を設けてある。第 1 固定突起 7 3 は、割り溝を有する突起である。第 1 固定突起 7 3 は、端部に一回り太い抜け止めを有する。

【 0 0 4 4 】

土台部 9 5 は、長手方向の一方の端に厚肉部 7 4 を有し、反対側の端に略半円形に盛り上がる第 2 係合部 7 2 を有する。厚肉部 7 4 は、第 1 壁 7 7 と対向する。

【 0 0 4 5 】

第 1 壁 7 7 は、根元に起上台取付孔 7 6 を有する。起上台取付孔 7 6 に、図 1 1 から図 1 3 を使用して説明した起上台 8 0 の起上台軸 8 2 を挿入して、起上台 8 0 と台座 7 0 とを回動可能に組み付ける。

【 0 0 4 6 】

図 1 5 は、起上台 8 0 と台座 7 0 とを組み付けた正面図である。図 1 6 は、起上台 8 0 と台座 7 0 とを組み付けた背面図である。図 1 5 および図 1 6 を使用して、起上台 8 0 と台座 7 0 とを組み付けた構成について説明する。

【 0 0 4 7 】

前述のとおり、起上台軸 8 2 が起上台取付孔 7 6 に挿入されている。起上台取付孔 7 6 が軸受けの機能を果たすことにより、起上台 8 0 は起上台軸 8 2 周りに回動可能である。第 1 壁 7 7 と第 2 壁 7 8 とが、フランジ 8 5 を挟んでいる。フランジ 8 5 と第 2 壁 7 8 とが抜け止めの機能を果たすことにより、起上台 8 0 が台座 7 0 から外れることが防止される。

【 0 0 4 8 】

フランジ 8 5 は、板状部の一例である。フランジ 8 5 によりレバー連結部 8 1 の一方の側面が繋がっているため、レバー連結部 8 1 が開くような変形が防止されている。したがって、強度の高い起上台 8 0 を実現できる。

【 0 0 4 9 】

停止面 8 8 は第 2 壁端面 7 8 1 に対向している。起上台 8 0 に対して、起上台軸 8 2 を軸として図 1 6 における時計回りに回転する方向の力が加わる場合には、停止面 8 8 が第 2 壁 7 8 に接触して起上台 8 0 の回転を防止する。一方、停止面 8 8 の開口端部 5 6 側は略円筒形の回動逃げ面 8 8 1 を介してレバー連結部 8 1 の入口に連続しているため、起上台 8 0 は起上台軸 8 2 を軸として図 1 6 における反時計回りに回ることが可能である。

【 0 0 5 0 】

図 9 に戻って説明を続ける。台座 7 0 は、起上台取付孔 7 6 に起上台 8 0 を回動可能に取り付けた状態で、第 1 固定突起 7 3 側からカバー 5 2 に挿入されている。台座 7 0 の土台部 9 5 は、台座溝 4 5 に固定されている。

【 0 0 5 1 】

図 1 7 は、図 5 の X V I I - X V I I 線による内視鏡用キャップ 5 0 の断面図である。

X V - X V 断面は、挿入部 30 の長手方向に沿って、第 1 壁 77 を厚さ方向に切断する断面である。図 9 から図 17 を使用して、内視鏡用キャップ 50 の構成を説明する。

【0052】

図 17 に示すように、カバー 52 は、台座固定孔 57 および第 2 固定突起 58 を有する。台座固定孔 57 は、カバー 52 の底に設けられた貫通孔である。第 2 固定突起 58 は、台座溝 45 の端から開口端部 56 側に向けて張り出す突起である。

【0053】

図 14 を使用して説明した第 1 固定突起 73 および厚肉部 74 がそれぞれ台座固定孔 57 および第 2 固定突起 58 と係合することにより、カバー 52 と台座 70 とがカバー 52 の内部に固定されている。窪み部 84 は、窓部 53 に対向して配置されている。

10

【0054】

図 17 に二点鎖線で示すように、起上台 80 は、起上台軸 82 を軸として、起上部 83 の縁がストッパ部 531 と接触する位置まで回転することができる。以下の説明では、起上台 80 の回転可能角度を角度 Z と記載する。

【0055】

図 18 は、レバー 60 の斜視図である。レバー 60 は、一端にレバー軸 63 を有し、他端にワイヤ固定部 65 を有する。ワイヤ固定部 65 は、割り溝を備える。レバー軸 63 の一方の端面から、レバー軸 63 の中心軸と同じ方向に向けて、長方形断面の軸である起上台連結部 61 が突出している。以下の説明では、レバー軸 63 とワイヤ固定部 65 とを連結する板状の部分を回転連結部 64 と記載する。回転連結部 64 は、レバー軸 63 の起上台連結部 61 と反対側の端部から、レバー軸 63 の中心軸と交差する方向に突出している。図 8 に示すように、回転連結部 64 はレバー室 69 内で回転する。すなわち、レバー 60 は、内視鏡 10 の挿入部 30 の先端に、レバー軸 63 まわりに回転可能に設けられている。

20

【0056】

レバー軸 63 に、2 個のリング 62 が固定されている。図 7 に戻って説明を続ける。レバー 60 は、支持壁 68 に設けた孔にレバー室 69 側からレバー軸 63 が挿入され、起上台連結部 61 を光学収容部 33 に向けた状態で、回転可能に支持される。リング 62 とレバー室蓋 67 とにより、中空のレバー室 69 は水密に封止される。

【0057】

30

図 19 は、図 4 の X I X - X I X 線による挿入部 30 の断面図である。X I X - X I X 断面は、起上台連結部 61 を通り、挿入部 30 の長手方向に沿った断面である。図 20 は、図 4 の X X - X X 線による挿入部 30 の断面図である。X X - X X 断面は、第 4 係合部 28 の操作部側の縁および第 3 係合部 29 を通り、挿入部 30 の長手方向に垂直な断面である。図 19 および図 20 を使用して、内視鏡用キャップ 50 を挿入部 30 の先端に固定する構成について説明する。

【0058】

内視鏡用キャップ 50 は、開口端部 56 を挿入部 30 側に向けている。内視鏡用キャップ 50 の内面の第 1 係合部 46 と先端部 31 の第 3 係合部 29 とが係合している。同様に、内視鏡用キャップ 50 の内面の第 2 係合部 72 と先端部 31 の第 4 係合部 28 とが係合している。内視鏡用キャップ 50 が内面の対向する 2 箇所先端部 31 と係合していることにより、内視鏡用キャップ 50 が先端部 31 に固定されている。

40

【0059】

図 19 に示すように、第 1 係合部 46 は第 2 係合部 72 よりも開口端部 56 側に配置されている。また、第 1 係合部 46 と第 3 係合部 29 との係合部は平面同士の突き当てにより係合しているのに対して、第 2 係合部 72 は丸みを帯びた面で第 4 係合部 28 と係合している。したがって、第 1 係合部 46 の方が、第 2 係合部 72 よりも強固に先端部 31 と係合している。

【0060】

U 字溝型のレバー連結部 81 に長方形断面の軸である起上台連結部 61 が挿入されてい

50

る。これにより、レバー 60 と起上台 80 とが係合している。以上に説明したように、内視鏡用キャップ 50 を内視鏡 10 の先端部 31 に装着した際、起上台 80 はレバー 60 に連結される。ここで連結は、レバー 60 が回転した場合に、起上台 80 がレバー 60 と共に回転する状態を意味する。

【0061】

図 20 に示すように、カバー 52 の筒部の内面と、第 2 平面部 322 および第 3 平面部 323 とが空間を隔てて対向して、第 1 空洞部 93 を形成している。凹部 48 は、第 1 空洞部 93 に対応する位置に配置されている。凹部 48 の反対側では、カバー 52 は筒部の内面をへこませて薄肉にされている。カバー 52 の薄肉な部分の内面と、レバー室蓋 67 とが空間を隔てて対向して、第 2 空洞部 94 を形成している。第 2 空洞部 94 内に、蓋ねじ 66 の頭部が配置されている。すなわち、第 2 空洞部 94 は、レバー室蓋 67 を固定する固定部材である蓋ねじ 66 の頭部を収容する空間である。

10

【0062】

図 20 に白抜き矢印で示すように、凹部 48 と、その反対側との 2 箇所をユーザが指で押圧する。押圧する部分の裏側に第 1 空洞部 93 および第 2 空洞部 94 が存在するため、カバー 52 は押圧方向を短軸、押圧方向に直交する方向を長軸とする略楕円形に変形する。

【0063】

変形したカバー 52 の長軸になる部分近傍に、前述の第 1 係合部 46 および第 2 係合部 72 が設けられている。内視鏡用キャップ 50 が変形することにより、第 1 係合部 46 および第 2 係合部 72 がそれぞれ外側に移動し、第 3 係合部 29 および第 4 係合部 28 との係合が外れる。なお、前述のとおり凹部 48 は、カバー 52 の周方向の他の部分に比べて薄肉であり、指で押さえる等により撓み易い可撓部である。そのため、ユーザは容易に内視鏡用キャップ 50 を変形させることができる。

20

【0064】

ユーザが、内視鏡用キャップ 50 を押圧したまま先端側に引くことにより、レバー連結部 81 と起上台連結部 61 との係合も外れ、内視鏡用キャップ 50 を挿入部 30 の先端から外すことができる。図 4 に示すように、凹部 48 は挿入方向に直交する辺を有する。このため、ユーザの指が凹部 48 の縁に引っ掛かり、内視鏡用キャップ 50 を容易に取り外すことができる。

30

【0065】

なお、ユーザはレバー連結部 81 と起上台連結部 61 の向きが合っていることを確認した上で、内視鏡用キャップ 50 を挿入部 30 の先端に押し込むことにより、内視鏡用キャップ 50 を挿入部 30 に取り付けることができる。図 19 に示すように、第 1 係合部 46 の開口端部 56 側の端部が面取りされているので、第 1 係合部 46 が先端部 31 に引っ掛かりにくく、取付が容易である。

【0066】

図 19 に示すように、チューブ状のチャンネル 34 は先端部 31 に設けられたチャンネル出口 35 に接続されている。チャンネル出口 35 は、窓部 53 に向けてラッパ状に拡がっている。チャンネル出口 35 の第 3 係合部 29 近傍に、先端側に向けてゆるやかに突出する曲げ部 27 が設けられている。

40

【0067】

図 21 は、起上台 80 を起上した挿入部 30 の断面図である。図 21 は、図 19 と同一の断面を示す。図 7、図 8、図 18、図 19 および図 20 を使用して、起上台 80 を起上させる構成を説明する。

【0068】

レバー室 69 側から支持壁 68 に設けられた貫通孔にレバー軸 63 が挿通され、図 7 に示すように起上台連結部 61 が支持壁 68 の反対側に突出している。前述のとおり、レバー室 69 は、リング 62 およびレバー室蓋 67 (図 5 参照) により、水密に封止されて

50

いる。したがって、内視鏡 10 の使用中にレバー室 69 の内部および起上ワイヤ 24 の経路に体液等が付着しない。

【0069】

図 19 に示す状態では、起上台 80 はカバー 52 の内側に收容されている。窪み部 84 は、チャンネル出口 35 から突出した処置具先端部 41 を図 19 の上方向にゆるやかに曲げることが可能な位置に配置されている。

【0070】

前述のとおり、ユーザが起上操作レバー 21 を操作することにより、レバー 60 がレバー軸 63 を軸として回転する。起上台連結部 61 は、レバー軸 63 と一体に回転する。起上台連結部 61 がレバー連結部 81 と連結しているため、起上台 80 もレバー 60 と一体となつて、立ち上がるように回転する。その結果、起上台 80 と窓部 53 との間の距離が変化する。

【0071】

図 21 は、起上台 80 が回転した状態を示す。起上台 80 に押されて、チャンネル出口 35 から突出した処置具先端部 41 が起上する。処置具先端部 41 は、曲げ部 27 の先端に押し付けられた状態から、さらに窪み部 84 によって操作部側に押し込まれる。したがって、処置具先端部 41 を、図 17 を使用して説明した起上台 80 の回転可能角度 Z よりも大きい角度で屈曲させることが可能である。

【0072】

本実施の形態の内視鏡 10 の使用方法の概要を説明する。内視鏡 10 は、内視鏡用キャップ 50 を外し、洗浄等を行った状態で保管されている。内視鏡用キャップ 50 は、一個ずつ滅菌パックに封入した上で、たとえば 10 個単位で紙箱に入れた後に電子線滅菌を行った状態で提供される。紙箱に入れる内視鏡用キャップ 50 の数は最小販売単位、すなわち 1 回にユーザに販売される最小単位であることが望ましい。ユーザは、滅菌パックから内視鏡用キャップ 50 を取り出し、内視鏡 10 の先端部 31 に取り付ける。

【0073】

ユーザは、挿入部 30 を検査対象者の口から挿入する。観察窓 36 を介して撮影した映像を見ながら、ユーザは挿入部 30 の先端を目的部位に誘導する。ユーザは、目的に応じた処置具 40 等をチャンネル入口 22 から挿入する。処置具先端部 41 が挿入部 30 の先端から突出し、目的部位の近傍に位置することを確認した後に、ユーザは起上操作レバー 21 を操作して、処置具先端部 41 を目的部位に誘導する。必要な処置等を行った後に、ユーザは処置具 40 をチャンネル 34 から抜去する。ユーザは内視鏡 10 を検査対象者から抜去して、検査または処置を終了する。

【0074】

カバー 52 は、前述のように二本の指で押圧しながら先端側に引っ張ることにより、容易に取り外すことができる。本実施の形態の内視鏡用キャップ 50 は、いわゆるシングルユースであり、一回使用した後に廃棄される。

【0075】

なお、内視鏡 10 を通常の方法で使用して、観察および処置を行う際には、カバー 52 の 2 箇所と同時に、カバー 52 を変形させる程度の外力が加わることは考えにくい。

【0076】

ユーザは、内視鏡用キャップ 50 を外した後の内視鏡 10 に対して、次回の使用に備えて洗浄等の処理を行う。図 7 に示すように、内視鏡用キャップ 50 を外した後の内視鏡 10 には起上台 80 が付いていない。起上台 80 を固定する際に用いる起上台連結部 61 は、図 7 に示すように、先端部 31 に露出している。

【0077】

以上により、本実施の形態の内視鏡 10 は、起上台 80 および起上ワイヤ 24 付近の複雑な構造を洗浄するための特別な洗浄作業等を必要としない。したがって、症例間の処理時間が短く、効率良く運用することができる、起上台付きの内視鏡 10 を提供することができる。

10

20

30

40

50

【 0 0 7 8 】

停止面 8 8 は、レバー連結部 8 1 の U 字型の二本の縦線に相当する面に対して平行でなくても良い。たとえば、停止面 8 8 が図 1 9 において左下がりの方向に傾いている場合、起上台 8 0 は図 1 9 に示す状態から反時計周りに回転することが可能である。このようにすることにより、処置具先端部 4 1 を強く屈曲させずに、処置具 4 0 を挿入することが可能な内視鏡 1 0 を提供することが可能である。

【 0 0 7 9 】

剛性が強い処置具 4 0 を起上する場合には、処置具 4 0 がまっすぐな状態に戻ろうとする力により、起上部 8 3 が押し戻される。この際、内視鏡用キャップ 5 0 に対して、第 2 係合部 7 2 を軸として図 2 1 における反時計回りの方向に捻る力が加わる。

10

【 0 0 8 0 】

前述のとおり、第 1 係合部 4 6 は、第 2 係合部 7 2 よりも開口端部 5 6 側に配置されていること、および第 1 係合部 4 6 の方が、第 2 係合部 7 2 よりも強固に先端部 3 1 と係合していることから、内視鏡用キャップ 5 0 が挿入部 3 0 から外れにくい。なお、第 1 係合部 4 6 の突出量を、第 2 係合部 7 2 の突出量に比べて大きくすることにより、さらに内視鏡用キャップ 5 0 を挿入部 3 0 から外れにくくすることが可能である。

【 0 0 8 1 】

本実施の形態の内視鏡 1 0 は、起上台 8 0 を備えており側視型であるので、十二指腸および膵胆管領域の診断および処置用に適している。特に、E R C P (Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography)、E S T (Endoscopic Sphincterotomy)、E B D (Endoscopic Biliary Drainage) 等の手技を実施する場合には、本実施の形態の内視鏡 1 0 が適している。これらの手技では、十二指腸壁にある十二指腸乳頭部ならびに十二指腸乳頭部に開口する膵管および総胆管等の内部に処置具 4 0 を誘導して、処置等を行うためである。

20

なお、側視型の内視鏡 1 0 を、側視内視鏡と呼ぶ場合がある。同様に、十二指腸および膵胆管領域の診断等に適した内視鏡 1 0 を、十二指腸内視鏡と呼ぶ場合がある。

【 0 0 8 2 】

本実施の形態によると、台座 7 0 と、カバー 5 2 とが別体であるので、それぞれの形状が単純である。そのため、たとえば射出成型等により安価に製造することが可能である。

【 0 0 8 3 】

回動部には、起上ワイヤ 2 4 の代わりに伸縮可能な S M A (Shape memory alloy) アクチュエータを使用しても良い。このようにする場合には、S M A アクチュエータの一端をワイヤ固定部 6 5 に、他端を先端部 3 1 に固定する。S M A アクチュエータの周囲にヒータを配置する。ヒータは、起上操作レバー 2 1 の動きに連動して作動するようにする。

30

【 0 0 8 4 】

ヒータが作動して S M A アクチュエータが縮むことにより、レバー 6 0 および起上台 8 0 が回動する。回動部には、その他任意のリニア型のアクチュエータを使用することができる。

【 0 0 8 5 】

回動部には、小型モータ等の回動型のアクチュエータを使用しても良い。小型モータをレバー室 6 9 に配置し、モータ軸とレバー軸 6 3 とを連結することにより、レバー 6 0 を回動させることが可能である。

40

【 0 0 8 6 】

回動部にアクチュエータを使用する場合には、たとえば音声制御等のユーザの手を使わない手段を用いて起上台 8 0 を操作することができる。

【 0 0 8 7 】

内視鏡用キャップ 5 0 は、レバー連結部 8 1 を開口端部 5 6 の側に向けた状態で、起上台 8 0 とカバー 5 2 または台座 7 0 とを粘着材等により仮固定した状態で提供されても良い。このようにすることにより、内視鏡用キャップ 5 0 を挿入部 3 0 に取り付ける前に起上台 8 0 の向きを確認する手間を省き、簡便に使用できる内視鏡用キャップ 5 0 を提供す

50

ることができる。

【 0 0 8 8 】

仕様の異なる複数の種類の内視鏡用キャップ 5 0 から、ユーザが手技に応じた仕様の内視鏡用キャップ 5 0 を選択して使用するようにしても良い。たとえば、起上台 8 0 の回動可能範囲を狭く制限するストッパを設けた内視鏡用キャップ 5 0 が提供されても良い。回動可能範囲を狭くすることにより、たとえば超音波プローブまたは極細内視鏡等の高価で精密な機器を組み合わせて使用する場合に、過剰な屈曲による機器の破損を防止することができる。

【 0 0 8 9 】

窪み部 8 4 が、処置具先端部 4 1 の外径に沿う形状である場合には、起上時に処置具 4 0 が左右にぶれにくく、操作しやすい傾向がある。窪み部 8 4 の形状の異なる起上台 8 0 を有する複数の種類の内視鏡用キャップ 5 0 が提供されても良い。たとえば、細い処置具 4 0 を保持しやすい形状の窪み部 8 4 を備える内視鏡用キャップ 5 0 を使用することにより、ガイドワイヤ等の細い処置具 4 0 を精密に操作しやすくなる。

【 0 0 9 0 】

このようにすることにより、用途に適した内視鏡用キャップ 5 0 をユーザが選択して使用することが可能な内視鏡 1 0 を提供することができる。

【 0 0 9 1 】

内視鏡 1 0 は、先端に超音波振動子を備えるいわゆる超音波内視鏡でも良い。この場合には、内視鏡用キャップ 5 0 は、底に超音波振動子を挿通する孔を有することが望ましい。内視鏡 1 0 は、下部消化管向けの内視鏡でも良い。内視鏡 1 0 は、硬性の挿入部 3 0 を備えるいわゆる硬性鏡でも良い。内視鏡 1 0 は、エンジンおよび配管等の検査等に使用する、いわゆる工業用内視鏡でも良い。

【 0 0 9 2 】

内視鏡用キャップ 5 0 は、再使用可能であっても良い。このようにする場合には、挿入部 3 0 から取り外した内視鏡用キャップ 5 0 をユーザが目視で点検し、破損していない場合には洗浄等の処理を行い再使用する。内視鏡用キャップ 5 0 の開口端部 5 6 は大きく開いているため、挿入部 3 0 に取り付けられたままの状態に比べて容易に洗浄等の処理を行うことができる。内視鏡用キャップ 5 0 は小型であるので、滅菌パックに入れて、たとえばオートクレーブ滅菌等を行うことも容易である。

【 0 0 9 3 】

内視鏡 1 0 は、起上操作レバー 2 1 を任意の角度で固定する固定機構を備えても良い。ユーザは、所望の角度に処置具先端部 4 1 を起上した後に起上操作レバー 2 1 から指を離して、湾曲ノブ 2 3 等の操作に注力することが可能である。

【 0 0 9 4 】

[実施の形態 2]

本実施の形態は、第 3 係合部 2 9 が突起である内視鏡 1 0 に関する。実施の形態 1 と共通する部分については、説明を省略する。

【 0 0 9 5 】

図 2 2 は、実施の形態 2 の挿入部 3 0 の断面図である。図 2 2 は、図 1 9 と同様に起上台連結部 6 1 を通り、挿入部 3 0 の長手方向に沿った断面を示す。図 2 3 は、図 2 2 の X X I I I - X X I I I 線による挿入部 3 0 の断面図である。

【 0 0 9 6 】

第 3 係合部 2 9 は、第 1 平面部 3 2 1 から突出する突起である。第 1 係合部 4 6 は、突出部 4 9 の窓部 5 3 側に設けられた窪みである。第 1 係合部 4 6 と先端部 3 1 の第 3 係合部 2 9 とが係合している。また、実施の形態 1 と同様に第 2 係合部 7 2 と第 4 係合部 2 8 とが係合している。内視鏡用キャップ 5 0 が内面の対向する 2 箇所先端部 3 1 と係合していることにより、内視鏡用キャップ 5 0 が挿入部 3 0 の先端に固定されている。

【 0 0 9 7 】

第 1 係合部 4 6 および第 3 係合部 2 9 は、両者が係合可能な任意の形状を採用すること

10

20

30

40

50

ができる。第 2 係合部 7 2 および第 4 係合部 2 8 も、両者が係合可能な任意の形状を採用することができる。

【 0 0 9 8 】

[実施の形態 3]

本実施の形態は、挿入方向に沿って先端側が操作部側よりも細い起上台連結部 6 1 を有する内視鏡 1 0 に関する。実施の形態 1 と共通する部分については、説明を省略する。

【 0 0 9 9 】

図 2 4 は、実施の形態 3 の挿入部 3 0 の断面図である。図 2 2 は、図 1 9 と同様に起上台連結部 6 1 を通り、挿入部 3 0 の長手方向に沿った断面を示す。図 2 4 に示すように、起上台連結部 6 1 は、先端側が操作部側よりも薄い楔状である。また、レバー連結部 8 1 は、操作部側が広がった V 字型である。

10

【 0 1 0 0 】

本実施の形態によると、レバー連結部 8 1 の入口が広がっていること、および起上台連結部 6 1 の先端が細くなっていることから、起上台 8 0 が多少回動した状態からでも容易にレバー連結部 8 1 と起上台連結部 6 1 とを係合することが可能な内視鏡 1 0 を提供することができる。

【 0 1 0 1 】

起上台連結部 6 1 およびレバー連結部 8 1 は、両者が係合可能な任意の形状を採用することができる。

【 0 1 0 2 】

20

[実施の形態 4]

本実施の形態は、挿入部 3 0 の先端付近および内視鏡用キャップ 5 0 に指標を有する内視鏡 1 0 に関する。実施の形態 1 と共通する部分については、説明を省略する。

【 0 1 0 3 】

図 2 5 は、実施の形態 4 の挿入部 3 0 の先端の正面図である。挿入部 3 0 は、第 1 指標 2 6 1 を有する。第 1 指標 2 6 1 は、湾曲部 1 3 の表面を覆う軟性チューブの表面に、印刷またはレーザー加工等により形成されている。

【 0 1 0 4 】

カバー 5 2 は、開口端部 5 6 近傍に第 2 指標 2 6 2 を有する。第 2 指標 2 6 2 は、カバー 5 2 の表面に一体的に形成された窪みまたは突起である。第 2 指標 2 6 2 は、カバー 5 2 の表面に印刷またはレーザー加工等により形成されていても良い。第 2 指標 2 6 2 は、開口端部 5 6 またはその近傍に、切削加工等により形成されていても良い。

30

【 0 1 0 5 】

本実施の形態によると、内視鏡 1 0 を使用するユーザは、第 1 指標 2 6 1 と第 2 指標 2 6 2 とを周方向に位置合わせした状態で、内視鏡用キャップ 5 0 を挿入部 3 0 の先端に押し込むことにより、正しい向きに速やかに内視鏡用キャップ 5 0 を取り付けることが可能である。また、ユーザは、第 1 指標 2 6 1 と第 2 指標 2 6 2 とが図 2 5 に示すように密着していることを目視確認することにより、所定の位置まで内視鏡用キャップ 5 0 が押し込まれていることを確認することが可能である。

【 0 1 0 6 】

40

第 1 指標 2 6 1 および第 2 指標 2 6 2 の形状、大きさ等は任意である。

【 0 1 0 7 】

[実施の形態 5]

本実施の形態は、内視鏡用キャップ 5 0 の形状自体を第 2 指標 2 6 2 の代わりに使用する内視鏡 1 0 に関する。実施の形態 4 と共通する部分については、説明を省略する。

【 0 1 0 8 】

図 2 6 は、実施の形態 5 の挿入部 3 0 の先端の正面図である。挿入部 3 0 は、第 1 指標 2 6 1 を有する。

【 0 1 0 9 】

本実施の形態においては、カバー 5 2 の表面に設けられた凹部 4 8 を実施の形態 4 の第

50

２指標２６２の代わりに使用する。

【０１１０】

本実施の形態によると、内視鏡１０を使用するユーザは、第１指標２６１と凹部４８とを周方向に位置合わせした状態で、内視鏡用キャップ５０を挿入部３０の先端に押し込むことにより、正しい向きに速やかに内視鏡用キャップ５０を取り付けることが可能である。また、ユーザは、開口端部５６と第１指標２６１とが図２５に示すように密着していることを目視確認することにより、所定の位置まで内視鏡用キャップ５０が押し込まれていることを確認することが可能である。

【０１１１】

第１指標２６１の形状、大きさ等は任意である。窓部５３の縁等の、カバー５２の任意の部分、第２指標２６２の代わりに使用することができる。

10

【０１１２】

各実施例で記載されている技術的特徴（構成要件）はお互いに組合せ可能であり、組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

【０１１３】

以上の実施の形態１から５を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。

【０１１４】

20

（付記１）

内視鏡の挿入部の先端に回動可能に設けられたレバーと、該レバーを回動させる回動部とを備える内視鏡に着脱可能な内視鏡用キャップにおいて、

開口端部を有し、前記開口端部を内視鏡の挿入部の先端に着脱することが可能な有底筒型のカバーと、

前記カバーの筒部の内面に設けられる第１係合部と、

前記レバーに連結するレバー連結部を有し、回動可能に前記カバーの内側に固定される起上台と

を備える内視鏡用キャップ。

【０１１５】

30

（付記２）

前記第１係合部は、前記カバーの内側に突出する突起である付記１に記載の内視鏡用キャップ。

【０１１６】

（付記３）

前記カバーは、前記筒部に開口する窓部を有し、

前記突起は、前記窓部よりも前記開口端部側に設けられている

付記２に記載の内視鏡用キャップ。

【０１１７】

（付記４）

40

前記突起は、前記窓部の前記開口端部側の縁に設けられている付記３に記載の内視鏡用キャップ。

【０１１８】

（付記５）

前記内視鏡の挿入部は先端に凹状の第３係合部を有し、

前記第１係合部は、前記第３係合部に係合する付記２から付記４のいずれか一つに記載の内視鏡用キャップ。

【０１１９】

（付記６）

前記第１係合部に対向する第２係合部を有する付記２から付記５のいずれか一つに記載

50

の内視鏡用キャップ。

【 0 1 2 0 】

(付記 7)

前記カバーの内側に固定されており、前記起上台を回動可能に固定する起上台取付孔を備える台座を有し、

前記第 2 係合部は、前記台座に設けられた突起である付記 6 に記載の内視鏡用キャップ。

【 0 1 2 1 】

(付記 8)

前記第 1 係合部は、前記第 2 係合部よりも突出量大きい付記 7 に記載の内視鏡用キャップ。

10

【 0 1 2 2 】

(付記 9)

前記第 1 係合部は、前記第 2 係合部よりも前記開口端部側に設けられている付記 6 から付記 8 のいずれか一つに記載の内視鏡用キャップ。

【 0 1 2 3 】

(付記 1 0)

前記内視鏡の挿入部は先端に凹状の第 4 係合部を有し、

前記第 2 係合部は、前記第 4 係合部に係合する付記 7 から付記 9 のいずれか一つに記載の内視鏡用キャップ。

20

【 0 1 2 4 】

(付記 1 1)

前記挿入部を前記カバーに挿入した場合に、前記カバーの筒部の内面と前記挿入部との間に形成される空洞部を有し、

前記第 1 係合部は、前記カバーを前記空洞部の外側から押圧することにより、前記挿入部との係合が外れる

付記 5 から付記 1 0 のいずれか一つに記載の内視鏡用キャップ。

【 0 1 2 5 】

(付記 1 2)

前記第 1 係合部は、前記カバーの内面に設けられた凹部である付記 1 に記載の内視鏡用キャップ。

30

【 0 1 2 6 】

(付記 1 3)

挿入部の先端の表面に露出する回動可能な起上台連結部と、

開口端部を有し、前記開口端部を前記挿入部の先端に着脱することが可能な有底筒型のカバーと、前記カバーの筒部の内面に設けられる第 1 係合部と、前記起上台連結部に連結するレバー連結部を有し、回動可能に前記カバーの内側に固定される起上台とを含む内視鏡用キャップと、

前記挿入部に設けられており、前記第 1 係合部と係合する第 3 係合部と、

前記カバーの筒部の内面と前記挿入部との間に形成される空洞部と

を備える内視鏡。

40

【 0 1 2 7 】

(付記 1 4)

前記第 1 係合部は、前記カバーを前記空洞部の外側から押圧することにより、前記第 3 係合部との係合が外れる

付記 1 3 に記載の内視鏡。

【 0 1 2 8 】

(付記 1 5)

前記起上台連結部は、前記挿入部の先端の一部から挿入方向に突出する中空のレバー室から突出し、

50

前記レバー室は、板状のレバー室蓋で覆われており、
 前記空洞部は、前記レバー室蓋と前記カバーとの間に設けられている
 付記 1 3 または付記 1 4 に記載の内視鏡。

【 0 1 2 9 】

(付記 1 6)

前記レバー室蓋を固定する固定部材を備え、
 前記固定部材は、前記レバー室蓋の表面に突出する頭部を供え、
 前記頭部は、前記空洞部内に配置されている付記 1 5 に記載の内視鏡。

【 0 1 3 0 】

(付記 1 7)

前記空洞部は、前記挿入方向を挟んで対向する 2 箇所設けられている付記 1 3 から付記 1 6 のいずれか一つに記載の内視鏡。

10

【 0 1 3 1 】

(付記 1 8)

前記起上台連結部は、挿入方向に沿って先端側が操作部側に比べて細い付記 1 3 から付記 1 7 のいずれか一つに記載の内視鏡。

【 0 1 3 2 】

(付記 1 9)

前記挿入部の先端に第 1 指標を有し、
 前記内視鏡用キャップは、前記第 1 指標と対応する第 2 指標を有する
 付記 1 3 から付記 1 8 のいずれか一つに記載の内視鏡。

20

【 0 1 3 3 】

(付記 2 0)

挿入部の表面に露出する回動可能な起上台連結部を有する内視鏡の挿入部を把持し、
 開口端部を有し、前記開口端部を内視鏡の挿入部の先端に着脱することが可能であり、
 取り付けた場合に内視鏡の挿入部の先端との間に空洞部を有する有底筒型のカバーと、前記カバーの筒部の内面に設けられた第 1 係合部と、前記起上台連結部に連結するレバー連結部を有し、回動可能に前記カバーの内側に固定される起上台とを含む内視鏡用キャップを、前記カバーの筒部の外側の対向する 2 箇所で押圧し、

前記内視鏡用キャップを、挿入方向に沿って先端側に引っ張る

30

内視鏡用キャップの取り外し方法。

【 符号の説明 】

【 0 1 3 4 】

- 1 0 内視鏡
- 1 2 軟性部
- 1 3 湾曲部
- 2 0 操作部
- 2 1 起上操作レバー
- 2 2 チャンネル入口
- 2 3 湾曲ノブ
- 2 4 起上ワイヤ (回動部)
- 2 6 1 第 1 指標
- 2 6 2 第 2 指標
- 2 7 曲げ部
- 2 8 第 4 係合部
- 2 9 第 3 係合部
- 3 0 挿入部
- 3 1 先端部
- 3 2 1 第 1 平面部
- 3 2 2 第 2 平面部


40

50


3 2 3	第 3 平面部	
3 3	光学収容部	
3 4	チャンネル	
3 5	チャンネル出口	
3 6	観察窓	
3 7	照明窓	
3 8	ノズル	
4 0	処置具	
4 1	処置具先端部	
4 5	台座溝	10
4 6	第 1 係合部	
4 8	凹部（可撓部）	
4 9	突出部	
5 0	内視鏡用キャップ	
5 2	カバー	
5 3	窓部	
5 3 1	ストッパ部	
5 6	開口端部	
5 7	台座固定孔	
5 8	第 2 固定突起	20
6 0	レバー	
6 1	起上台連結部	
6 2	リング	
6 3	レバー軸	
6 4	回動連結部	
6 5	ワイヤ固定部	
6 6	蓋ねじ（固定部材）	
6 7	レバー室蓋	
6 8	支持壁	
6 9	レバー室	30
7 0	台座	
7 2	第 2 係合部	
7 3	第 1 固定突起	
7 4	厚肉部	
7 6	起上台取付孔	
7 7	第 1 壁	
7 8	第 2 壁	
7 8 1	第 2 壁端面	
7 9	第 3 壁	
8 0	起上台	40
8 1	レバー連結部	
8 2	起上台軸	
8 3	起上部	
8 3 1	第 1 起上部	
8 3 2	第 2 起上部	
8 4	窪み部	
8 5	フランジ	
8 5 1	円筒面	
8 6	第 1 逃げ面	
8 7	第 2 逃げ面	50

- 8 8 停止面
- 8 8 1 回動逃げ面
- 9 3 第 1 空洞部
- 9 4 第 2 空洞部
- 9 5 土台部


【 図 1 】

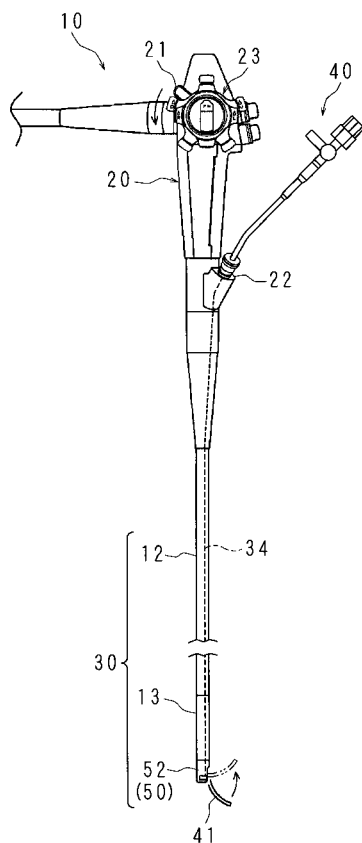


【 図 2 】

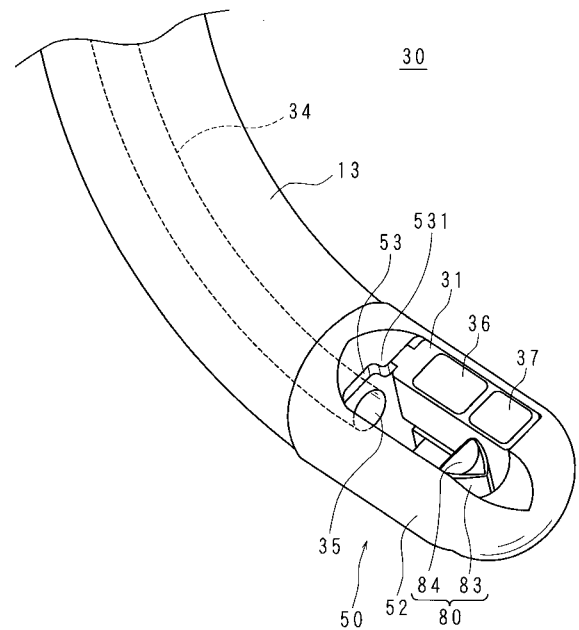


【図 3】

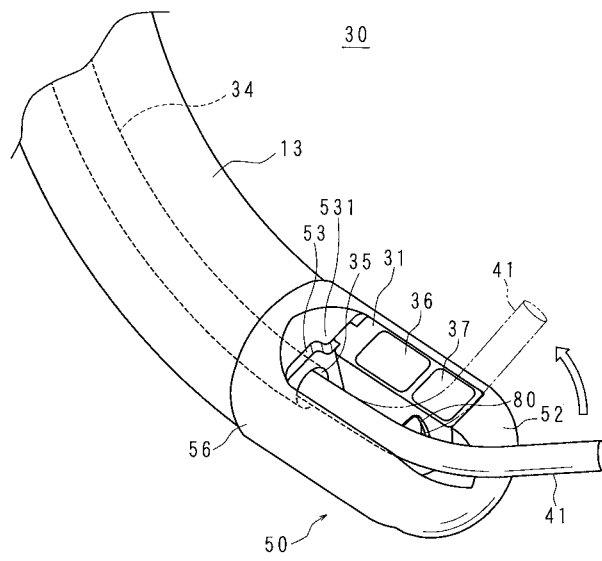


【図 4】

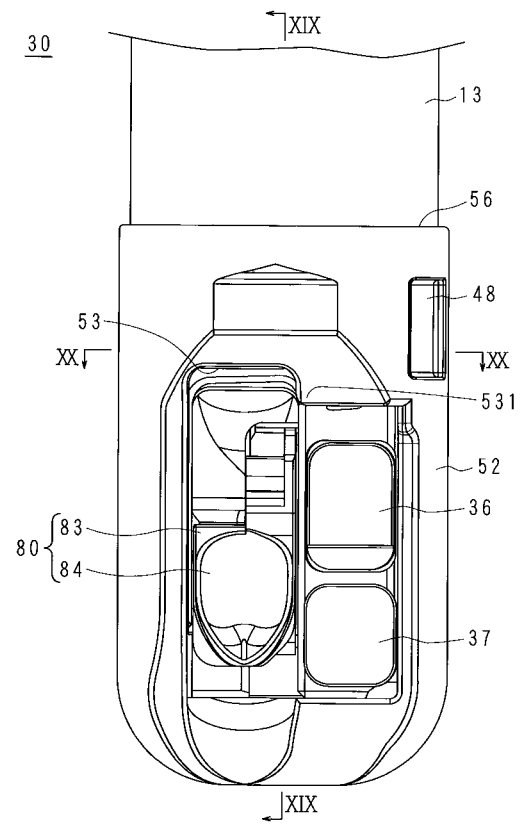


【図 5】

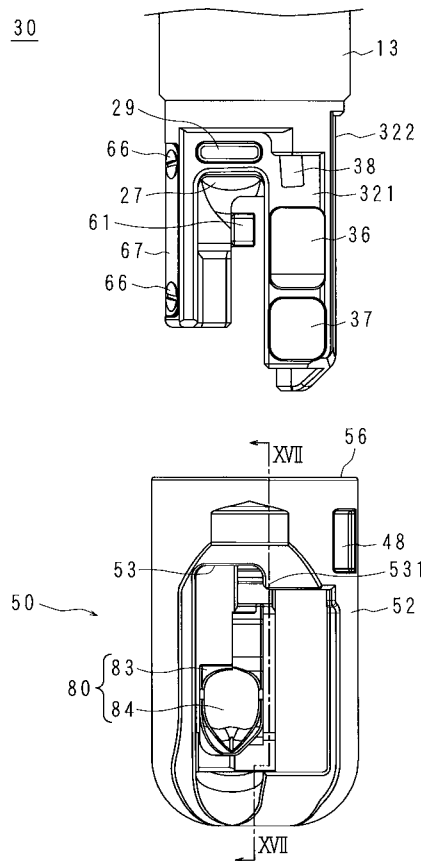


【図 6】

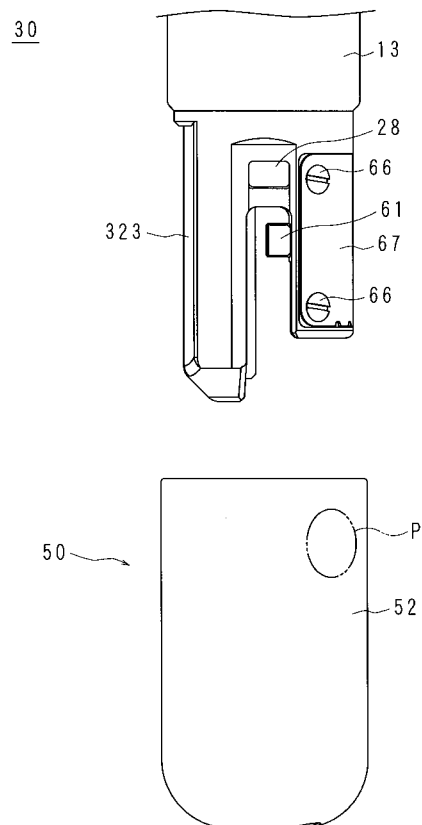


【図 7】

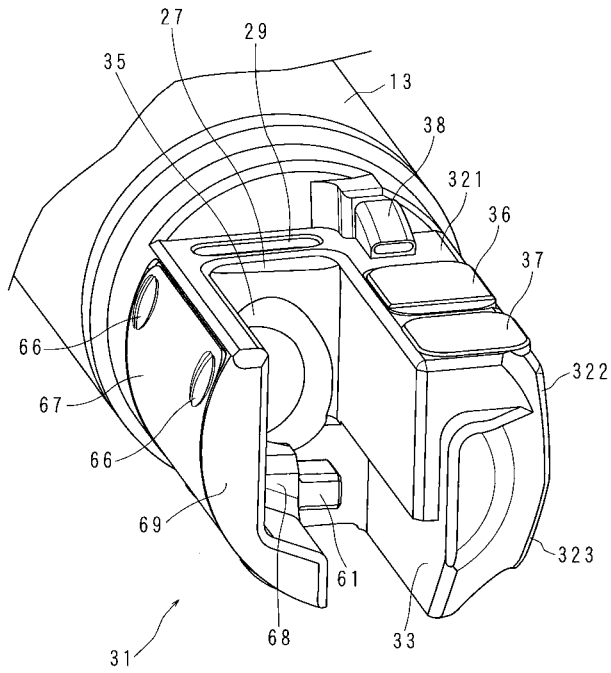


【図 8】

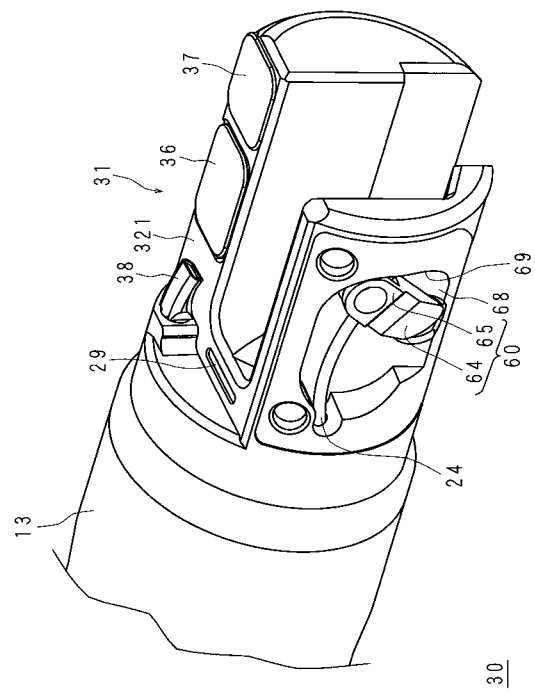


【図 9】

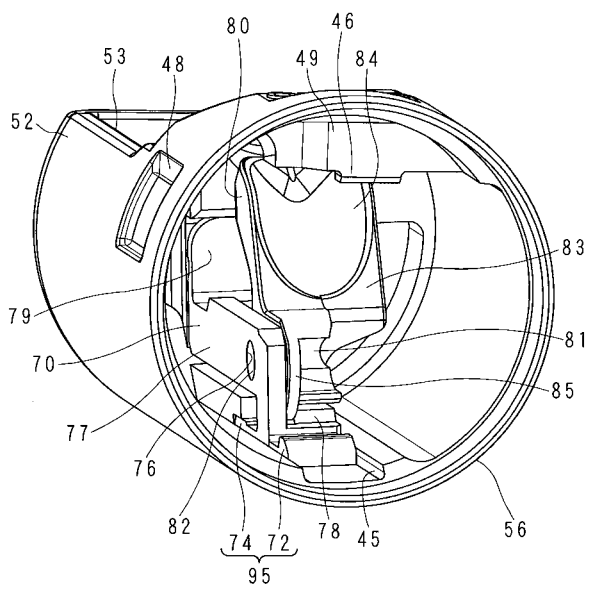


【図 10】

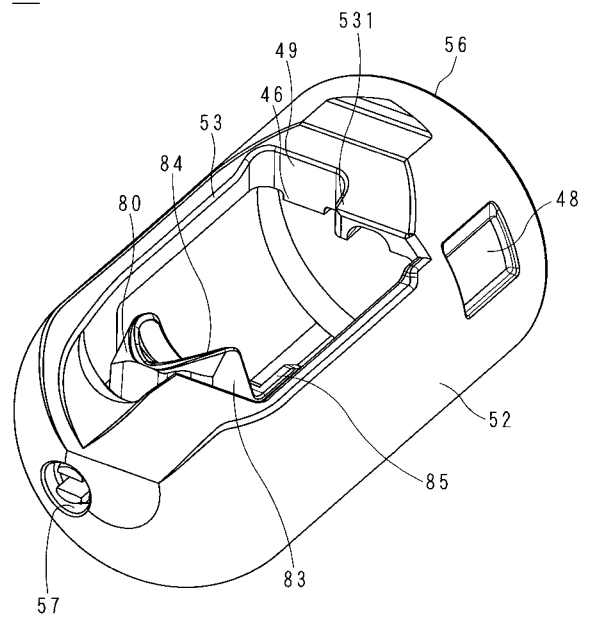


【図 1 1】

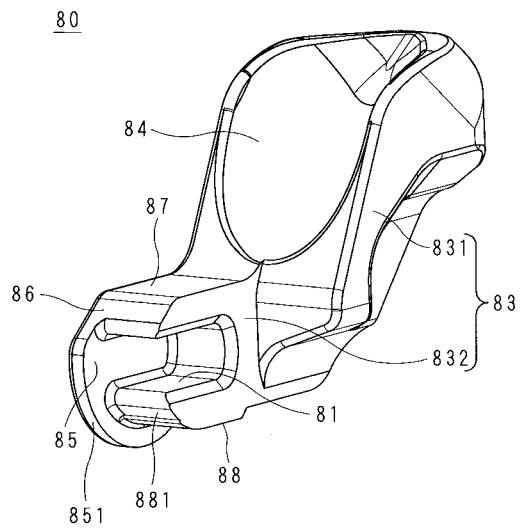


【図 1 2】

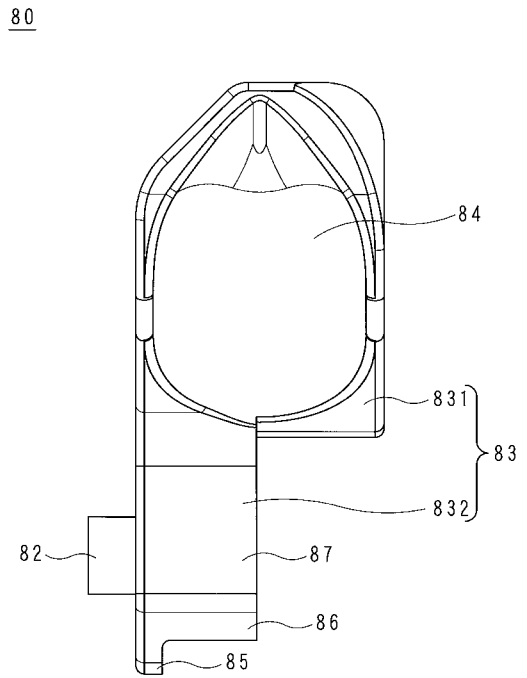


【図 1 3】

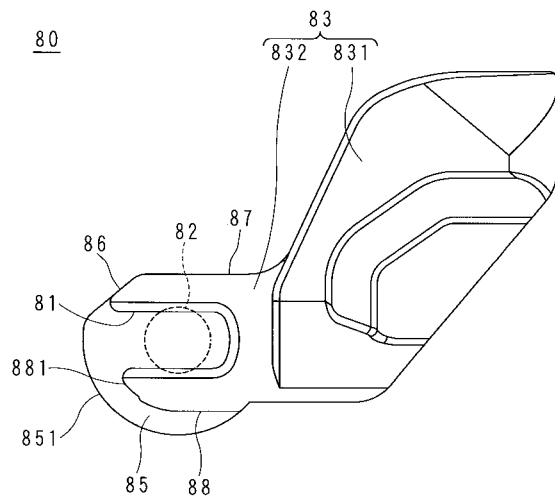


【図 1 4】

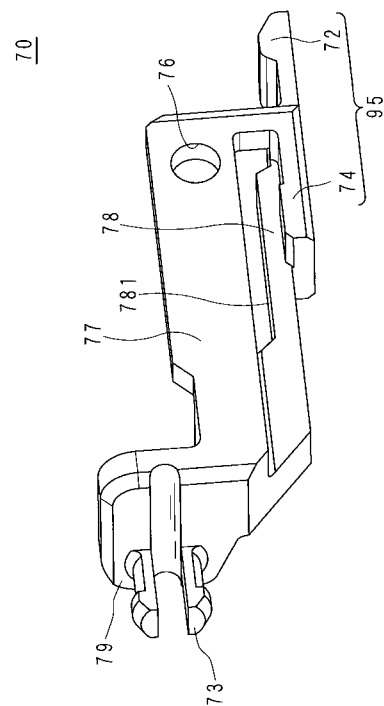


【図 15】

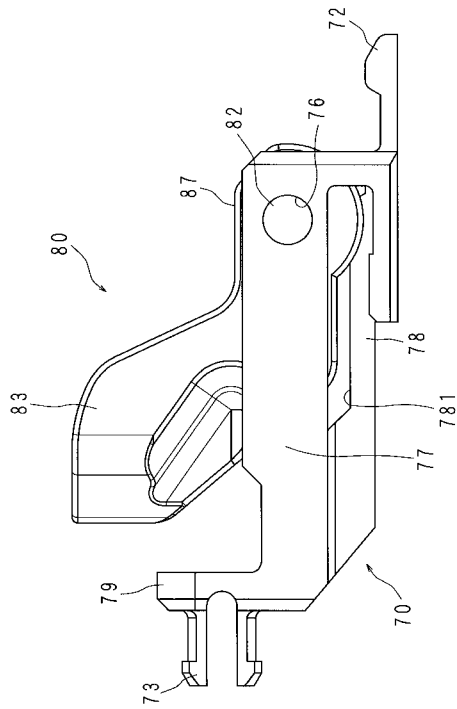


【図 16】

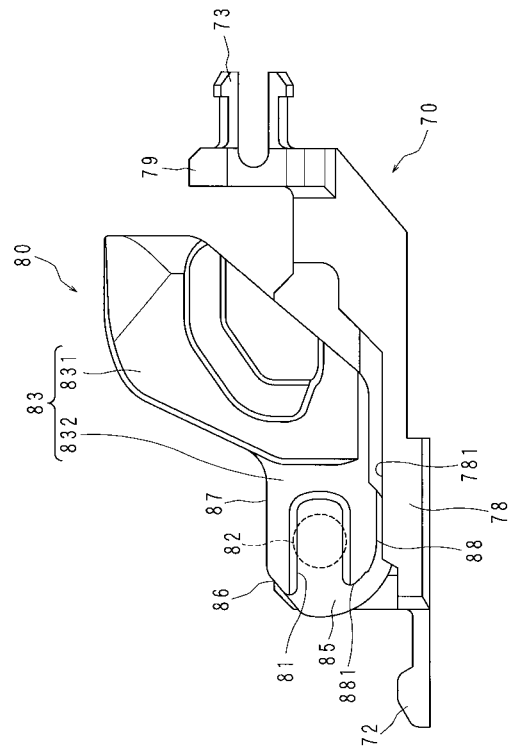


【図 17】

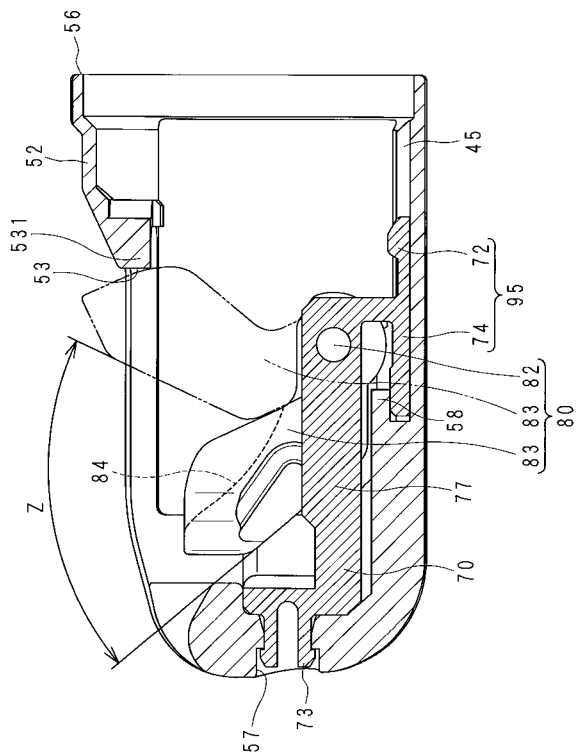


【図 18】

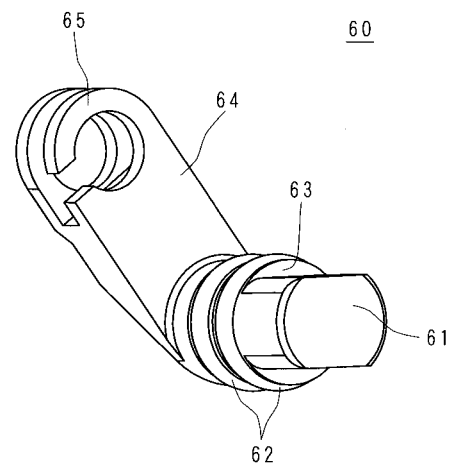


【図 19】

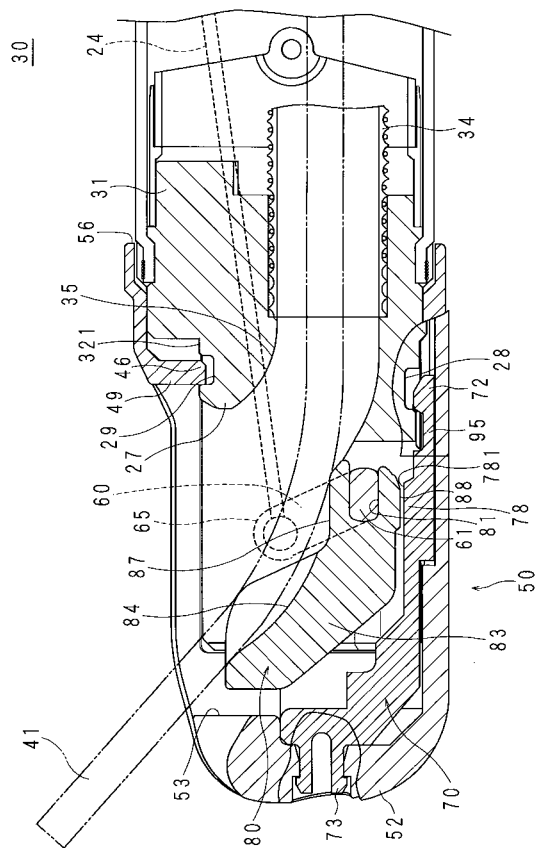


【図 20】

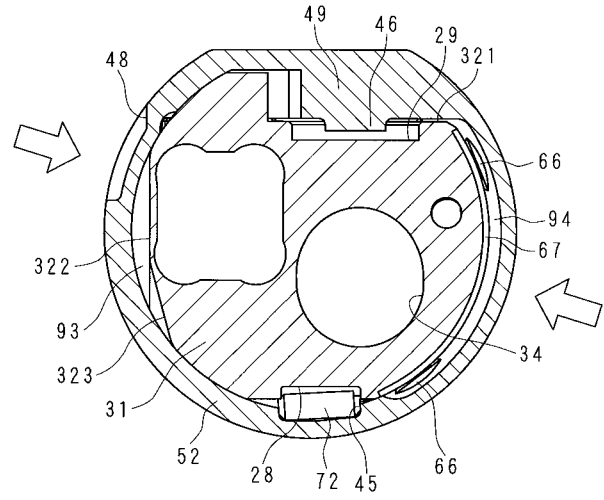


【図 21】

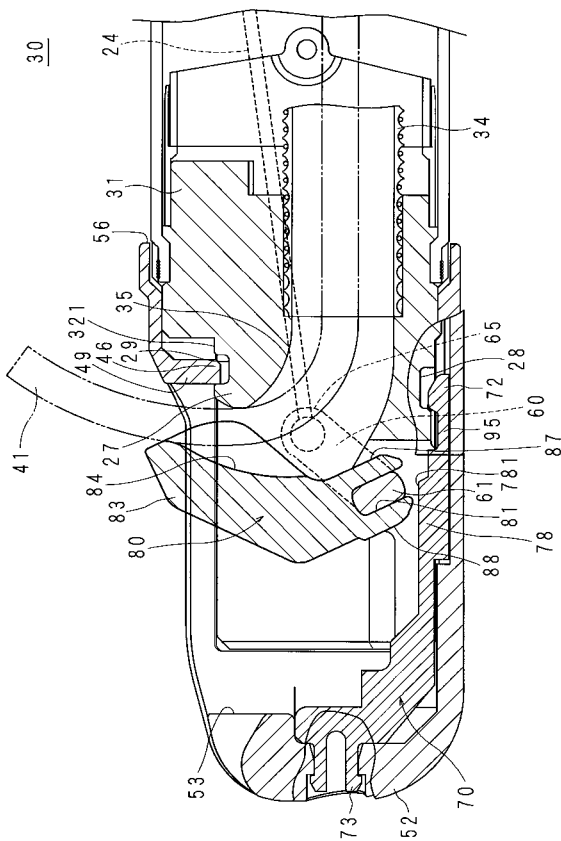


【図 22】

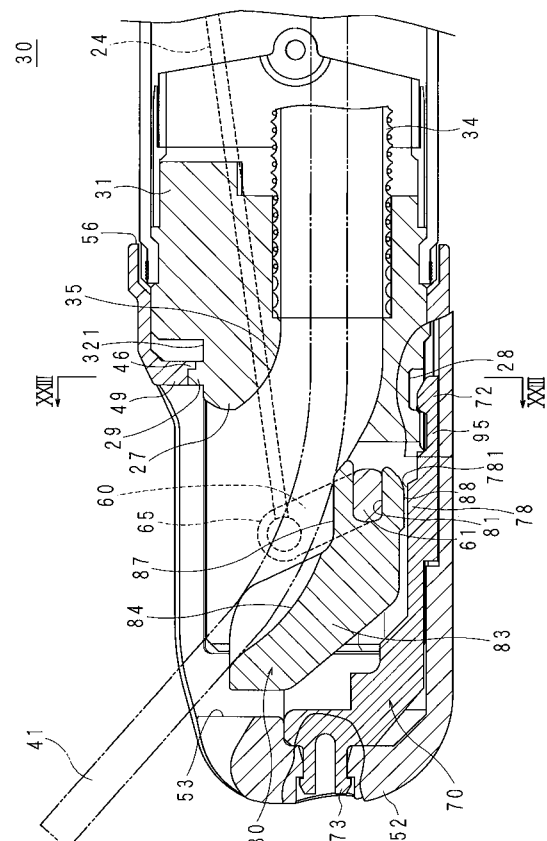


【図 23】

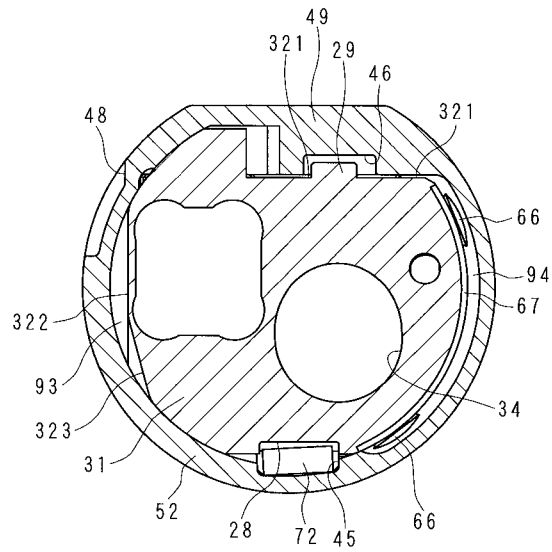


【図 24】

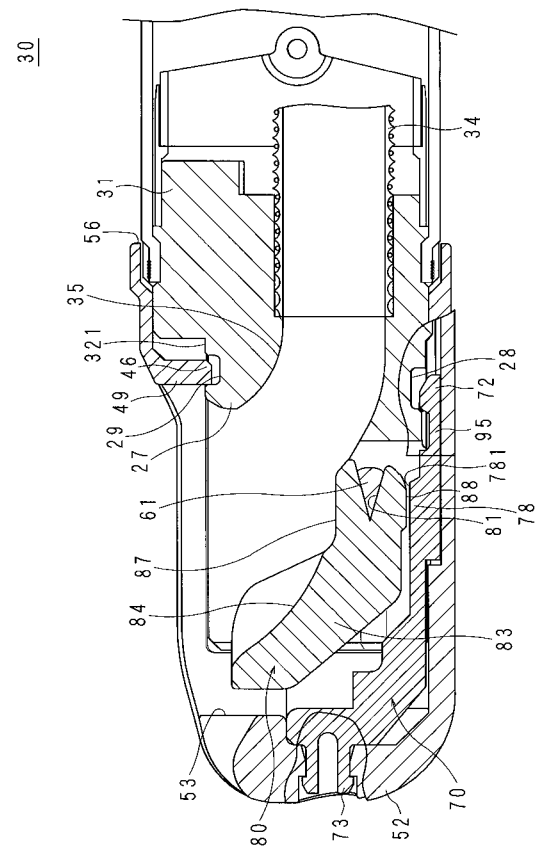

【図 25】

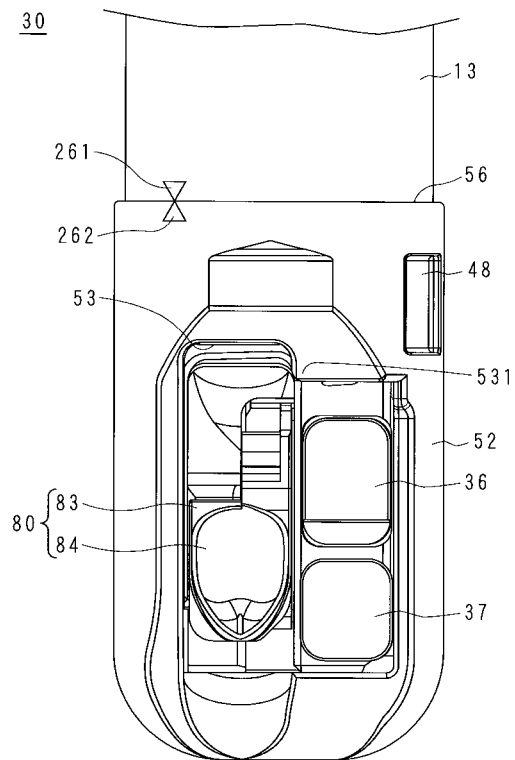

【図 26】

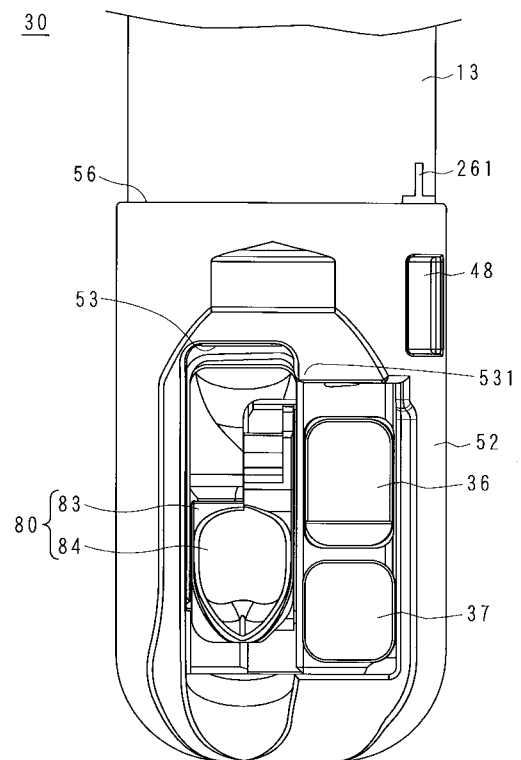

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2017/037111												
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl. A61B1/018(2006.01)i, A61B1/00(2006.01)i, G02B23/24(2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC														
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl. A61B1/00-1/32, G02B23/24-23/26 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Published examined utility model applications of Japan 1922-1996 Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2017 Registered utility model specifications of Japan 1996-2017 Published registered utility model specifications of Japan 1994-2017 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)														
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category*</th> <th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th>Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y A</td> <td>JP 2016-174821 A (FUJIFILM CORP.) 06 October 2016, paragraphs [0045]-[0046], [0074], fig. 5-6 & US 2016/0270637 A1, paragraphs [0061]-[0062], [0089], fig. 5-6</td> <td>1, 4 2-3, 5</td> </tr> <tr> <td>Y A</td> <td>JP 2004-267596 A (PENTAX CORP.) 30 September 2004, paragraphs [0021]-[0023], fig. 3-4 (Family: none)</td> <td>1, 4 2-3, 5</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 8-252211 A (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.) 01 October 1996, fig. 6 (Family: none)</td> <td>1-5</td> </tr> </tbody> </table>			Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	Y A	JP 2016-174821 A (FUJIFILM CORP.) 06 October 2016, paragraphs [0045]-[0046], [0074], fig. 5-6 & US 2016/0270637 A1, paragraphs [0061]-[0062], [0089], fig. 5-6	1, 4 2-3, 5	Y A	JP 2004-267596 A (PENTAX CORP.) 30 September 2004, paragraphs [0021]-[0023], fig. 3-4 (Family: none)	1, 4 2-3, 5	A	JP 8-252211 A (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.) 01 October 1996, fig. 6 (Family: none)	1-5
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.												
Y A	JP 2016-174821 A (FUJIFILM CORP.) 06 October 2016, paragraphs [0045]-[0046], [0074], fig. 5-6 & US 2016/0270637 A1, paragraphs [0061]-[0062], [0089], fig. 5-6	1, 4 2-3, 5												
Y A	JP 2004-267596 A (PENTAX CORP.) 30 September 2004, paragraphs [0021]-[0023], fig. 3-4 (Family: none)	1, 4 2-3, 5												
A	JP 8-252211 A (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.) 01 October 1996, fig. 6 (Family: none)	1-5												
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.														
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family														
Date of the actual completion of the international search 27 November 2017 (27.11.2017)		Date of mailing of the international search report 05 December 2017 (05.12.2017)												
Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan		Authorized officer Telephone No.												

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 7 / 0 3 7 1 1 1										
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61B1/018(2006.01)i, A61B1/00(2006.01)i, G02B23/24(2006.01)i												
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61B1/00-1/32, G02B23/24-23/26												
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2017年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2017年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2017年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2017年	日本国実用新案登録公報	1996-2017年	日本国登録実用新案公報	1994-2017年	
日本国実用新案公報	1922-1996年											
日本国公開実用新案公報	1971-2017年											
日本国実用新案登録公報	1996-2017年											
日本国登録実用新案公報	1994-2017年											
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)												
C. 関連すると認められる文献												
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号										
Y A	JP 2016-174821 A (富士フイルム株式会社) 2016.10.06, 段落[0045]-[0046][0074], 図 5-6 & US 2016/0270637 A1, 段落[0061]-[0062][0089], 図 5-6	1, 4 2-3, 5										
Y A	JP 2004-267596 A (ペンタックス株式会社) 2004.09.30, 段落[0021]-[0023], 図 3-4 (ファミリーなし)	1, 4 2-3, 5										
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。												
<table border="0"> <tr> <td> * 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 </td> <td> の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献 </td> </tr> </table>				* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献							
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献											
国際調査を完了した日 27.11.2017		国際調査報告の発送日 05.12.2017										
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		<table border="1"> <tr> <td>特許庁審査官 (権限のある職員)</td> <td>2Q</td> <td>5553</td> </tr> <tr> <td colspan="3">森川 能匡</td> </tr> <tr> <td>電話番号 03-3581-1101</td> <td>内線</td> <td>3292</td> </tr> </table>		特許庁審査官 (権限のある職員)	2Q	5553	森川 能匡			電話番号 03-3581-1101	内線	3292
特許庁審査官 (権限のある職員)	2Q	5553										
森川 能匡												
電話番号 03-3581-1101	内線	3292										

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 7 / 0 3 7 1 1 1
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 8-252211 A (オリンパス光学工業株式会社) 1996.10.01, 図 6 (ファミリーなし)	1-5

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT

Fターム(参考) 4C161 AA01 AA06 BB04 DD03 FF35 HH24

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	电梯和内窥镜		
公开(公告)号	JPWO2018070509A1	公开(公告)日	2019-07-04
申请号	JP2018545070	申请日	2017-10-13
[标]申请(专利权)人(译)	保谷股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	HOYA株式会社		
[标]发明人	細越泰嗣 齋藤惠一		
发明人	細越 泰嗣 齋藤 惠一		
IPC分类号	A61B1/018 G02B23/24		
CPC分类号	A61B1/00 A61B1/018 G02B23/24 A61B1/00098 A61B1/00137 A61B1/00181 G02B23/2476		
FI分类号	A61B1/018.514 G02B23/24.A		
F-TERM分类号	2H040/DA52 4C161/AA01 4C161/AA06 4C161/BB04 4C161/DD03 4C161/FF35 4C161/HH24		
优先权	2016202919 2016-10-14 JP		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供一个可以方便地连接到内窥镜尖端或从其拆卸的抬高架。抬起基座80包括可旋转地设置在内窥镜10的插入部分30的末端的杠杆60和用于旋转杠杆60的旋转部分24。在可与内窥镜(10)装卸的升降机中,包括:第一升降机(831),该第一升降机在一个表面上具有凹部(84);以及第二突起,其从第一升降机(831)的端部突出。设置有立起部(832)和设置在第二立起部(832)的端部并与杆(60)连接的杆连接部(81)。

