

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2014-210195

(P2014-210195A)

(43) 公開日 平成26年11月13日(2014.11.13)

| (51) Int.Cl. | F I | テーマコード (参考) |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| A61B 1/00 (2006.01) | A61B 1/00 300P | 2H040 |
| A61B 1/04 (2006.01) | A61B 1/04 372 | 4C161 |
| G02B 23/24 (2006.01) | G02B 23/24 B | |
| G02B 23/26 (2006.01) | G02B 23/26 D | |

審査請求 有 請求項の数 7 O L (全 14 頁)

(21) 出願番号 特願2014-131101 (P2014-131101)
 (22) 出願日 平成26年6月26日 (2014. 6. 26)
 (62) 分割の表示 特願2011-216676 (P2011-216676)
 の分割
 原出願日 平成23年9月30日 (2011. 9. 30)

(71) 出願人 306037311
 富士フイルム株式会社
 東京都港区西麻布2丁目26番30号
 (74) 代理人 100075281
 弁理士 小林 和憲
 (72) 発明者 北野 亮
 神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地
 富士フイルム株式会社内
 Fターム(参考) 2H040 BA03 CA04 CA23 CA24 DA12
 DA21 DA57 GA02
 4C161 FF35 FF45 JJ06 LL02


(54) 【発明の名称】 内視鏡用カメラモジュール及び内視鏡

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】カメラモジュールのプリズムの剥がれや伝送ケーブルの破断、接合部の剥離の発生を抑えられる内視鏡を提供する。

【解決手段】プリズム取付枠にプリズム41を固着する。ケーブル連結具45の一端を伝送ケーブル44に固着する。ケーブル連結具45の他端に設けた係止爪47を、プリズム保持具40の取付筒部40aの先端面に係止させた後に、取付筒部40aとケーブル連結具45とを固着する。先端硬質部の内周面にイメージエリアセンサ42を近接させて、カメラモジュール10を先端硬質部内に配置する。先端硬質部の内周面とイメージエリアセンサ42との間の空きスペースに、ケーブル連結具45を配置することができる。ケーブル連結具45を空きスペースの範囲内で大きくすることができ、連結強度を確保し、プリズム41や接合部の剥がれ、伝送ケーブル44の破断を抑えることができる。

【選択図】 図7

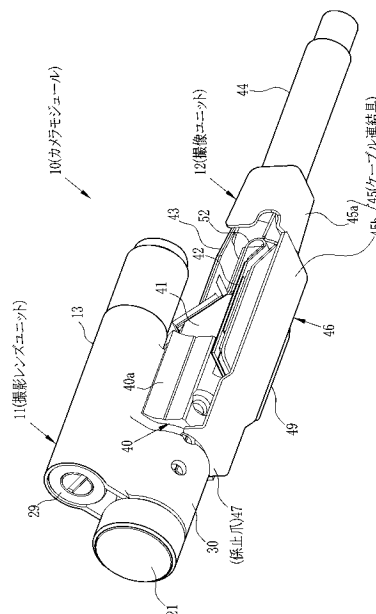

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

撮影レンズ、前記撮影レンズを保持するハウジングを有する撮影レンズユニットと、前記撮影レンズからの撮影光が入射する入射面、反射面、出射面を有するプリズムと、前記ハウジングの一端に取り付けられる取付筒部、前記プリズムの入射面への入射光が通過する開口、前記プリズムの入射面の周縁部が固着されるプリズム固着面を有するプリズム保持具と、

前記プリズムの出射面に取り付けられるイメージエリアセンサと、
前記イメージエリアセンサを駆動する回路基板と、

前記回路基板に接続される素線及び前記素線を束ねて保護する外皮を有する伝送ケーブルと、

前記撮影レンズを移動するレンズ移動部と、

前記イメージエリアセンサに近接して前記イメージエリアセンサと略平行に配置され、前記伝送ケーブルの前記外皮に一端が固着され、他端が前記取付筒部に取り付けられて、前記レンズ移動部との間に、前記プリズム及び前記イメージエリアセンサが配されるケーブル連結具とを有することを特徴とする内視鏡用カメラモジュール。

【請求項 2】

前記ハウジングは、前記撮影レンズを収納する第 1 筒部と、前記レンズ移動部を収納する第 2 筒部と、前記第 1 筒部及び第 2 筒部を連結する連結部を有し、前記第 2 筒部が前記第 1 筒部よりも長くされて後端側に段違い部分が形成されており、

前記プリズム保持具は前記段違い部分による前記第 1 筒部の後端側のスペースに配されることを特徴とする請求項 1 記載の内視鏡用カメラモジュール。

【請求項 3】

前記ケーブル連結具の他端には前記取付筒部の先端面に係止する係止爪が形成されていることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の内視鏡用カメラモジュール。

【請求項 4】

前記ケーブル連結具の他端部は前記取付筒部に固着されることを特徴とする請求項 1 から 3 いずれか 1 項記載の内視鏡用カメラモジュール。

【請求項 5】

前記ケーブル連結具は、長手方向に補強用の突条を有することを特徴とする請求項 1 から 4 いずれか 1 項記載の内視鏡用カメラモジュール。

【請求項 6】

前記ケーブル連結具は、長手方向に直交する幅方向で折り返されたバネ部を有することを特徴とする請求項 1 から 4 いずれか 1 項記載の内視鏡用カメラモジュール。

【請求項 7】

請求項 1 から 6 いずれか 1 項記載の内視鏡用カメラモジュールが取り付けられる円筒状の先端硬質部を有する内視鏡であって、

前記先端硬質部内で外周側に近接して前記イメージエリアセンサが配置されていることを特徴とする内視鏡。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は内視鏡用カメラモジュール及び内視鏡に関するものである。

【背景技術】

【0002】

内視鏡は、例えば患者の体内に挿入される挿入部を有する。この挿入部は、先端から順に、先端硬質部、湾曲部、軟性部となっている。そして、先端硬質部の先端面には、観察窓、照明窓、鉗子出口、送気・送水ノズルが設けられている。また、先端硬質部の内面には、観察窓に対応した位置でカメラモジュールが、照明窓に対応した位置でライトガイドがそれぞれ取り付けられている。湾曲部は、複数の節輪ユニットを連結して構成されてお

10

20

30

40

50

り、ワイヤ操作によって先端硬質部を所望の方向に向けることができる。軟性部は、被検体の所望の観察部位に先端硬質部を到達させるために、1 m ~ 2 m 程度の長さとなっている。

【0003】

カメラモジュールは撮影レンズユニット及び撮像ユニットから構成されている。撮影レンズユニットは、ハウジング内に複数個のレンズを収納して構成されている。撮像ユニットは、撮影レンズユニットによって結像された光学画像を撮像信号に光電変換するCCDやCMOS等のイメージエリアセンサを有する。イメージエリアセンサはフレキシブル基板やサブ基板などの回路基板を介して伝送ケーブルに接続されている。また、フレキシブル基板やサブ基板にはイメージエリアセンサを駆動するために電子部品が実装されている。撮像ユニットからの信号は、フレキシブル基板やサブ基板、伝送ケーブルを介して画像処理装置に送られる。画像処理装置では信号を画像処理して、モニタに病変等の画像を表示する。

10

【0004】

撮像ユニットからの信号を画像処理装置に送る伝送ケーブルは、複合多芯ケーブルから構成されている。この伝送ケーブルは、挿入部の全長にわたって挿通されているので、挿入部がループされたり湾曲されたりする度に、強く押し引きされる。伝送ケーブルが引き込まれると、基板の接合部が剥離したり、伝送ケーブルが切断したりする場合がある。

【0005】

このような剥離や切断を回避するため、種々の提案がなされている。例えば、特許文献1記載の内視鏡では、フレキシブル基板の一端側に伝送ケーブルが半田付けされるとともに、その半田付けされた伝送ケーブルを囲むようにフレキシブル基板がコの字状に折り曲げられ、その周囲をシールドテープと絶縁テープによって被覆され、この内部空間にエポキシ系の接着剤が充填されて変形しないように固められている。さらに、伝送ケーブルが固定された側の回路基板は、押さえ板を介して、固定ねじによって連結筒に固定されているため、伝送ケーブルが強く押し引きされても、回路基板は動かず、伝送ケーブルから回路基板に加わるねじれや傾きの力も、可撓性のある回路基板で吸収されて、イメージエリアセンサ及び対物光学系には伝わらない。

20

【0006】

特許文献2記載のカメラモジュールでは、フレキシブル基板と伝送ケーブルの接続部は封止材で覆い固められている。

30

【0007】

特許文献3記載のカメラモジュールは、イメージエリアセンサ及びフレキシブル基板の電子部品実装部を収容する補強枠を備え、この補強枠の内側に接着剤を充填している。さらに、フレキシブル基板に半田付けされた伝送ケーブルの先端部分と補強枠とを熱収縮チューブで覆い、この内側に接着剤を充填して密封している。

【0008】

特許文献4記載のカメラモジュールでは、撮影レンズの焦点距離を可変する機構を備え、通常観察及び拡大観察の間で焦点距離を切り換えることが可能になっている。このようなカメラモジュールでは、撮影レンズユニットと撮像ユニットとを分離可能に構成し、撮像ユニットのプリズム保持具を介して、撮影レンズユニットに固着し、一体化することで、カメラモジュールを構成している。

40

【先行技術文献】

【特許文献】

【0009】

【特許文献1】特開平5 - 261064号公報

【特許文献2】特開平9 - 146011号公報

【特許文献3】特開2008 - 118568号公報

【特許文献4】特開2004 - 283486号公報

【発明の概要】

50

【発明が解決しようとする課題】

【0010】

特許文献1記載のカメラモジュールでは、回路基板を固定ねじによって連結筒に固定するという煩雑な作業が必要となるという欠点がある。特許文献2記載のカメラモジュールでは、伝送ケーブルが押し引きされる力は、フレキシブル基板との接合部やフレキシブル基板に伝わる。フレキシブル基板に伝わった力は、伝送ケーブルとフレキシブル基板との半田付け部やフレキシブル基板とイメージエリアセンサとの接合部等にかかることになり、これらのいずれが弱いところに剥離や破損が生じる懸念がある。

【0011】

特許文献3記載のカメラモジュールでは、イメージエリアセンサを補強枠の内部に収納する関係上、イメージエリアセンサのサイズによって補強枠のサイズが影響を受ける。内視鏡への要求も高画質化、細径化、オートクレーブ対応など多様化しており、それに伴いイメージエリアセンサ及びその周辺の部品も多様化且つ複雑化している。イメージエリアセンサ及びその周辺部品に機能が増えることで大型化すると、これをすべて収納する補強枠も大型化するため、内視鏡挿入部の先端硬質部の径が大きくなり、患者の負担が増加するという欠点がある。

10

【0012】

特許文献4記載のカメラモジュールでは、プリズム保持具を介しプリズムを固定し、この固定したプリズムに撮像素子や回路基板などを固着している。さらに、回路基板には伝送ケーブルが接続されている。このため、伝送ケーブルの接続部分に引っ張り力が作用し、断線の原因になる。また、プリズムとイメージエリアセンサとは全面で接着されているものの、プリズム保持具には撮影レンズユニットからの光をプリズムの入射面に入射させる関係で開口が形成されているため、全面接着は不可能になり、入射面の周縁部と保持具とが接着されるだけとなり、伝送ケーブルが引っ張られると、この部分からプリズムが剥がれるおそれがある。

20

【0013】

本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、伝送ケーブルが強く押し引きされた場合でも、伝送ケーブル、フレキシブル基板、イメージエリアセンサ等の部品の破損やこれらの接合部や、プリズム保持具とプリズムの剥離の発生を抑えることができ、しかも先端硬質部の径を細くすることで患者への負担が軽減可能な内視鏡用カメラモジュール及び内視鏡を提供することを目的とする。

30

【課題を解決するための手段】

【0014】

上記目的を達成するために、本発明の内視鏡用カメラモジュールは、撮影レンズ、撮影レンズを保持するハウジングを有する撮影レンズユニットと、撮影レンズからの撮影光が入射する入射面、反射面、出射面を有するプリズムと、ハウジングの一端に取り付けられる取付筒部、プリズムの入射面への入射光が通過する開口、プリズムの入射面の周縁部が固着されるプリズム固着面を有するプリズム保持具と、プリズムの出射面に取り付けられるイメージエリアセンサと、イメージエリアセンサを駆動する回路基板と、回路基板に接続される素線及び素線を束ねて保護する外皮を有する伝送ケーブルと、撮影レンズを移動するレンズ移動部と、イメージエリアセンサに近接してイメージエリアセンサと略平行に配置され、伝送ケーブルの外皮に一端が固着され、他端が取付筒部に取り付けられて、レンズ移動部との間に、プリズム及びイメージエリアセンサが配されるケーブル連結具とを有することを特徴とする。

40

【0015】

なお、ハウジングは、撮影レンズを収納する第1筒部と、レンズ移動部を収納する第2筒部と、第1筒部及び第2筒部を連結する連結部を有し、第2筒部が第1筒部よりも長くされて後端側に段違い部分が形成されており、プリズム保持具は段違い部分による第1筒部の後端側のスペースに配されることが好ましい。この場合には、段違い部分の余剰スペースを有効利用してプリズム保持具が配されるため、内視鏡用カメラモジュールをコンパ

50

クトにまとめることができる。ケーブル連結具の他端には取付筒部の先端面に係止する係止爪が形成されていることが好ましい。また、ケーブル連結具の他端部は取付筒部に固着されることが好ましい。また、ケーブル連結具は、長手方向に補強用の突条を有することが好ましい。ケーブル連結具は、長手方向に直交する幅方向で折り返されたバネ部を有することが好ましい。

【0016】

また、本発明は、上記内視鏡用カメラモジュールが取り付けられる円筒状の先端硬質部を有する内視鏡であって、先端硬質部内で外周側に近接してイメージエリアセンサが配置されることを特徴とする。

【発明の効果】

10

【0017】

本発明によれば、プリズム保持具を介して撮像ユニットが配置されるため、全体として、レンズ移動部及び撮影レンズユニットと、撮像ユニットとをコンパクトにまとめることができる。また、内視鏡の挿入部が繰り返して曲げられて伝送ケーブルが引っ張られる場合でも、ケーブル連結具により引っ張り力がプリズム保持具に伝達されるため、プリズムや回路基板などに引っ張り力が作用することがなく、プリズムの剥離や断線などが発生することがない。また、プリズムの出射面に取り付けられて、撮影光軸に交差する方向に配置されるイメージエリアセンサが、先端硬質部内で外周側に近接して配置されることにより、先端硬質部の外周側でイメージエリアセンサとの間の空きスペースに、ケーブル連結具を配置することができる。ケーブル連結具を空きスペースの範囲内で大きくすることができ、連結強度を確保し、プリズムや接合部の剥がれ、ケーブル破断を抑えることができる。

20

【図面の簡単な説明】

【0018】

【図1】撮影レンズユニットを分解して示す斜視図である。

【図2】ハウジングを正面斜めから見た斜視図である。

【図3】撮影レンズユニットを分解して示す断面図である。

【図4】標準位置のカメラモジュールの要部断面図である。

【図5】拡大位置のカメラモジュールの要部断面図である。

【図6】ハウジングとプリズム保持具とイメージエリアセンサ等の電装部品とを分解して示す斜視図である。

30

【図7】カメラモジュールの全体外観を示す斜視図である。

【図8】同側面図である。

【図9】ケーブル連結具を示す斜視図である。

【図10】別の実施形態のケーブル連結具を示す側面図である。

【図11】図10におけるXI-XI線に沿うケーブル連結具の断面図である。

【図12】別の実施形態のケーブル連結具を示す側面図である。

【図13】電子内視鏡システムの構成を示す斜視図である。

【図14】内視鏡先端硬質部の断面図である。

【図15】電子内視鏡の先端硬質部を示す斜視図である。

40

【発明を実施するための形態】

【0019】

図1～図3に示すように、撮影レンズユニット11は、ハウジング13と、これらハウジング13内に収納される撮影レンズ14、レンズ移動部15とを有する。

【0020】

撮影レンズ14は、第1固定レンズ21、第1可動レンズ22、第2可動レンズ23、第2固定レンズ24を光軸方向に順に配置して構成されている。各固定レンズ21、24、各可動レンズ22、23は、レンズ枠21a～24aと、これらレンズ枠21a～24aで保持される1枚または複数枚のレンズ本体21b～24bとから構成される。

【0021】

50

レンズ移動部 15 は、カム軸 25 と、このカム軸 25 上で摺動移動する第 1 レンズ移動
 枠 26 及び第 2 レンズ移動枠 27 とを備える。このレンズ移動部 15 は、可動レンズ 22
 , 23 を光軸方向に移動させ、撮影レンズ 14 の焦点距離を変えて変倍撮影を可能にする
 。

【0022】

ハウジング 13 は、第 1 筒部 30 と第 2 筒部 31 とを筒心方向に直交する方向で並べて
 連結部 32 で連結して構成されている。図 2 に示すように、第 2 筒部 31 の外径は第 1 筒
 部 30 の外径より少し小さくされており正面から見て 8 の字形になっている。第 1 筒部 3
 0 には撮影レンズ収納穴 33 が形成されて、この穴 33 に撮影レンズ 14 が収納される。
 第 2 筒部 31 にはレンズ移動部収納穴 34 が形成されて、レンズ移動部 15 が収納される
 。図 3 に示すように、レンズ移動部収納穴 34 内には、係止リング 34 a が突出して形成
 されている。また、連結部 32 内には撮影レンズ収納穴 33 とレンズ移動部収納穴 34 を
 連結する摺動穴 35 が形成されている。

10

【0023】

図 1 及び図 3 に示すように、カム軸 25 は外周面に 2 個のカム溝 25 a , 25 b を有し
 、後端に軸心に沿ってワイヤ連結穴 25 c、後端部外周面に係止フランジ 25 d を有する
 。図 4 に示すように、ワイヤ連結穴 25 c には回転駆動用のワイヤ 18 の先端が固定され
 る。ワイヤ 18 は保護チューブ 19 に入れられて手元操作部 67 内のモータ 80 (図 1 3
 参照) に連結されている。モータ 80 は手元操作部 67 のシーソースイッチ 79 の操作に
 よって正転または逆転するように図示しないコントローラにより駆動制御される。

20

【0024】

図 1 及び図 3 に示すように、カム軸 25 の先端には固定リング 29 が取り付けられてい
 る。この固定リング 29 により、図 4 に示すように、レンズ移動部収納穴 34 内でカム軸
 25 が傾くことなく円滑に回転する。また、カム軸 25 の後端側の係止フランジ 25 d は
 、係止リング 34 a に係止するため、レンズ移動部収納穴 34 からカム軸 25 が抜け出す
 ことがない。

【0025】

図 1 及び図 3 に示すように、第 1 レンズ移動枠 26 は、ガイド筒 26 a とレンズ枠 22
 a とこれらを連結するアーム 26 b とを有し、これらが一体に形成されている。同様にし
 て、第 2 レンズ移動枠 27 も、ガイド筒 27 a , レンズ枠 23 a , アーム 27 b を有し、
 一体に形成されている。第 1 レンズ移動枠 26 のガイド筒 26 a には第 1 係合ピン 28 a
 が取り付けられ、この係合ピン 28 a の先端は第 1 カム溝 25 a に入り込む。また、第 2
 レンズ移動枠 27 のガイド筒 27 a には係合ピン 28 b が取り付けられ、この第 2 係合ピ
 ン 28 b は第 2 カム溝 25 b に入り込む。

30

【0026】

カム軸 25 がモータ 80 (図 1 3 参照) により正転または逆転すると、この回転量に応
 じてカム軸 25 が回転変位し、この回転変位によって各係合ピン 28 a , 28 b を介して
 、第 1 及び第 2 レンズ移動枠 26 , 27 がハウジング 13 内で光軸方向に移動する。

【0027】

図 4 及び図 5 は撮影レンズの焦点距離の切り換えを説明するもので、図 4 は標準位置を
 示し、図 5 は拡大位置を示している。拡大位置では、第 1 レンズ移動枠 26 が標準位置よ
 りも前側に移動し、第 2 レンズ移動枠 27 が標準位置よりも後ろ側に移動する。

40

【0028】

第 1 及び第 2 レンズ移動枠 26 , 27 がカム軸 25 の回転により光軸方向で円滑に移動
 するように、本実施形態では、第 1 及び第 2 レンズ移動枠 26 , 27 のアーム 26 b , 2
 7 b の厚みと、摺動穴の摺動案内面間距離の嵌合時の隙間が例えば $3 \pm 3 \mu\text{m}$ になるよう
 に、これら各部品を採寸して $3 \pm 3 \mu\text{m}$ の隙間内で組み合わせるもの同士を選択して、こ
 れらを組として使用する。

【0029】

図 3 に示すように、撮影レンズ収納穴 33 は、ハウジング 13 の先端から後端に向かっ

50

て順に、第1固定レンズ21及び第1可動レンズ22を収納する第1収納部33a、第2可動レンズ23を収納する第2収納部33b、第2固定レンズ24を収納する第3収納部33cが形成されている。第2収納部33bと第3収納部33cとの間には、仕切りとなるリング突起33dが形成されている。第2収納部33bは第1収納部33aの内径よりも少し小さく形成されており、第2収納部33bと第3収納部33cとは同じ内径で形成されている。

【0030】

前記第2収納部33bには、第2反射防止筒37が収納される。第2反射防止筒37は筒状に形成されており、光軸方向にスリット37aを有する。このスリット37aに第2レンズ移動枠27のアーム27bが入り、筒内には、第2レンズ移動枠27のレンズ枠23aが入る。筒内径は、レンズ枠23aの外径よりも僅かに大きく形成されており、レンズ枠23aが筒部内を移動する際に、筒部内周面にレンズ枠23aが接触することはない。

10

【0031】

第1収納部33aには、第1反射防止筒36が収納される。第1反射防止筒36も、第2反射防止筒37と同様に形成されており、スリット36aを有する。第2反射防止筒37と異なっている点は後端に絞り板38が一体形成されている点である。この第1反射防止筒36は、第1収納部33aと第2収納部33bとの間の段差面33eによって、その後端面が係止し、収納時に位置決めされる。第1反射防止筒36内では、第1レンズ移動枠26のレンズ枠22aが移動する。

20

【0032】

図3に示すように、フレアの発生を防止するために、第1固定レンズ21のレンズ枠21a、第1可動レンズ22のレンズ枠22aを一体に有する第1レンズ移動枠26と、第2可動レンズ23のレンズ枠23aを有する第2レンズ移動枠27と、第2固定レンズ24のレンズ枠24a、及び第1及び第2反射防止筒36、37が黒染め加工されて、その表面に黒色層39が形成されている。黒染め加工は周知の方法のいずれを使用してもよく、例えば黒染め処理液を用いた化学処理にて黒色層39が形成される。なお、黒色層39は、僅かな厚みの断面として現れるため、厚みを付けた図示は省略してある。これに対して、ハウジング13は、複雑な形状を呈しており、外径寸法が7mm×4mm×15mm程度の微小な部品であるので、所望の厚さの黒色層39が内周面に形成されないこともあり、黒染め加工は行わない。

30

【0033】

図6に示すように、第2筒部31はカム軸25を収納する関係で第1筒部30よりも長く形成されている。そして、互いの先端は揃えてあり、後端は、第1筒部30の後端よりも第2筒部31の後端が後方に突出した段違いに形成されている。この二つの筒部30、31による後端の段違い部分によって、第1筒部30の後端側にはスペースが生じる。このスペースを利用して、図7、図8に示すように、撮影レンズユニット11には撮像ユニット12が取り付けられ、カメラモジュール10が構成される。

【0034】

図6に示すように、ハウジング13の第1筒部30の外周面の後半分30aは、外周面の前半分30bよりも外径を僅かに小さく形成してあり、前半分30bと後半分30aとの間に段差面30cが形成される。この外周面の後半分30aには、撮像ユニット12のプリズム保持具40が取り付けられる。このように、第1筒部30の後端側のスペースに、プリズム保持具40を介して撮像ユニット12を配置することにより、全体として、カメラモジュール10をコンパクトに構成することができる。

40

【0035】

図7及び図8に示すように、撮像ユニット12は、プリズム保持具40、プリズム41、CCD型イメージエリアセンサ42、回路基板43、伝送ケーブル44、ケーブル連結具45、放熱板49及び配線類を封止する封止剤(図示省略)とを有する。なお、ハウジング13に形成される穴48は、反射防止筒36、37や第2固定レンズ24を撮影レン

50

ズ収納穴 33 内に固定するときの、接着剤注入やネジ挿入のためのものであり、必要に応じて設けられる。

【0036】

図 6 に示すように、プリズム保持具 40 は、取付筒部 40 a とプリズム取付枠 40 b とを有する。プリズム 41 は、直角に交差する入射面 41 a , 出射面 41 b と、斜面からなる反射面 41 c と、両側面 41 d との 5 面を有する直角プリズムから構成されている。プリズム取付枠 40 b は、撮影レンズ 14 からの入射光が通る開口部 40 c (図 4 参照) を有し、プリズム取付枠 40 b の後端面には位置決め片 40 d (図 10 参照) を有する。位置決め片 40 d は、プリズム 41 の側面 41 d が当接することにより、プリズム 41 の位置決めを行う。したがって、微小な部品同士を組み立てる際に、別個の位置規制治具など

10

【0037】

図 7 及び図 8 に示すように、プリズム 41 の出射面 41 b にはイメージエリアセンサ 42 が、プリズム 41 の斜面にはイメージエリアセンサ 42 を駆動するための回路基板 43 が接着剤にて取り付けられる。回路基板 43 は、フレキシブル配線回路基板 52 や結線 (図示省略) などを介して、イメージエリアセンサ 42 と接続されている。回路基板 43 には、伝送ケーブル 44 の素線 (信号線) 44 a が接続される。図 6 に示すように、伝送ケーブル 44 は、複数の素線 44 a と、これらを束ねてシールドするシールド線 44 b と、これを覆う外皮 44 c とから構成されている。なお、回路基板 43 はメイン基板の他に、複数のサブ基板を有していてもよい。

20

【0038】

イメージエリアセンサ 42 の外側には放熱板 49 が固着されている。この放熱板 49 の後端にはケーブル受け部 49 a が形成されており、このケーブル受け部 49 a は、伝送ケーブル 44 のシールド線に半田付けされる。放熱板 49 はイメージエリアセンサ 42 からの熱を伝送ケーブル 44 に逃がす。

【0039】

伝送ケーブル 44 の外皮 44 c には放熱板 49 のケーブル受け部 49 a と同じ側で、ケーブル連結具 45 の一端が接着剤により固着される。ケーブル連結具 45 は、取付枠部 45 a と連結板部 45 b とから構成される。取付枠部 45 a は、金属板の両側部を折り曲げて断面 U 字状に形成されている。この枠内には接着材が充填されて、伝送ケーブル 44 と一体化される。

30

【0040】

連結板部 45 b は、平板を折り曲げて中央付近にオフセット部 46、先端に係止爪 47 が形成されている。オフセット部 46 は、イメージエリアセンサ 42 や放熱板 49 が当たることがないようにオフセット量で形成されている。係止爪 47 は 90° に折り曲げて形成されており、先端縁は、ハウジング 13 の第 1 筒部 30 の外周面に沿うように円弧状に形成されている。係止爪 47 とオフセット部 46 との間は、取付筒部 40 a との接着面となっており、この部分に接着材が充填されることで、ケーブル連結具 45 がプリズム保持具 40 に固着される。オフセット部 46 は、イメージエリアセンサ 42 と、プリズム保持具 40 の取付筒部 40 a の外周面との位置関係に応じて設けられるものであり、取付筒部 40 a の外周面からイメージエリアセンサ 42 を覆う放熱板 49 が外側に突出していない場合には、オフセット部 46 は不要で、平板状に構成してよい。

40

【0041】

ケーブル連結具 45 やイメージエリアセンサ 42 及び回路基板 43 に覆われた結線部や素線などを保護するために、これらの隙間には必要に応じて、封止剤 (図示省略) が注入されて固化される。

【0042】

ケーブル連結具 45 は、イメージエリアセンサ 42 の両側方を覆うことがないように、

50

板状に形成されている。したがって、イメージエリアセンサ 42 のサイズが変更される場合でも、サイズ変更によりイメージエリアセンサ 42 が大きくなっても連結板部 45 b に接触してしまうことがなくなり、イメージエリアセンサ 42 のサイズ変更などにも対応が可能となる。また、イメージエリアセンサ 42 を保護する放熱板 49 も棒状ではなく、板状であるので、イメージエリアセンサ 42 のサイズが変更される場合でも、現状の構造でサイズ変更が可能になる。

【0043】

上記実施形態では、取付筒部 40 a の先端面に係止爪 47 を係止させて固着したが、係止爪 47 を先端面に係止する代わりに、取付筒部 40 a に形成した段部や係止穴に係止爪を係止させてもよい。

10

【0044】

図 10 及び図 11 は、別の実施形態のケーブル連結具 54 を用いた撮像ユニット 55 を示すものである。このケーブル連結具 54 では、図 9 に示すケーブル連結具 45 に長手方向に補強リブとしての突条 54 a を突出して形成したものである。突条 54 a の断面形状は、図 11 に示すような円弧状の他に、三角状やその他の各種形状であってもよい。

【0045】

図 12 は、別の実施形態のケーブル連結具 56 を用いた撮像ユニット 57 を示すものである。このケーブル連結具 56 では、図 9 に示すケーブル連結具 45 のオフセット部 46 と取付棒部 45 a との間にパネ部 58 を設けている。パネ部 58 は、連結板部 45 b の長手方向に直交する幅方向の折り曲げ線で折り曲げたものである。折り曲げ箇所は例えば 4 箇所とし、下方に向かう第 1 折り曲げ部 58 a と上方に向かう第 2 折り曲げ部 58 b としているが、折り曲げ個数や折り曲げ形状は適宜変更してよい。この実施形態では、伝送ケーブル 44 が引っ張られることで、伝送ケーブル 44 とケーブル連結具 56 との間で曲げ力が作用してもこのパネ部 58 が曲げ力の干渉材または吸収材として作用するため、伝送ケーブル 44 とケーブル連結具 56 との間での曲げ力が緩和され、剥離や断線などが発生することが抑えられる。

20

【0046】

上記のように構成されるカメラモジュール 10 は、図 13 に示すように、電子内視鏡 60 の挿入部 66 に取り付けられる。電子内視鏡システム 59 は、電子内視鏡 60、プロセッサ装置 61、光源装置 62 を有する。電子内視鏡 60 は、患者の体腔内に挿入される可撓性の挿入部 66 と、挿入部 66 の基端部分に連設された手元操作部 67 と、プロセッサ装置 61 および光源装置 62 に接続されるコネクタ 69 a と、手元操作部 67、コネクタ 69 a 間を繋ぐユニバーサルコード 69 とを有する。

30

【0047】

挿入部 66 は、先端から順に、先端硬質部 66 a、湾曲部 66 b、及び軟性部 66 c となっている。先端硬質部 66 a の断面形状を示す図 14 において、先端硬質部 66 a は、硬質樹脂製の先端部本体 63 に、軟質樹脂製の先端キャップを被せ、先端部本体 63 とこれに続く湾曲部 66 b の金属製先端筒 86 をチューブにより被覆して構成される。

【0048】

先端部本体 63 内には、本発明のカメラモジュール 10 の他に、ライトガイド 82 a、82 b、鉗子チャンネル 83、送気チューブ 84、送水チューブ 85 が取り付けられている。カメラモジュール 10 は、先端部本体 63 に形成した取り付け穴にハウジング 13 が入り込み、ネジ止めされることにより先端部本体 63 に固定される。カメラモジュール 10 のイメージエリアセンサ 42 は、先端部本体 63 の内周面、正確には湾曲部 66 b の金属製先端筒 86 の内周面に近接するように配置される。これにより、ライトガイド 82 a、82 b の間に撮影レンズユニットが配置され、カム軸駆動用のワイヤ 18 は送気チューブ 84 とライトガイド 82 b との間に配置されるので、先端硬質部 66 a 内で、各内蔵物の間の隙間を少なくして、これら内蔵物を効率良く配置することができる。

40

【0049】

特に、先端筒 86 の円筒内でイメージエリアセンサ 42 が外側近くに配置されるため、

50

イメージエリアセンサ 42 と先端筒 86 の内周面 86a との間には、隙間が形成されて、この隙間部分がデッドスペース 87 となる。本発明では、このデッドスペース 87 に、ケーブル連結具 45 が配置されるため、デッドスペース 87 を有効利用することができ、その分だけ、挿入部 66 の細径化が図れる。また、デッドスペースの空間を利用して、第 2 及び第 3 実施形態のような突条 54a やバネ部 58 を形成することで、ケーブル連結具 54, 56 を補強したり緩衝材として利用することができる。

【0050】

湾曲部 66b は各節輪がピン結合されたユニットを有し、全体が湾曲する。湾曲部 66b は、手元操作部 67 のアングルノブ 70 の回転操作により、上下左右方向に任意角度で湾曲する。これにより、先端硬質部 66a を体腔内の所望の方向に向けて、体腔内の観察部位をカメラモジュール 10 で撮像することができる。軟性部 66c は、手元操作部 67 と湾曲部 66b との間を細径で長尺状に繋ぐ部分であり、可撓性を有している。

10

【0051】

図 15 に示すように、先端硬質部 66a の先端面には、鉗子出口 72 の他に、観察窓 73、照明窓 74a, 74b、及び送気・送水ノズル 75 が設けられる。観察窓 73 には、本発明のカメラモジュール 10 のレンズ 21 が配置され、照明窓 74a, 74b にはライトガイド 82a, 82b が連結され、送気・送水ノズル 75 には送気チューブ 84、送水チューブ 85 が連結される。また、必要に応じて、ウォータジェット噴き出し口やその他のノズルなどが設けられる。

【0052】

手元操作部 67 は、アングルノブ 70、送気・送水ボタン 76、吸引ボタン 77、リリースボタン 78、ズーム操作のシーソースイッチ 79 などの各種操作部材を備えている。アングルノブ 70 は、回転操作によって挿入部 66 の先端硬質部 66a を上下左右方向に湾曲させる。送気・送水ボタン 76 は、押圧操作によって送気・送水ノズル 75 からエアまたは水を噴出させる。吸引ボタン 77 は、押圧操作によって、体内の液体や組織等の被吸引物を鉗子出口 72 から吸引する。リリースボタン 78 は、押圧操作によってカメラモジュール 10 により観察画像を静止画記録する。シーソースイッチ 79 は、モータ 80 を正転または逆転させて、この回転をワイヤ 18 を介してカム軸 25 に伝達し、撮影レンズ 14 を標準及び拡大撮影に切り換える。

20

【0053】

プロセッサ装置 61 は、光源装置 62 と電氣的に接続され、電子内視鏡システム 59 の動作を統括的に制御する。プロセッサ装置 61 は、ユニバーサルコード 69 や挿入部 66 内に挿通された伝送ケーブル 44 を介して電子内視鏡 60 に給電を行い、先端硬質部 66a のカメラモジュール 10 の駆動を制御する。また、プロセッサ装置 61 は、伝送ケーブル 44 を介してカメラモジュール 10 からの信号を受信し、各種処理を施して画像データを生成する。プロセッサ装置 61 にはモニタ 81 が接続されている。モニタ 81 は、プロセッサ装置 61 からの画像データに基づき観察画像を表示する。

30

【0054】

なお、上記実施形態では、撮影レンズユニット 11 として、可動レンズ 22, 23 を 2 個用いる例で説明したが、可動レンズは 1 個以上であればよい。また、可動レンズを有し、変倍や合焦を行うものに代えて、固定焦点の撮影レンズユニットに本発明を適用してもよい。また、上記実施形態では、本発明を医療用の内視鏡に適用する例で説明をしたが、本発明を工業用の内視鏡に適用してもよい。

40

【符号の説明】


【0055】

- 10 カメラモジュール
- 11 撮影レンズユニット
- 12 撮像ユニット
- 40 プリズム保持具
- 41 プリズム


50

- 4 2 CCD型イメージリアセンサ
- 4 4 伝送ケーブル
- 4 5 , 5 4 , 5 6 ケーブル連結具
- 5 9 電子内視鏡システム
- 6 0 内視鏡
- 6 6 挿入部
- 6 7 手元操作部


【 図 1 】

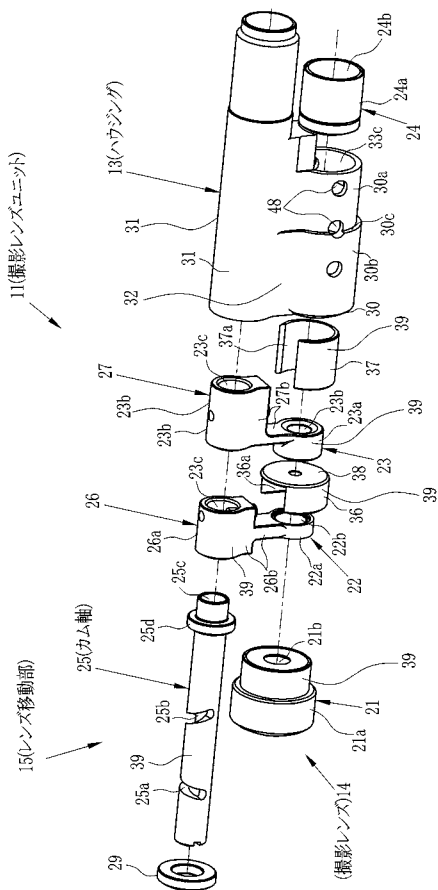


【 図 2 】

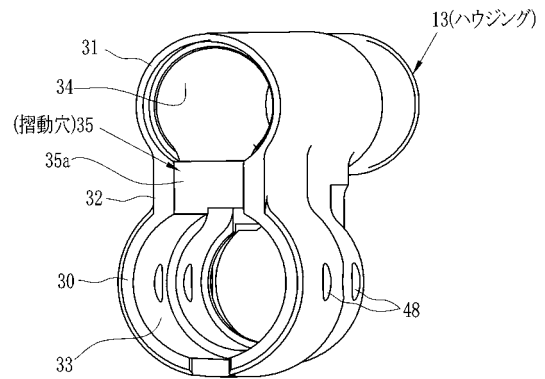


【 図 3 】

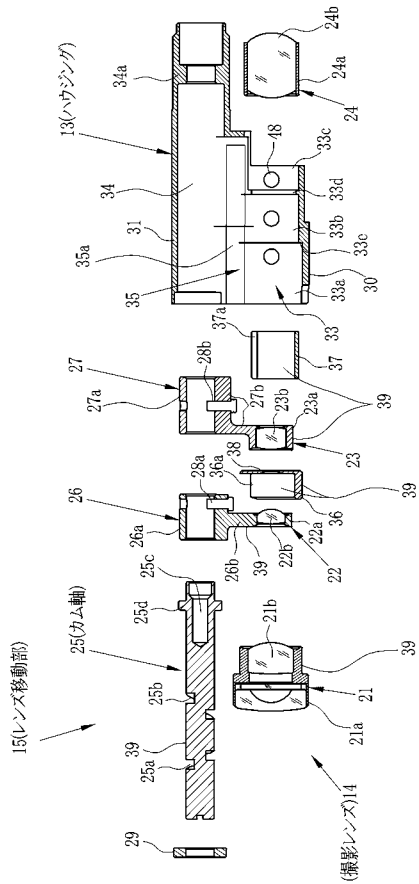


【 図 4 】

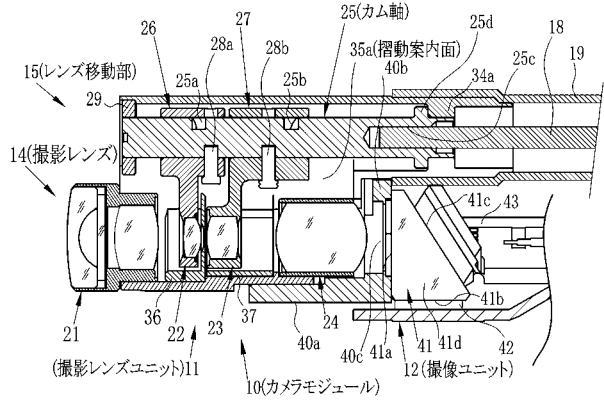


【 図 5 】

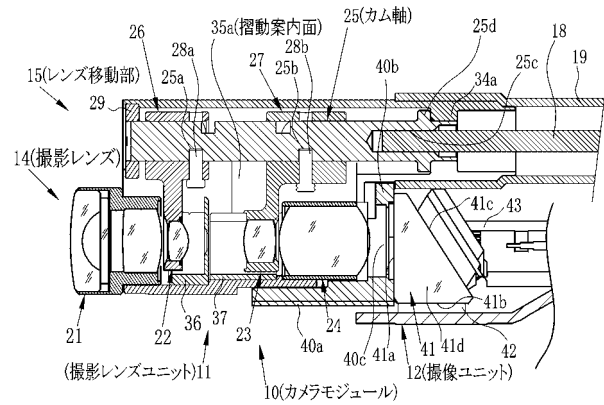


【 図 6 】

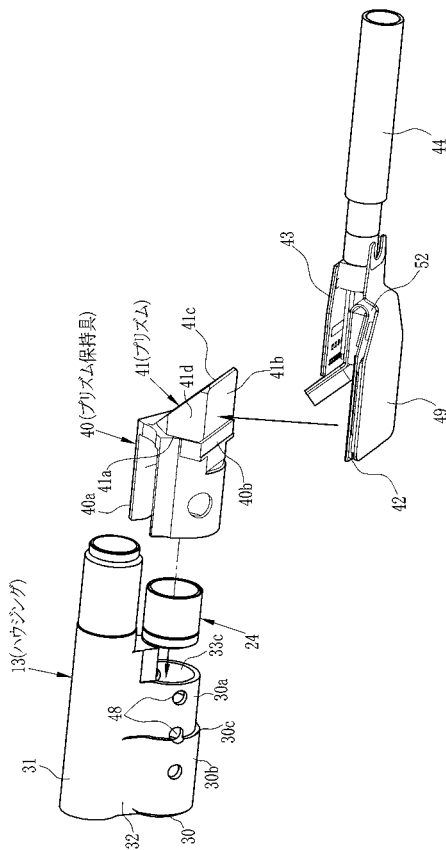


【 図 7 】

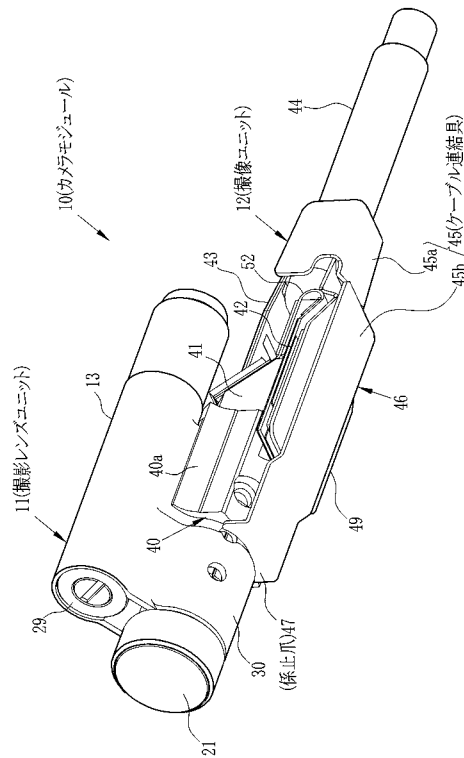


【 図 8 】

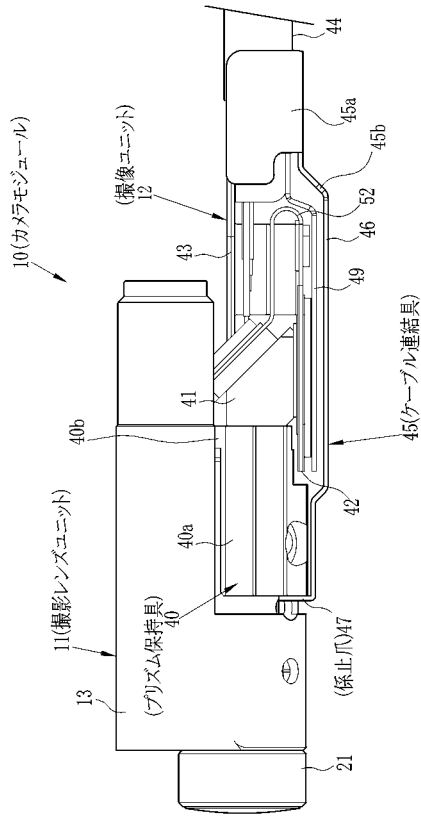


【 図 9 】

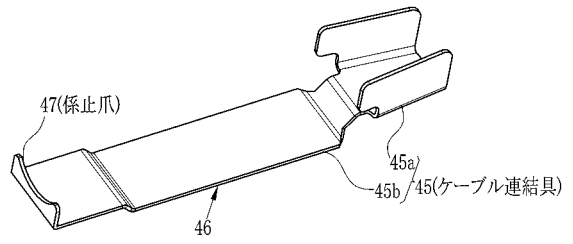


【 図 10 】

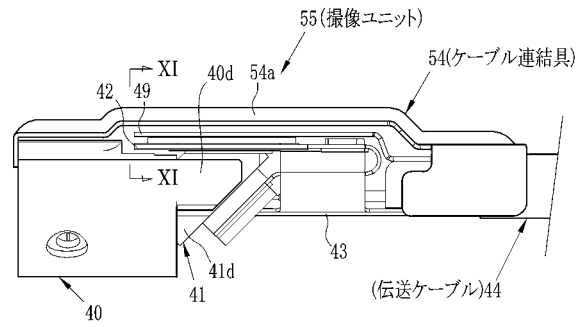


【 図 11 】

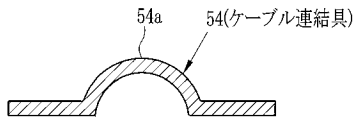


【 図 13 】

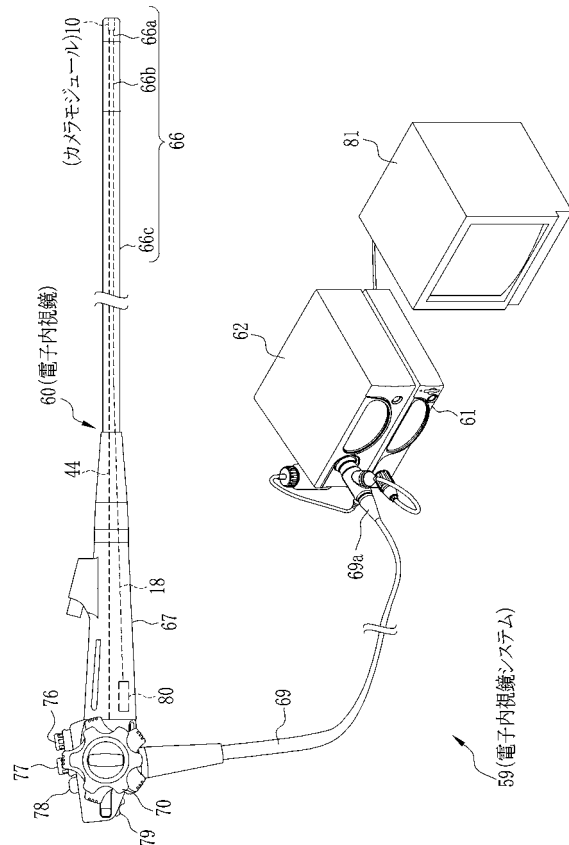


【 図 12 】

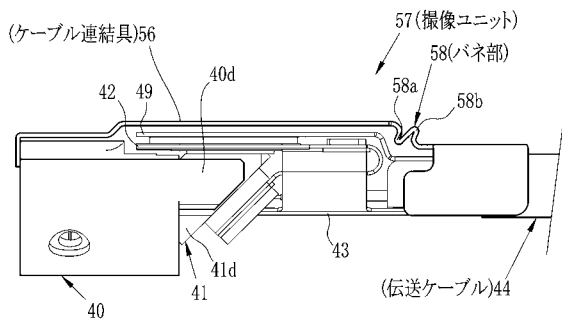

【 図 1 4 】

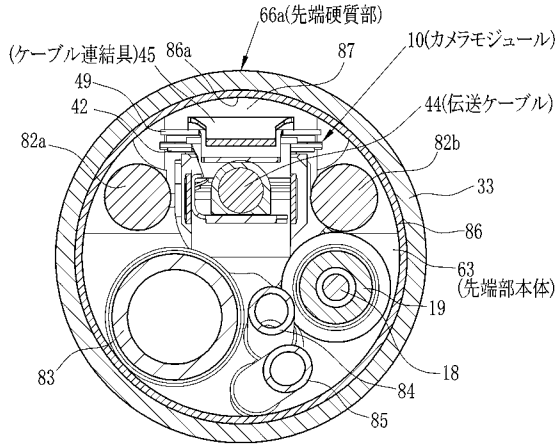

【 図 1 5 】

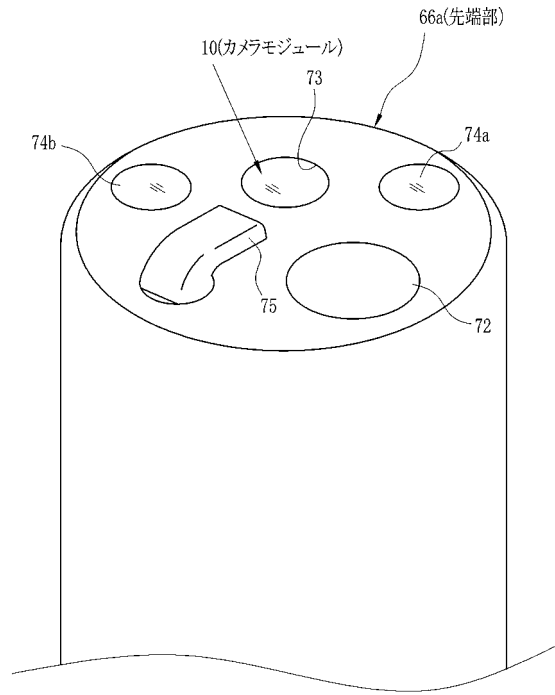

| | | | |
|----------------|---|---------|------------|
| 专利名称(译) | 内窥镜摄像头模块和内窥镜 | | |
| 公开(公告)号 | JP2014210195A | 公开(公告)日 | 2014-11-13 |
| 申请号 | JP2014131101 | 申请日 | 2014-06-26 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 富士胶片株式会社 | | |
| 申请(专利权)人(译) | 富士胶片株式会社 | | |
| [标]发明人 | 北野亮 | | |
| 发明人 | 北野 亮 | | |
| IPC分类号 | A61B1/00 A61B1/04 G02B23/24 G02B23/26 | | |
| FI分类号 | A61B1/00.300.P A61B1/04.372 G02B23/24.B G02B23/26.D A61B1/00.715 A61B1/00.717 A61B1/00.735 A61B1/04.530 A61B1/05 | | |
| F-TERM分类号 | 2H040/BA03 2H040/CA04 2H040/CA23 2H040/CA24 2H040/DA12 2H040/DA21 2H040/DA57 2H040/GA02 4C161/FF35 4C161/FF45 4C161/JJ06 4C161/LL02 | | |
| 代理人(译) | 小林和典 | | |
| 其他公开文献 | JP5750186B2 | | |
| 外部链接 | Espacenet | | |

摘要(译)

解决的问题：提供一种内窥镜，其能够抑制照相机模块的棱镜的剥离，传输电缆的破损以及接合部的剥离。棱镜固定在棱镜安装框架上。电缆连接器45的一端固定到传输电缆44。在将设置在电缆连接构件45的另一端的锁定爪47锁定到棱镜保持器40的安装圆筒部40a的顶端表面之后，安装圆筒部40a和电缆连接构件45被固定。使图像区域传感器42靠近硬尖端部分的内周表面，并且相机模块10布置在硬尖端部分中。电缆连接器45可以布置在远端硬部的内周表面与图像区域传感器42之间的空白空间中。可以在空闲空间的范围内增加电缆连接器45的尺寸，确保连接强度，并防止棱镜41和接头脱落并且传输电缆44断裂。[选择图]图7

