

(19) 日本国特許庁(JP)

## 再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02017/061003

発行日 平成30年7月26日 (2018. 7. 26)

(43) 国際公開日 平成29年4月13日 (2017. 4. 13)

|                               |                    |             |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
| (51) Int.Cl.                  | F I                | テーマコード (参考) |
| <b>A 6 1 B 1/06 (2006.01)</b> | A 6 1 B 1/06 6 1 2 | 4 C 1 6 1   |
| <b>A 6 1 B 1/00 (2006.01)</b> | A 6 1 B 1/00 5 1 3 |             |
|                               | A 6 1 B 1/06 5 1 0 |             |

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 68 頁)


|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 出願番号        | 特願2017-544128 (P2017-544128)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (71) 出願人 | 000000376              |
| (21) 国際出願番号 | PCT/JP2015/078620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | オリンパス株式会社              |
| (22) 国際出願日  | 平成27年10月8日 (2015. 10. 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 東京都八王子市石川町2951番地       |
| (81) 指定国    | AP (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US | (74) 代理人 | 100108855<br>弁理士 蔵田 昌俊 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (74) 代理人 | 100103034<br>弁理士 野河 信久 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (74) 代理人 | 100153051<br>弁理士 河野 直樹 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (74) 代理人 | 100179062<br>弁理士 井上 正  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (74) 代理人 | 100189913<br>弁理士 鵜飼 健  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (74) 代理人 | 100199565<br>弁理士 飯野 茂  |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 内視鏡装置

## (57) 【要約】

内視鏡装置(10)の照明部(20)は、観察体(0)に存在する診断対象物質の光吸収スペクトルに対して、少なくとも1つの極大値をとる少なくとも1つの極大波長、及び、青色領域、緑色領域、及び赤色領域の3つの色領域のうち何れかの色領域における光吸収スペクトルの最大値である色領域最大値をとる色領域最大波長、の少なくとも一方を1つ含む強調波長領域に、ピーク波長または中心波長が含まれる第1の強調狭帯域光を出射するレーザ光源(44-1; 44-3; 44-5)と、上記3つの色領域の強調波長領域を含まない波長領域である非強調波長領域に、ピーク波長または中心波長が含まれる第1の非強調狭帯域光を出射するレーザ光源(44-2; 44-4; 44-6)と、第1の強調狭帯域光と第1の非強調狭帯域光との光量比である第1の光量比を変更する光量比変更部(72)と、を有する。

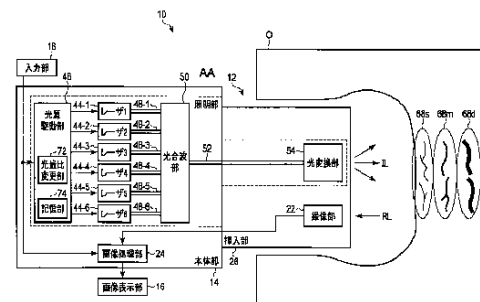

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 14 Main body             | 44-5 Laser 5                        |
| 16 Image display unit    | 44-6 Laser 6                        |
| 18 Input unit            | 46 Light source drive unit          |
| 22 Imaging unit          | 50 Optical multiplexing unit        |
| 24 Image processing unit | 54 Optical conversion unit          |
| 28 Insertion unit        | 72 Light amount ratio changing unit |
| 44-1 Laser 1             | 74 Storage unit                     |
| 44-2 Laser 2             | AA Illumination unit                |
| 44-3 Laser 3             |                                     |
| 44-4 Laser 4             |                                     |

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

複数の狭帯域光源を有し、互いにピーク波長または中心波長の異なる複数の狭帯域光を含む照明光を出射する照明部を備える内視鏡装置であって、

前記複数の狭帯域光源は、

観察体に存在する診断対象物質の光吸収スペクトルに対して、少なくとも 1 つの極大値をとる少なくとも 1 つの極大波長、及び、青色領域、緑色領域、及び赤色領域の 3 つの色領域のうち何れかの色領域における前記光吸収スペクトルの最大値である色領域最大値をとる色領域最大波長、の少なくとも一方を 1 つ含む強調波長領域に、前記ピーク波長または前記中心波長が含まれる第 1 の強調狭帯域光を出射する第 1 の強調狭帯域光源と、

10

前記青色領域、緑色領域、及び赤色領域の前記強調波長領域を含まない波長領域である非強調波長領域に、前記ピーク波長または前記中心波長が含まれる第 1 の非強調狭帯域光を出射する第 1 の非強調狭帯域光源と、

を少なくとも有し、

前記照明部は、前記複数の狭帯域光に含まれる前記第 1 の強調狭帯域光と前記第 1 の非強調狭帯域光との光量比である第 1 の光量比を変更する光量比変更部を更に有する、ことを特徴とする内視鏡装置。

**【請求項 2】**

前記第 1 の強調狭帯域光及び前記第 1 の非強調狭帯域光は、それぞれ、第 1 の深さ領域まで侵達長を有し、

20

前記第 1 の深さ領域は、前記観察体に対する表層領域、中層領域、及び深層領域の 3 つの深さ領域の何れかである、ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

**【請求項 3】**

前記複数の狭帯域光のうち、

前記表層領域まで侵達長を有する狭帯域光は、前記青色領域に含まれ、

前記中層領域まで侵達長を有する狭帯域光は、前記緑色領域に含まれ、

前記深層領域まで侵達長を有する狭帯域光は、前記赤色領域に含まれ、

前記第 1 の強調狭帯域光及び前記第 1 の非強調狭帯域光は、それぞれ、前記 3 つの色領域の何れかである第 1 の色領域に含まれる、ことを特徴とする請求項 2 に記載の内視鏡装置。

30

**【請求項 4】**

前記光量比変更部は、前記照明光において、前記第 1 の色領域の光量が一定となるように、前記第 1 の光量比を変更する、ことを特徴とする請求項 3 に記載の内視鏡装置。

**【請求項 5】**

前記複数の狭帯域光源は、更に、

第 2 の強調狭帯域光を出射する第 2 の強調狭帯域光源と、

第 2 の非強調狭帯域光を出射する第 2 の非強調狭帯域光源と、

のどちらか一方を少なくとも有し、

前記照明光における前記複数の狭帯域光は、前記第 2 の強調狭帯域光と前記第 2 の非強調狭帯域光のどちらか一方を少なくとも含み、

40

前記第 2 の強調狭帯域光と前記第 2 の非強調狭帯域光は、

前記 3 つの深さ領域の何れかであり、且つ、前記第 1 の深さ領域とは異なる第 2 の深さ領域まで侵達長を有し、

前記 3 つの色領域の何れかであり、且つ、前記第 1 の色領域とは異なる第 2 の色領域に含まれる、ことを特徴とする請求項 3 または 4 に記載の内視鏡装置。

**【請求項 6】**

前記複数の狭帯域光源は、前記第 2 の強調狭帯域光源と前記第 2 の非強調狭帯域光源の両方を有し、

前記光量比変更部は、前記第 1 の光量比に加えて、前記第 2 の強調狭帯域光と前記第 2 の非強調狭帯域光との光量比である第 2 の光量比を変更する、ことを特徴とする請求項 5

50

に記載の内視鏡装置。

【請求項 7】

前記光量比変更部は、前記照明光において、前記第 2 の色領域の光量が一定となるように、前記第 2 の光量比を変更する、ことを特徴とする請求項 6 に記載の内視鏡装置。

【請求項 8】

前記複数の狭帯域光源は、更に、

第 3 の強調狭帯域光を出射する第 3 の強調狭帯域光源と、

第 3 の非強調狭帯域光を出射する第 3 の非強調狭帯域光源と、

のどちらか一方を少なくとも有し、

前記照明光における前記複数の狭帯域光は、前記第 3 の強調狭帯域光と前記第 3 の非強調狭帯域光のどちらか一方を少なくとも含み、

前記第 3 の強調狭帯域光と前記第 3 の非強調狭帯域光は、

前記 3 つの深さ領域の何れかであり、且つ、前記第 1 の深さ領域及び前記第 2 の深さ領域とは異なる第 3 の深さ領域まで侵達長を有し、

前記 3 つの色領域の何れかであり、且つ、前記第 1 の色領域及び前記第 2 の色領域とは異なる第 3 の色領域に含まれる、ことを特徴とする請求項 6 また 7 に記載の内視鏡装置。

【請求項 9】

前記複数の狭帯域光源は、前記第 3 の強調狭帯域光源と前記第 3 の非強調狭帯域光源の両方を有し、

前記光量比変更部は、前記第 1 の光量比と前記第 2 の光量比に加えて、前記第 3 の強調狭帯域光と前記第 3 の非強調狭帯域光との光量比である第 3 の光量比を変更する、ことを特徴とする請求項 8 に記載の内視鏡装置。

【請求項 10】

前記光量比変更部は、前記照明光において、前記第 3 の色領域の光量が一定となるように、前記第 3 の光量比を変更する、ことを特徴とする請求項 9 に記載の内視鏡装置。

【請求項 11】

前記照明光において、前記青色領域の光量と、前記緑色領域の光量と、前記赤色領域の光量と、の比率を色領域間光量比としたとき、

前記光量比変更部は、前記複数の狭帯域光源を、前記色領域間光量比が一定となるように制御する、ことを特徴とする請求項 8 から 10 のいずれか一項に記載の内視鏡装置。

【請求項 12】

前記色領域間光量比は、前記照明光が白色となる光量比である、ことを特徴とする請求項 11 に記載の内視鏡装置。

【請求項 13】

前記光量比変更部は、前記第 1 の強調狭帯域光源と前記第 1 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせである第 1 の点灯組み合わせを切り替える、ことを特徴とする請求項 1 または 4 に記載の内視鏡装置。

【請求項 14】

前記光量比変更部は、

前記第 1 の強調狭帯域光源と前記第 1 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせである第 1 の点灯組み合わせと、

前記第 2 の強調狭帯域光源と前記第 2 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせである第 2 の点灯組み合わせと、  
を切り替える、ことを特徴とする請求項 6 または 7 に記載の内視鏡装置。

【請求項 15】

前記光量比変更部は、

前記第 1 の強調狭帯域光源と前記第 1 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせである第 1 の点灯組み合わせと、

前記第 2 の強調狭帯域光源と前記第 2 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせであ

10

20

30

40

50

る第 2 の点灯組み合わせと、

前記第 3 の強調狭帯域光源と前記第 3 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせである第 3 の点灯組み合わせと、

を切り替える、ことを特徴とする請求項 9 または 10 に記載の内視鏡装置。

【請求項 16】

前記強調波長領域は、前記極大波長及び前記色領域最大波長の少なくとも一方に対して、 $\pm 20 \text{ nm}$  以内の波長領域である、ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 17】

前記強調波長領域は、前記極大値または前記色領域最大値が存在する前記色領域であって、前記極大値または前記色領域最大値に対して  $1/2$  以上の値を有する波長領域である、ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

10

【請求項 18】

前記非強調波長領域は、前記診断対象物質の光吸収スペクトルに対して、極小値をとる少なくとも 1 つの極小波長、及び、前記 3 つの色領域のうち何れかの色領域における最小値である色領域最小値をとる色領域最小波長、の少なくとも一方を 1 つ含む、ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 19】

前記非強調波長領域は、前記極小波長及び前記色領域最小波長の少なくとも一方に対して、 $\pm 20 \text{ nm}$  以内の波長領域である、ことを特徴とする請求項 18 に記載の内視鏡装置。

20

【請求項 20】

前記非強調波長領域は、前記極小値または前記色領域最小値が存在する前記色領域であって、前記極小値及び前記色領域最小値の少なくとも一方に対して  $1.5$  倍以下の値を有する波長領域である、ことを特徴とする請求項 18 に記載の内視鏡装置。

【請求項 21】

前記非強調波長領域は、前記極大値または前記色領域最大値が存在する前記色領域であって、前記極大値及び色領域最大値の少なくとも一方に対して、 $1/2$  以下の値をとる波長領域である、ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 22】

前記観察体は、生体組織であり、

30

前記診断対象物質は、前記観察体に含まれるヘモグロビンである、ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 23】

少なくとも 1 つの前記第 1 の強調狭帯域光のピーク波長は、 $395$  乃至  $435 \text{ nm}$  の波長領域に含まれる、ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 24】

少なくとも 1 つの前記第 1 の強調狭帯域光のピーク波長は、 $520$  乃至  $560 \text{ nm}$  または  $560$  乃至  $595 \text{ nm}$  の波長領域のどちらか一方に含まれる、ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

【請求項 25】

前記複数の狭帯域光は、波長幅が  $50 \text{ nm}$  以下の狭帯域光である、ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

40

【請求項 26】

前記複数の狭帯域光は、波長幅が  $5 \text{ nm}$  以下の超狭帯域光である、ことを特徴とする請求項 25 に記載の内視鏡装置。

【請求項 27】

前記青色領域は、 $380$  乃至  $510 \text{ nm}$  の波長領域であり、

前記緑色領域は、 $490$  乃至  $610 \text{ nm}$  の波長領域であり、

前記赤色領域は、 $590$  乃至  $780 \text{ nm}$  の波長領域である、ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

50

**【請求項 28】**

用途に応じた複数の観察モードのうちの 1 つを入力する入力部を更に有し、  
前記光量比変更部は、前記入力部に入力された前記観察モードに基づいて、前記第 1 の光量比を変更する、ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡装置。

**【請求項 29】**

前記観察体に照射された前記照明光の反射散乱光を検出して撮像信号を出力する撮像部と、

前記撮像信号から画像信号を生成する画像処理部と、

を更に備える、ことを特徴とする請求項 1 から 28 のいずれか一項に記載の内視鏡装置

。

10

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】****【0001】**

本発明は、観察体に存在する診断対象物質を強調表示可能な内視鏡装置に関する。

**【背景技術】****【0002】**

例えば、特開 2014 - 61152 号公報（以下、特許文献 1 と記す）には、観察体の血管を強調表示可能な内視鏡装置が開示されている。この内視鏡装置は、広帯域光に対して、血管強調用の照明光として、観察体に存在する診断対象物質であるヘモグロビンの吸光係数が高い波長域 405 ~ 425 nm 及び 530 ~ 550 nm を透過する血管強調用フ

20

**【0003】**

したがって、405 ~ 425 nm の青色狭帯域光と 530 ~ 550 nm の緑色狭帯域光とによって、表層血管と中深層血管とを強調表示することができる。

**【先行技術文献】****【特許文献】****【0004】**

30

【特許文献 1】特開 2014 - 61152 号公報

**【発明の概要】****【発明が解決しようとする課題】****【0005】**

しかしながら、上記特許文献 1 に開示された内視鏡装置において、例えば表層血管を詳細に観察したい場合には、共に強調されている中深層血管が表層血管の観察の妨げになる可能性が考えられる。逆に、中層血管を詳細に観察したい場合には、共に強調されている表層血管が中層血管の観察の妨げになる可能性が考えられる。

**【0006】**

また、表層血管のみ強調された画像及び中層血管のみ強調された画像が望まれる以外にも、それらの中間の強調状態の画像が望まれる場合もあり、更には、その望まれる中間の度合いも様々である。上記特許文献 1 の内視鏡装置では、そのような中間の強調状態の画像を生成することができなかった。

40

**【0007】**

本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、特定の深さ領域における、診断対象物質の相対的な強調の度合いを変更可能な内視鏡装置を提供することを目的とする。

**【課題を解決するための手段】****【0008】**

本発明の内視鏡装置の一態様は、複数の狭帯域光源を有し、互いにピーク波長または中心波長の異なる複数の狭帯域光を含む照明光を出射する照明部を備える。ここで、複数の

50

狭帯域光源は、観察体に存在する診断対象物質の光吸収スペクトルに対して、少なくとも1つの極大値をとる少なくとも1つの極大波長、または、青色領域、緑色領域、及び赤色領域の3つの色領域のうち何れかの色領域における最大値である色領域最大値をとる色領域最大波長、の少なくとも一方を1つ含む強調波長領域に、ピーク波長または中心波長が含まれる第1の強調狭帯域光を出射する第1の強調狭帯域光源と、青色領域、緑色領域、及び赤色領域の強調波長領域を含まない波長領域である非強調波長領域に、ピーク波長または中心波長が含まれる第1の非強調狭帯域光を出射する第1の非強調狭帯域光源と、を少なくとも有する。そして、記照明部は、複数の狭帯域光に含まれる第1の強調狭帯域光と第1の非強調狭帯域光との光量比である第1の光量比を変更する光量比変更部を更に有する。

10

#### 【発明の効果】

#### 【0009】

本発明によれば、第1の強調狭帯域光と第1の非強調狭帯域光との光量比である第1の光量比を変更することで、第1の強調狭帯域光により強調される診断対象物質の強調度合いが変更されるので、特定の深さ領域における、診断対象物質の相対的な強調の度合いを変更可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0010】

【図1】図1は、本発明の一実施形態に係る内視鏡装置の概略的な構成を示すブロック図である。

20

【図2】図2は、内視鏡装置の概略的な構成を示す外観図である。

【図3】図3は、酸化ヘモグロビンの光吸収スペクトルを示す図である。

【図4】図4は、撮像部におけるカラーフィルタの分光特性の一例を示す図である。

【図5】図5は、各色領域における極大値と色領域最大値とを説明するための図である。

【図6A】図6Aは、血管の積層構成を模式的に示す図である。

【図6B】図6Bは、各色領域の光の侵達長を模式的に示す図である。

【図7】図7は、観察モードにおいて点灯するレーザ光源の組み合わせを表すテーブルを示す図である。

【図8】図8は、光変換部の模式図である。

【図9】図9は、観察モードM1～M16における照明光スペクトルを示す図である。

30

【図10】図10は、観察モードM1～M16における観察体画像を示す図である。

【図11】図11は、観察モードM1（表層血管強調モード）の照明光スペクトルを示す図である。

【図12】図12は、観察モードM1（表層血管強調モード）において表示される観察体画像の一例を示す図である。

【図13】図13は、観察モードM2（中層血管強調モード）の照明光スペクトルを示す図である。

【図14】図14は、観察モードM2（中層血管強調モード）において表示される観察体画像の一例を示す図である。

【図15】図15は、観察モードM3（深層血管強調モード）の照明光スペクトルを示す図である。

40

【図16】図16は、観察モードM3（深層血管強調モード）において表示される観察体画像の一例を示す図である。

【図17】図17は、観察モードM4（表層-中層血管強調モード）の照明光スペクトルを示す図である。

【図18】図18は、観察モードM4（表層-中層血管強調モード）において表示される観察体画像の一例を示す図である。

【図19】図19は、観察モードM8（表層-中層血管強調中間モード1）の照明光スペクトルを示す図である。

【図20】図20は、観察モードM8（表層-中層血管強調中間モード1）において表示

50

される観察体画像の一例を示す図である。

【図 2 1】図 2 1 は、観察モード M 1 4（表層-中層-深層血管強調中間モード 1）の照明光スペクトルを示す図である。

【図 2 2】図 2 2 は、観察モード M 1 4（表層-中層-深層血管強調中間モード 1）において表示される観察体画像の一例を示す図である。

【図 2 3】図 2 3 は、観察モード M 1 7（通常観察モード）の照明光スペクトルを示す図である。

【図 2 4】図 2 4 は、観察モード M 1 7（通常観察モード）において表示される観察体画像の一例を示す図である。

【図 2 5】図 2 5 は、変形例 1 における観察モード M 1（表層血管強調モード）の照明光スペクトルの例を示す図である。

10

【図 2 6】図 2 6 は、変形例 1 における観察モード M 1（表層血管強調モード）の照明光スペクトルの別の例を示す図である。

【図 2 7】図 2 7 は、変形例 1 における観察モード M 1（表層血管強調モード）の照明光スペクトルの更に別の例を示す図である。

【図 2 8】図 2 8 は、変形例 2 におけるレーザ光源の点灯タイミング / 撮像信号取得の一例を表すテーブルを示す図である。

【図 2 9】図 2 9 は、変形例 2 におけるレーザ光源の点灯タイミング / 撮像信号取得の別の例を表すテーブルを示す図である。

【図 3 0】図 3 0 は、変形例 5 における還元ヘモグロビンの光吸収スペクトルを示す図である。

20

【発明を実施するための形態】

【0011】

以下、本発明を実施するための形態を図面を参照して説明する。

【0012】

図 1 及び図 2 は、本発明の一実施形態に係る内視鏡装置 10 の概略的な構成を示す図である。なお、本明細書において、内視鏡とは、医療用内視鏡（上部消化管内視鏡、大腸内視鏡、超音波内視鏡、膀胱鏡、腎盂鏡、気管支鏡、等）及び工業用内視鏡に限定するものではなく、観察体 O に挿入される挿入部を備える機器一般を指している。

【0013】

30

以下、内視鏡として医療用内視鏡を例に説明する。

【0014】

本実施形態に係る内視鏡装置 10 は、内視鏡 12 と、本体部（ビデオプロセッサ）14 と、画像表示部（モニタ）16 と、入力部 18 と、を有している。内視鏡 12 と本体部 14 には、観察体 O に照明光 IL を照射する照明部 20 が設けられている。ここで、観察体 O とは、被検体（例えば体腔（管腔））内における患部や病変部等である。

【0015】

内視鏡 12 は、観察体 O に照射された照明光 IL の反射散乱光 RL を検出して撮像信号を出力する撮像部 22 を有する。本体部 14 は、内視鏡 12 の撮像部 22 の撮像信号から画像信号を生成する画像処理部 24 を有している。画像表示部 16 は、本体部 14 と接続され、画像処理部 24 によって生成された画像信号で構成される観察体画像を表示する。入力部 18 は、本体部 14 と接続され、あるいは、本体部 14 上に配置され、詳細は後述するような観察モードの指定など、各種のユーザ指示を本体部 14 に入力する。

40

【0016】

内視鏡 12 には、湾曲部材である細長い挿入部 26 と、該挿入部 26 の基端部と連結した操作部 28 と、が配設される。内視鏡 12 は、管状の挿入部 26 を体腔内に挿入する管状挿入装置である。

【0017】

挿入部 26 は、挿入部 26 の先端部側から基端部側に向かって、先端硬質部 30 と、湾曲する湾曲部 32 と、可撓管部 34 と、を有している。ここで、先端硬質部 30 の基端部

50

は、湾曲部 3 2 の先端部と連結し、湾曲部 3 2 の基端部は、可撓管部 3 4 の先端部と連結している。

【 0 0 1 8 】

先端硬質部 3 0 は、挿入部 2 6 の先端部及び内視鏡 1 2 の先端部であり、硬い部材となっている。この先端硬質部 3 0 には、撮像部 2 2 が設けられている。

【 0 0 1 9 】

湾曲部 3 2 は、操作部 2 8 に設けられた湾曲操作部 3 6 のユーザ（医師らの作業）による操作に応じて、所望の方向に湾曲する。ユーザは、この湾曲操作部 3 6 を操作することで、湾曲部 3 2 を湾曲させる。この湾曲部 3 2 の湾曲により、先端硬質部 3 0 の位置と向きが変えられ、観察体 O が観察視野内に捉えられる。こうして捉えられた観察体 O に対し、照明部 2 0 からの照明光 I L が照射されて、観察体 O が照明される。湾曲部 3 2 は、図示しない複数個の節輪が挿入部 2 6 の長手軸方向に沿って連結されることにより、構成される。

10

【 0 0 2 0 】

可撓管部 3 4 は、所望な可撓性を有しており、外力によって曲がる。可撓管部 3 4 は、操作部 2 8 の後述する本体部 3 8 から延出されている管状部材である。

【 0 0 2 1 】

操作部 2 8 は、本体部（スコープ）3 8 と、把持部 4 0 と、ユニバーサルコード 4 2 と、を有している。本体部 3 8 は、その先端部から可撓管部 3 4 が延出している。把持部 4 0 は、本体部 3 8 の基端部と連結しており、内視鏡 1 2 を操作するユーザによって把持される。ユニバーサルコード 4 2 は、把持部 4 0 と本体部 1 4 との間を接続している。

20

【 0 0 2 2 】

把持部 4 0 には、湾曲部 3 2 を湾曲するために、図示しない複数の操作ワイヤを操作する湾曲操作部 3 6 が配設されている。湾曲操作部 3 6 は、湾曲部 3 2 を左右に湾曲操作させる左右湾曲操作ノブと、湾曲部 3 2 を上下に湾曲操作させる上下湾曲操作ノブと、湾曲した湾曲部 3 2 の位置を固定する固定ノブと、を有している。

【 0 0 2 3 】

左右湾曲操作ノブには、この左右湾曲操作ノブによって駆動する図示しない左右方向の湾曲操作駆動部が接続している。また、上下湾曲操作ノブには、この上下湾曲操作ノブによって駆動する図示しない上下方向の湾曲操作駆動部が接続している。上下方向の湾曲操作駆動部と左右方向の湾曲操作駆動部とは、例えば把持部 4 0 内に配設されている。

30

【 0 0 2 4 】

左右方向の湾曲操作駆動部は、操作部 2 8 と可撓管部 3 4 と湾曲部 3 2 とを挿通する図示しない 1 本の左右方向操作ワイヤと接続しており、この左右方向操作ワイヤの両端は、湾曲部 3 2 の先端部と接続している。

【 0 0 2 5 】

また、上下方向の湾曲操作駆動部は、操作部 2 8 と可撓管部 3 4 と湾曲部 3 2 とを挿通する図示しない 1 本の上下方向操作ワイヤと接続している。上下方向操作ワイヤは、左右方向操作ワイヤとは別体であり、互いに独立な動きが可能である。上下方向操作ワイヤの両端は、湾曲部 3 2 の先端部と接続している。

40

【 0 0 2 6 】

左右湾曲操作ノブは、左右方向の湾曲操作駆動部と左右方向操作ワイヤとを介して湾曲部 3 2 を左右方向に湾曲する。また、上下湾曲操作ノブは、上下方向の湾曲操作駆動部と上下方向操作ワイヤとを介して湾曲部 3 2 を上下方向に湾曲する。

【 0 0 2 7 】

このような湾曲操作部 3 6（左右湾曲操作ノブと上下湾曲操作ノブ）と、左右方向の湾曲操作駆動部と、左右方向操作ワイヤと、上下方向の湾曲操作駆動部と、上下方向操作ワイヤとは、湾曲部 3 2 を湾曲するために、湾曲部 3 2 を操作する湾曲操作機構である。

【 0 0 2 8 】

以下、各部について、更に詳細に説明する。

50

## 【 0 0 2 9 】

< 入力部 1 8 >

本実施形態に係る内視鏡装置 1 0 は、観察の目的に応じた以下の 1 7 種類の観察モードを有し、ユーザは入力部 1 8 によって、どの観察モードで観察を行うかを入力する。入力部 1 8 によって入力された観察モード情報は、照明部 2 0 と画像処理部 2 4 とへ出力される。

## 【 0 0 3 0 】

内視鏡装置 1 0 が有する 1 7 種類の観察モード（観察モード M 1 ~ M 1 7 ）は、以下の通りである。

## 【 0 0 3 1 】

すなわち、観察モード M 1 （表層血管強調モード）は、観察体 O の表層にある血管のみを強調表示する観察モードである。

## 【 0 0 3 2 】

観察モード M 2 （中層血管強調モード）は、観察体 O の深層にある血管のみを強調表示する観察モードである。

## 【 0 0 3 3 】

観察モード M 3 （深層血管強調モード）は、観察体 O の深層にある血管のみを強調表示する観察モードである。

## 【 0 0 3 4 】

観察モード M 4 （表層-中層血管強調モード）は、観察体 O の表層にある血管と中層にある血管を強調表示する観察モードである。

## 【 0 0 3 5 】

観察モード M 5 （表層-深層血管強調モード）は、観察体 O の表層にある血管と中層にある血管を強調表示する観察モードである。

## 【 0 0 3 6 】

観察モード M 6 （中層-深層血管強調モード）は、観察体 O の中層にある血管と深層血管を強調表示する観察モードである。

## 【 0 0 3 7 】

観察モード M 7 （表層-中層-深層血管強調モード）は、観察体 O の表層にある血管と中層にある血管と深層血管を強調表示する観察モードである。

## 【 0 0 3 8 】

観察モード M 8 （表層-中層血管強調中間モード 1 ）は、観察モード M 1 （表層血管強調モード）と観察モード M 4 （表層-中層血管強調モード）との中間の血管強調表示モードである。この観察モード M 8 では、表層にある血管を観察モード M 1 と同様に強調し、中層にある血管を観察モード M 1 と観察モード M 4 との中間レベルに強調する。

## 【 0 0 3 9 】

観察モード M 9 （表層-中層血管強調中間モード 2 ）は、観察モード M 2 （中層血管強調モード）と観察モード M 4 （表層-中層血管強調モード）との中間の血管強調表示モードである。この観察モード M 9 では、中層にある血管を観察モード M 2 と同様に強調し、表層にある血管を観察モード M 2 と観察モード M 4 との中間レベルに強調する。

## 【 0 0 4 0 】

観察モード M 1 0 （表層-深層血管強調中間モード 1 ）は、観察モード M 1 （表層血管強調モード）と観察モード M 5 （表層-深層血管強調モード）との中間の血管強調表示モードである。この観察モード M 1 0 では、表層にある血管を観察モード M 1 と同様に強調し、深層にある血管を観察モード M 1 と観察モード M 5 との中間レベルに強調する。

## 【 0 0 4 1 】

観察モード M 1 1 （表層-深層血管強調中間モード 2 ）は、観察モード M 3 （深層血管強調モード）と観察モード M 5 （表層-深層血管強調モード）との中間の血管強調表示モードである。この観察モード M 1 1 では、深層にある血管を観察モード M 3 と同様に強調し、表層にある血管を観察モード M 3 と観察モード M 5 との中間レベルに強調する。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 4 2 】

観察モード M 1 2 ( 中層-深層血管強調中間モード 1 ) は、観察モード M 2 ( 中層血管強調モード ) と観察モード M 6 ( 中層-深層血管強調モード ) との中間の血管強調表示モードである。この観察モード M 1 2 では、中層にある血管を観察モード M 2 と同様に強調し、深層にある血管を観察モード M 2 と観察モード M 6 との中間レベルに強調する。

## 【 0 0 4 3 】

観察モード M 1 3 ( 中層-深層血管強調中間モード 2 ) は、観察モード M 3 ( 深層血管強調モード ) と観察モード M 6 ( 中層-深層血管強調モード ) との中間の血管強調表示モードである。この観察モード M 1 3 では、深層にある血管を観察モード M 3 と同様に強調し、中層にある血管を観察モード M 3 と観察モード M 6 との中間レベルに強調する。

10

## 【 0 0 4 4 】

観察モード M 1 4 ( 表層-中層-深層血管強調中間モード 1 ) は、観察モード M 1 ( 表層血管強調モード ) と観察モード M 7 ( 表層-中層-深層血管強調モード ) との中間の血管強調表示モードである。この観察モード M 1 4 では、表層にある血管を観察モード M 1 と同様に強調し、中層にある血管を観察モード M 1 と観察モード M 7 との中間レベルに強調し、深層にある血管を観察モード M 1 と観察モード M 7 との中間レベルに強調する。

## 【 0 0 4 5 】

観察モード M 1 5 ( 表層-中層-深層血管強調中間モード 2 ) は、観察モード M 2 ( 中層血管強調モード ) と観察モード M 7 ( 表層-中層-深層血管強調モード ) との中間の血管強調表示モードである。この観察モード M 1 5 では、中層にある血管を観察モード M 2 と同様に強調し、表層にある血管を観察モード M 2 と観察モード M 7 の中間レベルに強調し、深層にある血管を観察モード M 2 と観察モード M 7 との中間レベルに強調する。

20

## 【 0 0 4 6 】

観察モード M 1 6 ( 表層-中層-深層血管強調中間モード 3 ) は、観察モード M 3 ( 深層血管強調モード ) と観察モード M 7 ( 表層-中層-深層血管強調モード ) との中間の血管強調表示モードである。この観察モード M 1 6 では、深層にある血管を観察モード M 3 と同様に強調し、表層にある血管を観察モード M 3 と観察モード M 7 との中間レベルに強調し、中層にある血管を観察モード M 3 と観察モード M 7 の中間レベルに強調する。

## 【 0 0 4 7 】

そして、観察モード M 1 7 ( 通常観察モード ) は、演色性または色再現性の高い照明光 I L を出射する観察モードである。例えば、キセノンランプやハロゲンランプのような広帯域な照明光 I L の色を再現する観察モードである。または、キセノンランプやハロゲンランプのような広帯域な照明光 I L に照射されたときの観察体 O の色を再現する観察モードである。

30

## 【 0 0 4 8 】

## &lt; 照明部 2 0 &gt;

照明部 2 0 は、複数、本実施形態では 6 個、のレーザ光源 4 4 - 1 ~ 4 4 - 6 と、光源駆動部 4 6 と、6 本の光ファイバ 4 8 - 1 ~ 4 8 - 6 と、光合波部 5 0 と、光ファイバ 5 2 と、光変換部 5 4 と、を有する。レーザ光源 4 4 - 1 ~ 4 4 - 6、光源駆動部 4 6、光ファイバ 4 8 - 1 ~ 4 8 - 6、光合波部 5 0、及び光ファイバ 5 2 の一部は、本体部 1 4 内に配設され、光ファイバ 5 2 の残りの部分及び光変換部 5 4 は、内視鏡 1 2 内に配設される。

40

## 【 0 0 4 9 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 ) は、ピーク波長 4 1 5 n m のレーザ光源 ( 第 1 の強調狭帯域光源 ) であり、第 1 のレーザ光 ( 第 1 の強調狭帯域光 ) を出射する。

## 【 0 0 5 0 】

レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) は、ピーク波長 4 4 5 n m のレーザ光源 ( 第 1 の非強調狭帯域光源 ) であり、第 2 のレーザ光 ( 第 1 の非強調狭帯域光 ) を出射する。

## 【 0 0 5 1 】

レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) は、ピーク波長 5 4 0 n m のレーザ光源 ( 第 2 の強調

50

狭帯域光源)であり、第3のレーザ光(第2の強調狭帯域光)を出射する。

【0052】

レーザ光源44-4(レーザ4)は、ピーク波長515nmのレーザ光源(第2の非強調狭帯域光源)であり、第4のレーザ光(第2の非強調狭帯域光)を出射する。

【0053】

レーザ光源44-5(レーザ5)は、ピーク波長595nmのレーザ光源(第3の強調狭帯域光源)であり、第5のレーザ光(第3の強調狭帯域光)を出射する。

【0054】

そして、レーザ光源44-6(レーザ6)は、ピーク波長635nmのレーザ光源(第3の非強調狭帯域光源)であり、第6のレーザ光(第3の非強調狭帯域光)を出射する。

10

【0055】

光源駆動部46は、これら複数のレーザ光源44-1~44-6の駆動を制御する。

【0056】

光ファイバ48-1~48-6は、これらレーザ光源44-1~44-6から出射されたレーザ光を光合波部50へ導光する。

【0057】

光合波部50は、光ファイバ48-1~48-6を導光されるレーザ光源44-1~44-6からのレーザ光を合波する、例えば光ファイバコンバイナである。

【0058】

光ファイバ52は、光合波部50で合波されたレーザ光を光変換部54へ導光する。

20

【0059】

光変換部54は、上記撮像部22が配置されている挿入部26の先端硬質部30に配置されている。光変換部54は、本体部14から、内視鏡12のユニバーサルコード42、操作部28、及び挿入部26内を挿通された光ファイバ52によって導光されてきたレーザ光の光学的な特性を変換して、照明光ILとして観察体Oに照射する。

【0060】

照明部20内の各部の構成は、より具体的には、以下の通りである。

【0061】

<レーザ光源44-1(レーザ1)>

本実施形態においては、観察体Oに存在する診断対象物質として、血管内の血液に含まれる酸化ヘモグロビンを想定している。図3は、この酸化ヘモグロビン(以下、単にヘモグロビンと記載する)の光吸収スペクトルを示している。

30

【0062】

レーザ光源44-1(レーザ1)は、ピーク波長415nmのレーザ光源である。このピーク波長415nmの第1のレーザ光は、観察体Oの表層領域まで侵達長(侵達長の定義については後述)を有する。また、この第1のレーザ光のピーク波長415nmは、診断対象物質であるヘモグロビンの光吸収スペクトルの青色領域(色領域の定義については後述)における極大値をとる極大波長であり、表層の血管内の血液に含まれるヘモグロビン(以下、簡易的に「表層血管」と記載する)における吸収が大きい。そのため、第1のレーザ光を観察体Oへ照射した場合、表層血管における反射散乱光RLに対する光強度と、表層血管周辺における反射散乱光RLに対する光強度と、の間の光強度差が大きい。言い換えると、表層血管に対するコントラストが高い。すなわち、表層血管が強調される。

40

【0063】

よって、第1のレーザ光を表層血管に対する強調狭帯域光と称し、また、レーザ光源44-1(レーザ1)を表層血管に対する強調狭帯域光源と称する。

【0064】

なお、第1のレーザ光のピーク波長は、415nmに限らない。第1のレーザ光のピーク波長は、表層血管に対する強調波長領域にピーク波長または中心波長が含まれれば良い。

【0065】

50

また、表層血管に対する強調波長領域は、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの青色領域における極大値をとる極大波長を含む波長領域ではなくて、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの青色領域における最大値をとる青色領域最大波長を含む波長領域であっても良い。

【0066】

ここで、表層血管に対する強調波長領域は、ヘモグロビンの吸収スペクトルの青色領域における極大値をとる極大波長、または、青色領域における最大値をとる青色領域最大波長、の少なくとも一方に対して、 $\pm 20\text{ nm}$ 以内の波長領域であると、光吸収が大きく、表層血管が強調されるため、好ましい。さらに、 $\pm 10\text{ nm}$ 以内の波長領域であると、より光吸収が大きい領域であり、より表層血管が強調されるため、より好ましい。

【0067】

また、表層血管に対する強調波長領域は、ヘモグロビンの吸収スペクトルの青色領域における極大値、または、青色領域における最大値、に対して、 $1/2$ 以上の値となる波長領域であると、吸収が大きいため、好ましい。

【0068】

ヘモグロビンの光吸収スペクトルの青色領域においては、上記極大波長と青色領域最大波長は同じである。

【0069】

<レーザ光源44-2(レーザ2)>

レーザ光源44-2(レーザ2)は、ピーク波長445 nmのレーザ光源である。このピーク波長445 nmの第2のレーザ光は、第1のレーザと同様、観察体Oの表層領域まで侵達長を有する。しかしながら、この第2のレーザ光のピーク波長445 nmは、上記した表層血管に対する強調波長領域を含まない、表層血管に対する非強調波長領域に含まれる。第2のレーザ光を観察体Oへ照射した場合、表層血管における反射散乱光RLに対する光強度と、表層血管周辺における反射散乱光RLに対する光強度と、の間の光強度差は小さい。言い換えると、表層血管に対するコントラストが低い。すなわち、表層血管は強調されない。

【0070】

よって、第2のレーザ光を表層血管に対する非強調狭帯域光と称し、また、レーザ光源44-2(レーザ2)を表層血管に対する非強調狭帯域光源と称する。

【0071】

なお、第2のレーザ光のピーク波長は、445 nmに限らない。第2のレーザ光のピーク波長は、表層血管を強調表示しない非強調波長領域に含まれれば良い。

【0072】

表層血管に対する非強調波長領域は、表層血管に対する強調波長領域を含まない領域である。

【0073】

また、表層血管に対する非強調波長領域は、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの青色領域における極小値をとる極小波長、または、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの青色領域における最小値をとる青色領域最小波長、のうち、少なくとも一方を1つ含む領域であると、好ましい。

【0074】

ここで、表層血管に対する非強調波長領域は、上記極小波長、または、上記最小波長、の少なくとも一方に対して、 $\pm 20\text{ nm}$ 以内の波長領域であると、光吸収が小さく、表層血管が強調されないため、好ましい。さらに、 $\pm 10\text{ nm}$ 以内の波長領域であると、より光吸収が小さい領域であり、より表層血管が抑制されるため、より好ましい。

【0075】

また、表層血管に対する非強調波長領域は、青色領域において、上記極小値または上記青色領域の最小値の少なくとも一方に対して、 $1.5$ 倍以下の値を有する波長領域であると、吸収が小さいため、好ましい。

【0076】

10

20

30

40

50

あるいは、表層血管に対する非強調波長領域は、青色領域において、上記極大値または上記青色領域の最大値の少なくとも一方に対して、 $1/2$ 以下の値をとる波長領域であると、吸収が小さいため、好ましい。

【0077】

<レーザ光源44-3(レーザ3)>

レーザ光源44-3(レーザ3)は、ピーク波長540nmのレーザ光源である。このピーク波長540nmの第3のレーザ光は、観察体Oの表層領域よりも深い中層領域まで侵達長を有する。また、この第3のレーザ光のピーク波長540nmは、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの緑色領域における極大値をとる極大波長であり、中層血管における吸収が大きい。そのため、第3のレーザ光を観察体Oへ照射した場合、中層血管における反射散乱光RLに対する光強度と、中層血管周辺における反射散乱光RLに対する光強度と、の間の光強度差が大きい。言い換えると、中層血管に対するコントラストが高い。すなわち、中層血管が強調される。

10

【0078】

よって、第3のレーザ光を中層血管に対する強調狭帯域光と称し、また、レーザ光源44-3(レーザ3)を中層血管に対する強調狭帯域光源と称する。

【0079】

なお、第3のレーザ光のピーク波長は、540nmに限らない。第3のレーザ光のピーク波長は、中層血管に対する強調波長領域にピーク波長または中心波長が含まれれば良い。

20

【0080】

また、中層血管に対する強調波長領域は、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの緑色領域における極大値をとる極大波長を含む波長領域ではなくて、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの緑色領域における最大値をとる緑色領域最大波長を含む波長領域であっても良い。

【0081】

ここで、中層血管に対する強調波長領域は、ヘモグロビンの吸収スペクトルの緑色領域における極大値をとる極大波長、または、緑色領域における最大値をとる緑色領域最大波長、の少なくとも一方に対して、 $\pm 20$ nm以内の波長領域であると、光吸収が大きく、中層血管が強調されるため、好ましい。さらに、 $\pm 10$ nm以内の波長領域であると、より光吸収が大きい領域であり、より中層血管が強調されるため、より好ましい。

30

【0082】

また、中層血管に対する強調波長領域は、ヘモグロビンの吸収スペクトルの緑色領域における極大値、または、緑色領域における最大値、に対して、 $1/2$ 以上の値となる波長領域であると、吸収が大きいため、好ましい。

【0083】

<レーザ光源44-4(レーザ4)>

レーザ光源44-4(レーザ4)は、ピーク波長515nmのレーザ光源である。このピーク波長515nmの第4のレーザ光は、第3のレーザ光と同様、観察体Oの中層領域まで侵達長を有する。しかしながら、この第4のレーザ光のピーク波長515nmは、上記した中層血管に対する強調波長領域を含まない、中層血管に対する非強調波長領域に含まれる。第4のレーザ光を観察体Oへ照射した場合、中層血管における反射散乱光RLに対する光強度と、中層血管周辺における反射散乱光RLに対する光強度と、の間の光強度差は小さい。言い換えると、中層血管に対するコントラストが低い。すなわち、中層血管は強調されない。

40

【0084】

よって、第4のレーザ光を中層血管に対する非強調狭帯域光と称し、また、レーザ光源44-4(レーザ4)を中層血管に対する非強調狭帯域光源と称する。

【0085】

なお、第4のレーザ光のピーク波長は、515nmに限らない。第4のレーザ光のピーク波長は、中層血管を強調表示しない非強調波長領域に含まれれば良い。

50

## 【 0 0 8 6 】

中層血管に対する非強調波長領域は、中層血管に対する強調波長領域を含まない領域である。

## 【 0 0 8 7 】

また、中層血管に対する非強調波長領域は、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの緑色領域における極小値をとる極小波長、または、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの緑色領域における最小値をとる緑色領域最小波長、のうち、少なくとも一方を1つ含む領域であると好ましい。

## 【 0 0 8 8 】

ここで、中層血管に対する非強調波長領域は、上記極小波長、または、上記最小波長の少なくとも一方に対して、 $\pm 20 \text{ nm}$ 以内の波長領域であると、光吸収が小さく、中層血管が強調されないため、好ましい。さらに、 $\pm 10 \text{ nm}$ 以内の波長領域であると、より光吸収が小さい領域であり、より中層血管が抑制されるため、より好ましい。

10

## 【 0 0 8 9 】

また、中層血管に対する非強調波長領域は、緑色領域において、上記極小値または上記緑色領域の最小値の少なくとも一方に対して、1.5倍以下の値を有する波長領域であると、吸収が小さいため、好ましい。

## 【 0 0 9 0 】

あるいは、中層血管に対する非強調波長領域は、緑色領域において、上記極大値または上記緑色領域の最大値の少なくとも一方に対して、 $1/2$ 以下の値をとる波長領域であると、吸収が小さいため、好ましい。

20

## 【 0 0 9 1 】

< レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) >

レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) は、ピーク波長  $595 \text{ nm}$  のレーザ光源である。このピーク波長  $595 \text{ nm}$  の第5のレーザ光は、観察体 O の中層領域よりも深い深層領域まで侵達長を有する。また、この第5のレーザ光のピーク波長  $595 \text{ nm}$  は、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの赤色領域における最大値をとる赤色領域最大波長  $590 \text{ nm}$  に対して、 $\pm 20 \text{ nm}$  以内の波長領域である深層血管に対する強調波長領域に含まれ、また、上記赤色領域最大値に対して  $1/2$  以上の値となる波長領域であり、深層血管における吸収が大きい。そのため、第5のレーザ光を観察体 O へ照射した場合、深層血管における反射散乱光 R L に対する光強度と、深層血管周辺における反射散乱光 R L に対する光強度と、の間の光強度差が大きい。言い換えると、深層血管に対するコントラストが高い。すなわち、深層血管が強調される。

30

## 【 0 0 9 2 】

よって、第5のレーザ光を深層血管に対する強調狭帯域光と称し、また、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) を深層血管に対する強調狭帯域光源と称する。

## 【 0 0 9 3 】

なお、第5のレーザ光のピーク波長は、 $595 \text{ nm}$  に限らない。第5のレーザ光のピーク波長は、深層血管に対する強調波長領域にピーク波長または中心波長が含まれれば良い。

40

## 【 0 0 9 4 】

また、深層血管に対する強調波長領域は、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの赤色領域における極大値をとる極大波長を含む波長領域ではなくて、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの赤色領域における最大値をとる赤色領域最大波長を含む波長領域であっても良い。

## 【 0 0 9 5 】

ここで、深層血管に対する強調波長領域は、ヘモグロビンの吸収スペクトルの赤色領域における極大値をとる極大波長、または、赤色領域における最大値をとる赤色領域最大波長、の少なくとも一方に対して、 $\pm 20 \text{ nm}$  以内の波長領域であると、光吸収が大きく、深層血管が強調されるため、好ましい。さらに、 $\pm 10 \text{ nm}$  以内の波長領域であると、より光吸収が大きい領域であり、より深層血管が強調されるため、より好ましい。

50

## 【 0 0 9 6 】

また、深層血管に対する強調波長領域は、ヘモグロビンの吸収スペクトルの赤色領域における極大値、または、赤色領域における最大値、に対して、 $1/2$ 以上の値となる波長領域であると、吸収が大きいため、好ましい。

## 【 0 0 9 7 】

< レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) >

レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) は、ピーク波長 6 3 5 n m のレーザ光源である。このピーク波長 6 3 5 n m の第 6 のレーザ光は、第 5 のレーザ光と同様、観察体 O の深層領域まで侵達長を有する。しかしながら、この第 6 のレーザ光のピーク波長 6 3 5 n m は、上記した深層血管に対する強調波長領域を含まない、深層血管に対する非強調波長領域に含まれる。第 6 のレーザ光を観察体 O へ照射した場合、深層血管における反射散乱光 R L に対する光強度と、深層血管周辺における反射散乱光 R L に対する光強度と、の間の光強度差は小さい。言い換えると、深層血管に対するコントラストが低い。すなわち、深層血管は強調されない。

10

## 【 0 0 9 8 】

よって、第 6 のレーザ光を深層血管に対する非強調狭帯域光と称し、また、レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) を深層血管に対する非強調狭帯域光源と呼ぶ。

## 【 0 0 9 9 】

なお、第 6 のレーザ光のピーク波長は、6 3 5 n m に限らない。第 6 のレーザ光のピーク波長は、深層血管を強調表示しない非強調波長領域に含まれれば良い。

20

## 【 0 1 0 0 】

深層血管に対する非強調波長領域は、深層血管に対する強調波長領域を含まない領域である。

## 【 0 1 0 1 】

また、深層血管に対する非強調波長領域は、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの赤色領域における極小値をとる極小波長、または、ヘモグロビンの光吸収スペクトルの赤色領域における最小値をとる赤色領域最小波長、のうち、少なくとも一方を 1 つ含む領域であると好ましい。

## 【 0 1 0 2 】

ここで、深層血管に対する非強調波長領域は、上記極小波長、または、上記最小波長の少なくとも一方に対して、 $\pm 20$  n m 以内の波長領域であると、光吸収が小さく、深層血管が強調されないため、好ましい。さらに、 $\pm 10$  n m 以内の波長領域であると、より光吸収が小さい領域であり、より深層血管が抑制されるため、より好ましい。

30

## 【 0 1 0 3 】

また、深層血管に対する非強調波長領域は、赤色領域において、上記極小値または上記赤色領域の最小値の少なくとも一方に対して、 $1.5$  倍以下の値を有する波長領域であると、吸収が小さいため、好ましい。

## 【 0 1 0 4 】

あるいは、深層血管に対する非強調波長領域は、赤色領域において、上記極大値または上記赤色領域の最大値の少なくとも一方に対して、 $1/2$  以下の値をとる波長領域であると、吸収が小さいため、好ましい。

40

## 【 0 1 0 5 】

なお、上記複数の狭帯域光、すなわち、強調狭帯域光及び非強調狭帯域光は、レーザ光以外の光でも良い。ただし、波長幅が 5 0 n m 以下の狭帯域光が好ましく、波長幅が 5 n m 以下の狭帯域光だとより好ましい。波長幅は、例えば半値全幅 ( F W H M ) や、R M S ( Root Mean Square ) 法による波長幅である。半値幅レーザ光の波長幅は、例えば 1 n m である。光源としては、例えば、L E D、L E D 光やレーザ光によって励起した蛍光を用いた光源、あるいは広帯域な光源に対して分光フィルタを用いて狭帯域光を生成する構成、でも良い。分光フィルタを用いて狭帯域光を生成する構成においては、例えば分光フィルタを機械的に切り替えることで、出射する狭帯域光の波長を切り替える。

50

## 【 0 1 0 6 】

## &lt; 色領域 &gt;

上記した青色領域、緑色領域、及び赤色領域は、以下の波長領域で定義する。

## 【 0 1 0 7 】

青色領域：400～510nm、

緑色領域：490～610nm、

赤色領域：590～700nm。

## 【 0 1 0 8 】

この各波長領域は、可視光領域のうち、400～700nmの波長領域において、3等分したうえで、20nmの重なり領域（オーバーラップ）をもたせた波長領域である。このようにバランスよく設定した波長領域を基に波長設定すると、青色領域、緑色領域、及び赤色領域の各色領域に波長を有した場合に、色再現性の良い照明光ILを生成することが可能となる。

10

## 【 0 1 0 9 】

また、例えば400nm未満の波長領域と、700nm以上の波長領域について、それぞれ青色領域及び赤色領域に割り当てても良い。その場合、青色領域、緑色領域、及び赤色領域は、以下の波長領域で定義される。

青色領域：380～510nm、

緑色領域：490～610nm、

赤色領域：590～780nm。

20

## 【 0 1 1 0 】

また、例えば、撮像部22においてカラーフィルタを用いて分光画像を取得する場合は、カラーフィルタの分光特性を用いて、青色領域、緑色領域、及び赤色領域を定義しても良い。図4は、青色（B）のカラーフィルタの分光特性56B、緑色（G）のカラーフィルタの分光特性56G、及び赤色（R）のカラーフィルタの分光特性56Rの一例を示している。ここで、例えば、各色のカラーフィルタにおいて20%以上の透過率を有する波長領域を、各色領域と定義する。すなわち、図4に示されるように、青色領域は、400～525nmであり、緑色領域は、470～625nmであり、赤色領域は、570～700nmである。

## 【 0 1 1 1 】

図4に示されるように、カラーフィルタにおいて透過率がゼロになっている波長領域はほとんどなく、可視光の広い領域で数%から10%程度の透過率を有している。この数%から10%程度の透過率は、カラー画像の撮影において、無視できるレベルだと考えられるため、色領域の定義においては、透過率20%以上の範囲で定義することが望ましい。

30

## 【 0 1 1 2 】

## &lt; 各色領域における極大値と色領域最大値 &gt;

酸化ヘモグロビンの吸収スペクトルに対する、各色領域における極大値と色領域最大値は、図5に示すようになる。

## 【 0 1 1 3 】

すなわち、青色領域58Bにおいて、青色領域極大値60Bをとる極大波長と青色領域最大値62Bをとる色領域最大波長とは同じ波長415nmであり、また、青色領域極小値64Bをとる極小波長と青色領域最小値66Bをとる色領域最小波長とは同じ波長500nmである。

40

## 【 0 1 1 4 】

これに対して、緑色領域58Gにおいては、緑色領域極大値60Gをとる極大波長と緑色領域最大値62Gをとる色領域最大波長とは同じであるが、波長540nmと約575nmの2つ存在する。緑色領域極小値64Gをとる極小波長も2つ存在し、1つは波長500nmであり、もつ1つは波長560nmである。緑色領域最小値66Gをとる色領域最小波長は波長610nmである。

## 【 0 1 1 5 】

50

そして、赤色領域 5 8 R においては、極大値及び極小値は存在せず、赤色領域最大値 6 2 R をとる色領域最大波長は波長 5 9 0 nm であり、赤色領域最小値 6 6 R をとる色領域最小波長は波長 6 8 5 nm である。

【 0 1 1 6 】

< 侵達長 >

近紫外から近赤外の波長領域の光を生体（観察体 O）へ照射した場合、生体組織（上皮や、粘膜や、水分など）における光散乱特性及び光吸収特性により、長波長の光ほど、生体への侵達長が深い。

【 0 1 1 7 】

例えば、図 6 A に示すように、生体（観察体 O）が持つ血管としては、生体の表面近くに表層血管（毛細血管）6 8 s が存在し、それより深い部分に中層血管（毛細血管よりも太い血管）6 8 m が存在し、更に深部に深層血管（中層血管よりも太い血管）6 8 d が存在する。ここで、表層血管 6 8 s が存在する領域を生体の表層領域 7 0 s、中層血管 6 8 m が存在する領域を中層領域 7 0 m、深層血管 6 8 d が存在する領域を深層領域 7 0 d と称するものとする。

【 0 1 1 8 】

図 6 B に示すように、生体（観察体 O）に対して短波長側の青色領域 5 8 B の光を照射した場合は、この青色領域 5 8 B の光は、生体の表層領域 7 0 s まで侵達長を有し、表層血管 6 8 s において吸収の影響を大きく受け、生体（観察体 O）画像へ反映される。また、緑色領域 5 8 G の光を照射した場合は、緑色領域 5 8 G の光は生体の中層領域 7 0 m まで侵達長を有し、中層血管 6 8 m において吸収の影響を大きく受け、生体（観察体 O）画像へ反映される。また、赤色領域 5 8 R の光を照射した場合は、赤色領域 5 8 R の光は、生体の深層領域 7 0 d まで侵達長を有し、深層血管 6 8 d において吸収の影響を大きく受け、生体（観察体 O）画像へ反映される。

【 0 1 1 9 】

また例えば、侵達長は、以下のように定義される。

生体（観察体 O）内の距離 x における光強度  $I(x)$  は、入射光強度を  $I_0$ 、減衰係数を  $\alpha$  とすると、 $I(x) = I_0 \exp[-\alpha x]$  として表される。

【 0 1 2 0 】

ここで、減衰係数  $\alpha$  の逆数、すなわち、光強度が  $1/e$  となる距離が侵達長として定義される。なお、減衰係数  $\alpha$  は、吸収係数を  $\mu_a$ 、散乱係数を  $\mu_s$ 、異方性因子  $g$ 、等価散乱係数を  $\mu_s' = (1 - g)\mu_s$  として、以下の (1) 式で定義される。

【 0 1 2 1 】

【数 1】

$$\alpha = \sqrt{3\mu_a(\mu_a + \mu_s')} \quad \dots (1)$$

【 0 1 2 2 】

また、例えば減衰係数  $\alpha$  として、単に吸収係数  $\mu_a$ 、散乱係数  $\mu_s$ 、等価散乱係数  $\mu_s'$  を用いても良い。

【 0 1 2 3 】

吸収係数  $\mu_a$ 、散乱係数  $\mu_s$ 、及び異方性因子  $g$  は、生体（観察体 O）及び波長によって異なる。

【 0 1 2 4 】

< 光ファイバ 4 8 - 1 ~ 4 8 - 6、5 2 >

光ファイバ 4 8 - 1 ~ 4 8 - 6、及び光ファイバ 5 2 は、例えばコア径数十  $\mu m$  ~ 数百  $\mu m$  の単線ファイバである。各レーザ光源 4 4 - 1 ~ 4 4 - 6 と光ファイバ 4 8 - 1 ~ 4 8 - 6 との間には、レーザ光源から射出されたレーザ光を収束させて光ファイバに結合するための結合レンズ（図示していない）を有する。

【 0 1 2 5 】

なお、光ファイバ 5 2 の代わりに、複数の光ファイバを束ねて構成されるバンドルファイバを用いても良い。

【 0 1 2 6 】

< 光源駆動部 4 6 >

光源駆動部 4 6 は、レーザ光源 4 4 - 1 ~ 4 4 - 6 の ON / OFF、駆動電流、駆動方式（連続駆動（CW）、パルス駆動など）を各レーザ光源に対して独立に制御可能である。

【 0 1 2 7 】

光源駆動部 4 6 は、入力部 1 8 からの観察モード情報に応じて、レーザ光源 4 4 - 1 ~ 4 4 - 6 に対して、点灯させるレーザの組み合わせを制御する。

10

【 0 1 2 8 】

光源駆動部 4 6 は、光量比変更部 7 2 と記憶部 7 4 とを有している。

【 0 1 2 9 】

光量比変更部 7 2 は、入力部 1 8 に入力された観察モード情報に応じて、第 1 の光量比と第 2 の光量比と第 3 の光量比とを変更する。

【 0 1 3 0 】

ここで、第 1 の光量比は、レーザ光源 4 4 - 1（レーザ 1）が出射する第 1 のレーザ光（第 1 の強調狭帯域光）の光量と、レーザ光源 4 4 - 2（レーザ 2）が出射する第 2 のレーザ光（第 1 の非強調狭帯域光）の光量と、の比である。

【 0 1 3 1 】

第 2 の光量比は、レーザ光源 4 4 - 3（レーザ 3）が出射する第 3 のレーザ光（第 2 の強調狭帯域光）の光量と、レーザ光源 4 4 - 4（レーザ 4）が出射する第 4 のレーザ光（第 2 の非強調狭帯域光）の光量と、の比である。

20

【 0 1 3 2 】

第 3 の光量比は、レーザ光源 4 4 - 5（レーザ 5）が出射する第 5 のレーザ光（第 3 の強調狭帯域光）の光量と、レーザ光源 4 4 - 6（レーザ 6）が出射する第 6 のレーザ光（第 3 の非強調狭帯域光）の光量と、の比である。

【 0 1 3 3 】

言い換えると、光量比変更部 7 2 は、それら第 1 の光量比と第 2 の光量比と第 3 の光量比とを変更することで、観察モードの切り替えを行う。

30

【 0 1 3 4 】

例えば、観察モード M 8（表層-中層血管強調中間モード 1）における第 2 の光量比は、観察モード M 1（表層血管強調モード）における第 2 の光量比（0 : 1）と観察モード M 4（表層-中層血管強調モード）における第 2 の光量比（1 : 0）との中間の光量比（例えば、0 . 5 : 0 . 5）である。また、観察モード M 9（表層-中層血管強調中間モード 2）における第 1 の光量比は、観察モード M 2（中層血管強調モード）における第 1 の光量比（0 : 1）と観察モード M 4（表層-中層血管強調モード）における第 1 の光量比（1 : 0）との中間の光量比（例えば、0 . 5 : 0 . 5）である。その他の観察モードにおける光量比については、後述する。

【 0 1 3 5 】

記憶部 7 4 は、各観察モードにおいて点灯するレーザ光源の組み合わせ、及び、各レーザ光源に印加する電流値または電圧値を記憶する。すなわち、記憶部 7 4 は、図 7 に示すような各観察モードにおいて点灯するレーザ光源の組み合わせを記憶している。

40

【 0 1 3 6 】

なお、光源駆動部 4 6 は、入力部 1 8 に入力された観察モード情報に応じて第 1 乃至第 3 の光量比を変更するだけでなく、ある観察モードから第 1 乃至第 3 の光量比を連続的に変更及び調整しても良い。その場合には、内視鏡装置 1 0 の構成を、入力部 1 8 が第 1 乃至第 3 の光量比を変更及び調整するためのユーザ指示を本体部 1 4 に入力する機能を備えるように変更すれば良い。

【 0 1 3 7 】

50

また、この光源駆動部 4 6 は、プロセッサにより構成しても良い。この場合、記憶部 7 4 は、プロセッサ内蔵のメモリであっても良いし、プロセッサがアクセス可能な外部メモリであっても構わない。また、外部メモリには、プロセッサが実行することで当該プロセッサをこの光源駆動部 4 6 として機能させるためのプログラムコードを記憶させておく。

【 0 1 3 8 】

各観察モードにおいて点灯するレーザ光源の組み合わせ及び出射されるレーザ光の組み合わせの詳細については、後述する。

【 0 1 3 9 】

< 光変換部 5 4 >

光変換部 5 4 は、図 8 に示すように、光ファイバ 5 2 の先端にアルミナ粒子などの拡散部材 7 6 を配置してなる。これら光ファイバ 5 2 の先端と拡散部材 7 6 は、ホルダ 7 8 によって、保持されると共に、その位置関係が規定される。

【 0 1 4 0 】

拡散部材 7 6 は、光ファイバ 5 2 によって導光された複数のレーザ光を拡散し、所望な配光に変換する機能を持つ。拡散部材 7 6 は、光の波長については変換しない。

【 0 1 4 1 】

なお、光変換部 5 4 は、拡散部材 7 6 の代わりに、レンズを用いても良いし、レンズと拡散部材 7 6 とを組み合わせ用いても良い。

【 0 1 4 2 】

また、光ファイバ 5 2 の代わりにバンドルファイバを用いる場合には、上記光変換部 5 4 は、拡散部材 7 6 の代わりにレンズを用いても良い。

【 0 1 4 3 】

< 撮像部 2 2 >

撮像部 2 2 は、観察体 O からの反射散乱光 R L を検出し、撮像信号を生成する。撮像信号は、本体部 1 4 の画像処理部 2 4 に出力される。

【 0 1 4 4 】

撮像部 2 2 は、特に図示はしていないが、赤色領域 5 8 R を検出する R 光検出要素と、緑色領域 5 8 G を検出する G 光検出要素と、青色領域 5 8 B を検出する B 光検出要素と、の 3 種類の光検出要素を有している。R 光検出要素と、G 光検出要素と、B 光検出要素におけるカラーフィルタの分光特性の一例は図 4 に示してした通りである。

【 0 1 4 5 】

撮像部 2 2 は、R 光検出要素、G 光検出要素、及び B 光検出要素によって、赤色領域 5 8 R、緑色領域 5 8 G、及び青色領域 5 8 B の 3 つの波長領域についてそれぞれ分離して独立に、R 撮像信号、G 撮像信号、及び B 撮像信号を生成する。

【 0 1 4 6 】

撮像部 2 2 は、具体的には、CCD イメージャや CMOS イメージャである。

【 0 1 4 7 】

なお、撮像部 2 2 は、カラーフィルタを有さないモノクロイメージャでも良い。その場合は、異なるタイミングで順次出射された複数のレーザ光に対する反射散乱光 R L を、異なるタイミングで順次受光して撮像信号を生成し、画像処理部 2 4 において R G B に割当処理を行う。

【 0 1 4 8 】

< 画像処理部 2 4、画像表示部 1 6 >

画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、観察体画像を構成する画像信号を生成する。

【 0 1 4 9 】

なお、この画像処理部 2 4 は、プロセッサにより構成しても良い。この場合、プロセッサがアクセス可能な外部メモリに、プロセッサが実行することで当該プロセッサをこの画像処理部 2 4 として機能させるためのプログラムコードを記憶しておく。

10

20

30

40

50

## 【 0 1 5 0 】

なお、撮像部 2 2 が、カラーフィルタを有さないモノクロイメージャの場合は、異なるタイミングで順次生成された撮像信号に対して、B G R へ割当処理を行ったうえで、画像信号を生成する。

## 【 0 1 5 1 】

画像表示部 1 6 は、画像処理部 2 4 によって生成された画像信号に従って観察体画像を表示する。画像表示部 1 6 は、例えば液晶ディスプレイ等のモニタである。

## 【 0 1 5 2 】

以下に、以上説明したような構成の内視鏡装置 1 0 の動作を説明する。

## 【 0 1 5 3 】

前述したように、光源駆動部 4 6 は、ユーザにより入力された観察モードを示す入力部 1 8 からの観察モード情報に応じて、レーザ光源 4 4 - 1 ~ 4 4 - 6 に対して、点灯させるレーザの組み合わせを、図 9 に示すように制御する。これにより、画像表示部 1 6 には、各観察モードにおいて、図 1 0 に示すように観察体画像が表示される。

## 【 0 1 5 4 】

なお、図 9 において、レーザ光スペクトルの縦軸は任意スケールである。また、図 9 及び図 1 0 は、観察モード M 1 ~ M 1 6 の何れかの血管強調モードを示しており、観察モード M 1 7 の通常観察モードは示していない。

## 【 0 1 5 5 】

以下、各観察モードについて、詳細に説明する。

## 【 0 1 5 6 】

< 観察モード M 1 ( 表層血管強調モード ) >

ユーザによって、入力部 1 8 に観察モードとして、観察モード M 1 ( 表層血管強調モード ) が入力されると、入力部 1 8 から光源駆動部 4 6 と画像処理部 2 4 へ観察モード M 1 ( 表層血管強調モード ) の観察モード情報が出力される。

## 【 0 1 5 7 】

光源駆動部 4 6 は、観察モード M 1 ( 表層血管強調モード ) の観察モード情報を受け取ると、図 7、図 9 及び図 1 1 に示すように、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 )、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 )、及びレーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) を点灯し、それらレーザ光源 4 4 - 1、4 4 - 4 及び 4 4 - 6 から第 1 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光を出射させる。

## 【 0 1 5 8 】

すなわち、光源駆動部 4 6 の光量比変更部 7 2 は、第 1 乃至第 3 の光量比を次のように変更する。

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比 ( 第 1 の光量比 ) = 1 : 0、

第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比 ( 第 2 の光量比 ) = 0 : 1、

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比 ( 第 3 の光量比 ) = 0 : 1。

## 【 0 1 5 9 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 ) は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 ) から出射される第 1 のレーザ光は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する強調狭帯域光である。この表層血管 6 8 s に対する強調狭帯域光である第 1 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 1 に示すように、4 1 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。なお、図 1 1 において、レーザ光スペクトルの縦軸は任意スケールである。

## 【 0 1 6 0 】

また、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 ) は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 ) から出射される第 4 のレーザ光は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における非強調狭帯域光である。この中層血管 6 8 m に対する非強調狭帯域光である第 4 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 1 に示すように、5 1 5 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

## 【 0 1 6 1 】

そして、レーザ光源 4 4 - 6 (レーザ 6) は、深層血管 6 8 d (深層領域 7 0 d) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 6 (レーザ 6) から出射される第 6 のレーザ光は、深層血管 6 8 d (深層領域 7 0 d) における非強調狭帯域光である。この深層血管 6 8 d に対する非強調狭帯域光である第 6 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 1 に示すように、6 3 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

## 【 0 1 6 2 】

これら第 1 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光は、光ファイバ 4 8 - 1、4 8 - 4、及び 4 8 - 6 を導光した後、光合波部 5 0 において合波される。

## 【 0 1 6 3 】

合波された第 1 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光は、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 において、所望な配光変換がなされた後、照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。

## 【 0 1 6 4 】

波長が青色領域 5 8 B に含まれる第 1 のレーザ光は、表層領域 7 0 s まで侵達長を有する。第 1 のレーザ光が観察体 O へ照射された場合、表層血管 6 8 s における反射散乱光 R L に対する光強度と、表層血管 6 8 s 周辺における反射散乱光 R L に対する光強度と、の間の光強度差が大きい。言い換えると、表層血管 6 8 s に対するコントラストが高い。すなわち、表層血管 6 8 s が強調される。

## 【 0 1 6 5 】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、撮像部 2 2 で検出される。ここで、撮像部 2 2 は、波長が青色領域 5 8 B に含まれる第 1 のレーザ光の反射散乱光 R L を B 光検出要素で検出し、B 撮像信号を生成する。この B 撮像信号は、画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号を生成する。

## 【 0 1 6 6 】

また、波長が緑色領域 5 8 G に含まれる第 4 のレーザ光は、中層領域 7 0 m まで侵達長を有する。第 4 のレーザ光が観察体 O へ照射された場合、中層血管 6 8 m における反射散乱光 R L に対する光強度と、中層血管 6 8 m 周辺における反射散乱光 R L に対する光強度と、の間の光強度差は小さい。言い換えると、中層血管 6 8 m に対するコントラストが低い。すなわち、中層血管 6 8 m を強調しない。

## 【 0 1 6 7 】

撮像部 2 2 は、波長が緑色領域 5 8 G に含まれる第 4 のレーザ光の反射散乱光 R L を G 光検出要素で検出し、G 撮像信号を生成する。この G 撮像信号は、画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された G 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、G 画像信号を生成する。

## 【 0 1 6 8 】

また、波長が赤色領域 5 8 R に含まれる第 6 のレーザ光は、深層領域 7 0 d まで侵達長を有する。第 6 のレーザ光が観察体 O へ照射された場合、深層血管 6 8 d における反射散乱光 R L に対する光強度と、深層血管 6 8 d 周辺における反射散乱光 R L に対する光強度と、の間の光強度差は小さい。言い換えると、深層血管 6 8 d に対するコントラストが低い。すなわち、深層血管 6 8 d を強調しない。

## 【 0 1 6 9 】

撮像部 2 2 は、波長が赤色領域 5 8 R に含まれる第 6 のレーザ光の反射散乱光 R L を R 光検出要素で検出し、R 撮像信号を生成する。この R 撮像信号は、画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、R 画像信号を生成する。

## 【 0 1 7 0 】

すなわち、表層血管 6 8 s における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、中層血管 6 8 m 及び深層血管 6 8 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よ

10

20

30

40

50

りも、血管周辺部（粘膜部など）における反射散乱光 R L に対する光強度との強度差が大きい。

【 0 1 7 1 】

観察モード M 1（表層血管強調モード）における照明光 I L においては、表層領域 7 0 s が注目深さ領域であり、中層領域 7 0 m 及び深層領域 7 0 d が非注目深さ領域である。

【 0 1 7 2 】

表層血管 6 8 s を詳細に観察したい場合に、この観察モードが有効である。

【 0 1 7 3 】

また、照明光 I L において、強調狭帯域光が含まれるのは、3つの色領域のうち、何れか1つの色領域のみである。それにより、表層のみ、あるいは、後述するように中層のみまたは深層のみを強調できる。なおここで、何れか1つの色領域のみとは、他の色領域と領域が重なっている色重なり領域を除外するものではない。この色重なり領域を含めたその1つの色領域を指す。

【 0 1 7 4 】

さらに、照明光 I L において、強調狭帯域光が1つのみである。また、照明光 I L において、非強調狭帯域光は、強調狭帯域光が含まれる色領域には含まれない。これにより、注目深さの血管を強調することができる。注目深さ領域に強調狭帯域光が複数ある、または強調狭帯域光と非強調狭帯域光が混合されると、注目深さの血管コントラストが低減するためである。

【 0 1 7 5 】

また、第1のレーザ光（強調狭帯域光）と第4のレーザ光（非強調狭帯域光）と第6のレーザ光（非強調狭帯域光）は、同時に点灯して、観察体 O に照射しても良いし、それぞれを異なるタイミングで順次点灯して、順次照射しても良い。特に、撮像部 2 2 が、カラーフィルタを有さないモノクロイメージャである場合は、それぞれを異なるタイミングで順次点灯して、順次照射する必要がある。

【 0 1 7 6 】

ただし、強調狭帯域光と、この強調狭帯域光が含まれる色領域と隣り合う色領域（この場合は、緑色領域 5 8 G）に含まれる非強調狭帯域光（この場合は、第4のレーザ光）については、それぞれ異なるタイミングで順次出射され、撮像部 2 2 において、それぞれ B 撮像信号と G 撮像信号に完全に分離されることが望ましい。撮像部 2 2 のカラーフィルタにおいては、隣り合う色領域についても感度を有する場合が多い。その場合、強調狭帯域光が含まれる撮像信号（この場合、B 撮像信号）に対して非強調狭帯域光（この場合、第4のレーザ）も含まれてしまい、注目深さの血管コントラストが低下してしまうためである。

【 0 1 7 7 】

また、第1のレーザ光と第4のレーザ光と第6のレーザ光との強度比は、それら第1、第4及び第6のレーザ光の混合光が白色光となるように設定される。白色光とは、例えばキセノンランプやハロゲンランプのような広帯域な照明光 I L の色を再現する色である。または、白色光とは、キセノンランプやハロゲンランプのような広帯域な照明光 I L に照射されたときの観察体 O の色を再現する色である。より具体的には、白色光は、例えば、色度座標、相関色温度、黒体軌跡からの色差を用いて定義される。例えば、色度座標においては、 $(x = 0.2 \sim 0.4, y = 0.2 \sim 0.4)$ 、 $(x = 0.4 \sim 0.5, y = 0.35 \sim 0.45)$  の範囲の色、また、相関色温度においては、相関色温度  $2000 \sim 10000$  K の範囲の色、あるいは、黒体軌跡においては、黒体軌跡からの色差  $(duv)$  が  $\pm 0.1$  以内の色、として定義される。また、白色光は、撮像素子の分光感度を考慮して定義しても良い。例えば、照明光 I L のスペクトルに撮像素子の分光感度を掛け合わせたスペクトルに対して算出した色度座標または相関色温度に対して、上記のように規定しても良い。

【 0 1 7 8 】

また、用途に応じて、白色以外の色となるように設定されても良い。その場合も、上記

10

20

30

40

50

のように色度座標等で色を規定する。

【0179】

照明光 I L に含まれる 2 つの非強調狭帯域光は、強調狭帯域光が含まれていない 2 つの色領域（この場合、緑色領域 5 8 G、赤色領域 5 8 R）にそれぞれ含まれる。非強調狭帯域光は、照明光 I L の色再現性を高めるように照明光 I L を構成する複数の狭帯域光に含まれる。なお、3 つの色領域のうち、強調狭帯域光が含まれていないすべての色領域に非強調狭帯域光が含まれることが照明光 I L の色再現性向上にとってより望ましいが、少なくとも 1 つの非強調狭帯域光が、強調狭帯域光が含まれていない色領域に含まれていれば良い（例えば、第 1 のレーザ光と第 4 のレーザ光のみ、または、第 1 のレーザ光と第 6 のレーザ光のみでも良い）。それにより、照明光 I L の色再現性が向上する。さらに、強調狭帯域光と非強調狭帯域光のどちらか一方が 3 つの色領域の各々に含まれていることが、色再現性向上において、より好ましい。

10

【0180】

画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれる色領域に対応する撮像信号に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。

【0181】

この 3 つの画像処理自体は、公知の画像処理である。

すなわち、コントラスト強調画像処理は、画像の明暗の差（コントラスト）を広げる画像処理である。

20

また、輪郭（エッジ）強調画像処理は、画像内の輪郭（エッジ）部（明るさの境目）の明暗の差を広げる画像処理である。

そして、血管構造画像処理は、血管模様に対応した周波数成分を強調する画像処理である。

【0182】

また、画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭（エッジ）抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。

30

【0183】

この 3 つの画像処理自体は、公知の画像処理である。

すなわち、コントラスト強調画像処理は、画像の明暗の差（コントラスト）を狭める画像処理である。

また、輪郭（エッジ）強調画像処理は、画像内の輪郭（エッジ）部（明るさの境目）の明暗の差を狭める画像処理である。

そして、血管構造画像処理は、血管模様に対応した周波数成分を抑制する画像処理である。

【0184】

また、強調狭帯域光と非強調狭帯域光が 2 つの色領域のみにしか含まれていない場合（例えば、第 1 のレーザ光と第 4 のレーザ光のみの場合）は、公知の色変換処理として、2 つの撮像信号を 3 つの画像信号に割り当てを行って観察体画像を生成しても良い（例えば、G 撮像信号から R 画像を生成し、B 撮像信号から G 及び B 画像を生成する）。

40

【0185】

そして、画像処理部 2 4 で生成された B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号は、画像表示部 1 6 に送信され、図 1 0 及び図 1 2 に示すように、観察体画像 8 0 として表示される。すなわち、この観察体画像 8 0 では、表層血管 6 8 s を示す表層血管画像 8 2 s が強調して表示され、中層血管 6 8 m 及び深層血管 6 8 d を示す中層血管画像 8 2 m 及び深層血管画像 8 2 d については強調表示されない。

【0186】

50

< 観察モード M 2 ( 中層血管強調モード ) >

ユーザによって、入力部 1 8 に観察モードとして、観察モード M 2 ( 中層血管強調モード ) が入力されると、入力部 1 8 から光源駆動部 4 6 と画像処理部 2 4 へ観察モード M 2 ( 中層血管強調モード ) の観察モード情報が出力される。

【 0 1 8 7 】

光源駆動部 4 6 は、観察モード M 2 ( 中層血管強調モード ) の観察モード情報を受け取ると、図 7、図 9 及び図 1 3 に示すように、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 )、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 )、及びレーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) を点灯し、それらレーザ光源 4 4 - 2、4 4 - 3 及び 4 4 - 6 から第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光を出射させる。

10

【 0 1 8 8 】

すなわち、光源駆動部 4 6 の光量比変更部 7 2 は、第 1 乃至第 3 の光量比を次のように変更する。

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比 ( 第 1 の光量比 ) = 0 : 1、

第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比 ( 第 2 の光量比 ) = 1 : 0、

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比 ( 第 3 の光量比 ) = 0 : 1。

【 0 1 8 9 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) から出射される第 2 のレーザ光は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光である。この表層血管 6 8 s に対する非強調狭帯域光である第 2 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 3 に示すように、4 4 5 nm であり、青色領域 5 8 B に含まれる。なお、図 1 3 において、レーザ光スペクトルの縦軸は任意スケールである。

20

【 0 1 9 0 】

また、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) から出射される第 3 のレーザ光は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光である。この中層血管 6 8 m に対する強調狭帯域光である第 3 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 3 に示すように、5 4 0 nm であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

【 0 1 9 1 】

30

そして、レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) から出射される第 6 のレーザ光は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における非強調狭帯域光である。この深層血管 6 8 d に対する非強調狭帯域光である第 6 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 3 に示すように、6 3 5 nm であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

【 0 1 9 2 】

これら第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光は、光ファイバ 4 8 - 2、4 8 - 3、及び 4 8 - 6 を導光した後、光合波部 5 0 において合波される。

【 0 1 9 3 】

合波された第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光は、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 において、所望な配光変換がなされた後、照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。

40

【 0 1 9 4 】

波長が青色領域 5 8 B に含まれる第 2 のレーザ光は、表層領域 7 0 s まで侵達長を有する。第 2 のレーザ光が観察体 O へ照射された場合、表層血管 6 8 s における反射散乱光 R L に対する光強度と、表層血管 6 8 s 周辺における反射散乱光 R L に対する光強度と、間の光強度差は小さい。言い換えると、表層血管 6 8 s に対するコントラストが低い。すなわち、表層血管 6 8 s を強調しない。

【 0 1 9 5 】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、撮像部 2 2 で検出される。ここで、

50

撮像部 22 は、波長が青色領域 58B に含まれる第 2 のレーザ光の反射散乱光 RL を B 光検出要素で検出し、B 撮像信号を生成する。この B 撮像信号は、画像処理部 24 へ出力される。画像処理部 24 は、撮像部 22 から出力された B 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号を生成する。

【0196】

また、波長が緑色領域 58G に含まれる第 3 のレーザ光は、中層領域 70m まで侵達長を有する。第 3 のレーザ光が観察体 O へ照射された場合、中層血管 68m における反射散乱光 RL に対する光強度と、中層血管 68m 周辺における反射散乱光 RL に対する光強度と、の間の光強度差は大きい。言い換えると、中層血管 68m に対するコントラストが高い。すなわち、中層血管 68m が強調される。

10

【0197】

撮像部 22 は、波長が緑色領域 58G に含まれる第 3 のレーザ光の反射散乱光 RL を G 光検出要素で検出し、G 撮像信号を生成する。この G 撮像信号は、画像処理部 24 へ出力される。画像処理部 24 は、撮像部 22 から出力された G 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、G 画像信号を生成する。

【0198】

また、波長が赤色領域 58R に含まれる第 6 のレーザ光は、深層領域 70d まで侵達長を有する。第 6 のレーザ光が観察体 O へ照射された場合、深層血管 68d における反射散乱光 RL に対する光強度と、深層血管 68d 周辺における反射散乱光 RL に対する光強度と、の間の光強度差は小さい。言い換えると、深層血管 68d に対するコントラストが低い。すなわち、深層血管 68d を強調しない。

20

【0199】

撮像部 22 は、波長が赤色領域 58R に含まれる第 6 のレーザ光の反射散乱光 RL を R 光検出要素で検出し、R 撮像信号を生成する。この R 撮像信号は、画像処理部 24 へ出力される。画像処理部 24 は、撮像部 22 から出力された R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、R 画像信号を生成する。

【0200】

すなわち、中層血管 68m における照明光 IL の反射散乱光 RL に対する光強度は、表層血管 68s 及び深層血管 68d における照明光 IL の反射散乱光 RL に対する光強度よりも、血管周辺部（粘膜部など）における反射散乱光 RL に対する光強度との強度差が大きい。

30

【0201】

観察モード M2（中層血管強調モード）における照明光 IL においては、中層領域 70m が注目深さ領域であり、表層領域 70s 及び深層領域 70d が非注目深さ領域である。

【0202】

中層血管 68m を詳細に観察したい場合に、この観察モードが有効である。

【0203】

画像処理部 24 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれる色領域に対応する撮像信号（この場合、G 撮像信号）に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。また、画像処理部 24 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号（この場合、B 撮像信号及び R 撮像信号）に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭（エッジ）抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。

40

【0204】

そして、画像処理部 24 で生成された B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号は、画像表示部 16 に送信され、図 10 及び図 14 に示すように、観察体画像 80 として表示される。すなわち、この観察体画像 80 では、中層血管 68m を示す中層血管画像 82m が強調して表示され、表層血管 68s 及び深層血管 68d を示す表層血管画像 82s 及び深層血管画像 82d については強調表示されない。

50

## 【 0 2 0 5 】

< 観察モード M 3 ( 深層血管強調モード ) >

ユーザによって、入力部 1 8 に観察モードとして、観察モード M 3 ( 深層血管強調モード ) が入力されると、入力部 1 8 から光源駆動部 4 6 と画像処理部 2 4 へ観察モード M 3 ( 深層血管強調モード ) の観察モード情報が出力される。

## 【 0 2 0 6 】

光源駆動部 4 6 は、観察モード M 3 ( 深層血管強調モード ) の観察モード情報を受け取ると、図 7、図 9 及び図 1 5 に示すように、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 )、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 )、及びレーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) を点灯し、それらレーザ光源 4 4 - 2、4 4 - 4 及び 4 4 - 5 から第 2 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光を出射させる。

10

## 【 0 2 0 7 】

すなわち、光源駆動部 4 6 の光量比変更部 7 2 は、第 1 乃至第 3 の光量比を次のように変更する。

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比 ( 第 1 の光量比 ) = 0 : 1、

第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比 ( 第 2 の光量比 ) = 0 : 1、

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比 ( 第 3 の光量比 ) = 1 : 0。

## 【 0 2 0 8 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) から出射される第 2 のレーザ光は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光である。この表層血管 6 8 s に対する非強調狭帯域光である第 2 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 5 に示すように、4 4 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。なお、図 1 5 において、レーザ光スペクトルの縦軸は任意スケールである。

20

## 【 0 2 0 9 】

また、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 ) は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 ) から出射される第 4 のレーザ光は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における非強調狭帯域光である。この中層血管 6 8 m に対する非強調狭帯域光である第 4 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 5 に示すように、5 1 5 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

30

## 【 0 2 1 0 】

そして、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) から出射される第 5 のレーザ光は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における強調狭帯域光である。この深層血管 6 8 d に対する強調狭帯域光である第 5 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 5 に示すように、5 9 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

## 【 0 2 1 1 】

これら第 2 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光は、光ファイバ 4 8 - 2、4 8 - 4、及び 4 8 - 5 を導光した後、光合波部 5 0 において合波される。

## 【 0 2 1 2 】

合波された第 2 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光は、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 において、所望な配光変換がなされた後、照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。

40

## 【 0 2 1 3 】

波長が青色領域 5 8 B に含まれる第 2 のレーザ光は、表層領域 7 0 s まで侵達長を有する。第 2 のレーザ光が観察体 O へ照射された場合、表層血管 6 8 s における反射散乱光 R L に対する光強度と、表層血管 6 8 s 周辺における反射散乱光 R L に対する光強度と、間の光強度差は小さい。言い換えると、表層血管 6 8 s に対するコントラストが低い。すなわち、表層血管 6 8 s を強調しない。

## 【 0 2 1 4 】

50

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、撮像部 2 2 で検出される。ここで、撮像部 2 2 は、波長が青色領域 5 8 B に含まれる第 2 のレーザ光の反射散乱光 R L を B 光検出要素で検出し、B 撮像信号を生成する。この B 撮像信号は、画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号を生成する。

【0215】

また、波長が緑色領域 5 8 G に含まれる第 4 のレーザ光は、中層領域 7 0 m まで侵達長を有する。第 4 のレーザ光が観察体 O へ照射された場合、中層血管 6 8 m における反射散乱光 R L に対する光強度と、中層血管 6 8 m 周辺における反射散乱光 R L に対する光強度と、の間の光強度差は小さい。言い換えると、中層血管 6 8 m に対するコントラストが低い。すなわち、中層血管 6 8 m を強調しない。

10

【0216】

撮像部 2 2 は、波長が緑色領域 5 8 G に含まれる第 4 のレーザ光の反射散乱光 R L を G 光検出要素で検出し、G 撮像信号を生成する。この G 撮像信号は、画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された G 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、G 画像信号を生成する。

【0217】

また、波長が赤色領域 5 8 R に含まれる第 5 のレーザ光は、深層領域 7 0 d まで侵達長を有する。第 5 のレーザ光が観察体 O へ照射された場合、深層血管 6 8 d における反射散乱光 R L に対する光強度と、深層血管 6 8 d 周辺における反射散乱光 R L に対する光強度と、の間の光強度差は大きい。言い換えると、深層血管 6 8 d に対するコントラストが高い。すなわち、深層血管 6 8 d が強調される。

20

【0218】

撮像部 2 2 は、波長が赤色領域 5 8 R に含まれる第 5 のレーザ光の反射散乱光 R L を R 光検出要素で検出し、R 撮像信号を生成する。この R 撮像信号は、画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、R 画像信号を生成する。

【0219】

すなわち、深層血管 6 8 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、表層血管 6 8 s 及び中層血管 6 8 m における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部（粘膜部など）における反射散乱光 R L に対する光強度との強度差が大きい。

30

【0220】

観察モード M 3（深層血管強調モード）における照明光 I L においては、深層領域 7 0 d が注目深さ領域であり、表層領域 7 0 s 及び中層領域 7 0 m が非注目深さ領域である。

【0221】

深層血管 6 8 d を詳細に観察したい場合に、この観察モードが有効である。

【0222】

画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれる色領域に対応する撮像信号（この場合、R 撮像信号）に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。また、画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号（この場合、B 撮像信号及び G 撮像信号）に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭（エッジ）抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。

40

【0223】

そして、画像処理部 2 4 で生成された B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号は、画像表示部 1 6 に送信され、図 1 0 及び図 1 6 に示すように、観察体画像 8 0 として表示される。すなわち、この観察体画像 8 0 では、深層血管 6 8 d を示す深層血管画像 8 2 d が強調して表示され、表層血管 6 8 s 及び中層血管 6 8 m を示す表層血管画像 8 2 s 及び中

50

層血管画像 8 2 m については強調表示されない。

【 0 2 2 4 】

< 観察モード M 4 ( 表層-中層血管強調モード ) >

ユーザによって、入力部 1 8 に観察モードとして、観察モード M 4 ( 表層-中層血管強調モード ) が入力されると、入力部 1 8 から光源駆動部 4 6 と画像処理部 2 4 へ観察モード M 4 ( 表層-中層血管強調モード ) の観察モード情報が出力される。

【 0 2 2 5 】

光源駆動部 4 6 は、観察モード M 4 ( 表層-中層血管強調モード ) の観察モード情報を受け取ると、図 7、図 9 及び図 1 7 に示すように、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 )、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 )、及びレーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) を点灯し、それらレーザ光源 4 4 - 1、4 4 - 3 及び 4 4 - 6 から第 1 のレーザ光、第 3 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光を出射させる。

10

【 0 2 2 6 】

すなわち、光源駆動部 4 6 の光量比変更部 7 2 は、第 1 乃至第 3 の光量比を次のように変更する。

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比 ( 第 1 の光量比 ) = 1 : 0、

第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比 ( 第 2 の光量比 ) = 1 : 0、

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比 ( 第 3 の光量比 ) = 0 : 1。

【 0 2 2 7 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 ) は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 ) から出射される第 1 のレーザ光は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する強調狭帯域光である。この表層血管 6 8 s に対する強調狭帯域光である第 1 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 7 に示すように、4 1 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。なお、図 1 7 において、レーザ光スペクトルの縦軸は任意スケールである。

20

【 0 2 2 8 】

また、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) から出射される第 3 のレーザ光は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光である。この中層血管 6 8 m に対する強調狭帯域光である第 3 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 7 に示すように、5 4 0 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

30

【 0 2 2 9 】

そして、レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) から出射される第 6 のレーザ光は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における非強調狭帯域光である。この深層血管 6 8 d に対する非強調狭帯域光である第 6 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 7 に示すように、6 3 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

【 0 2 3 0 】

これら第 1 のレーザ光、第 3 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 から照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。

40

【 0 2 3 1 】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、前述したように、撮像部 2 2 で検出され、撮像部 2 2 から B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号が画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号を生成する。

【 0 2 3 2 】

すなわち、表層血管 6 8 s 及び中層血管 6 8 m における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、深層血管 6 8 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よ

50

りも、血管周辺部（粘膜部など）における反射散乱光 R L に対する光強度との強度差が大きい。

【 0 2 3 3 】

観察モード M 4（表層-中層血管強調モード）における照明光 I L においては、表層領域 7 0 s 及び中層領域 7 0 m が注目深さ領域であり、深層領域 7 0 d が非注目深さ領域である。

【 0 2 3 4 】

表層血管 6 8 s 及び中層血管 6 8 m を詳細に観察したい場合に、この観察モードが有効である。

【 0 2 3 5 】

画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれる色領域に対応する撮像信号（この場合、B 撮像信号及び G 撮像信号）に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。また、画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号（この場合、R 撮像信号）に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭（エッジ）抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。

【 0 2 3 6 】

そして、画像処理部 2 4 で生成された B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号は、画像表示部 1 6 に送信され、図 1 0 及び図 1 8 に示すように、観察体画像 8 0 として表示される。すなわち、この観察体画像 8 0 では、表層血管 6 8 s 及び中層血管 6 8 m を示す表層血管画像 8 2 s 及び中層血管画像 8 2 m が強調して表示され、深層血管 6 8 d を示す深層血管画像 8 2 d については強調表示されない。

【 0 2 3 7 】

< 観察モード M 5（表層-深層血管強調モード） >

ユーザによって、入力部 1 8 に観察モードとして、観察モード M 5（表層-深層血管強調モード）が入力されると、入力部 1 8 から光源駆動部 4 6 と画像処理部 2 4 へ観察モード M 5（表層-深層血管強調モード）の観察モード情報が出力される。

【 0 2 3 8 】

光源駆動部 4 6 は、観察モード M 5（表層-深層血管強調モード）の観察モード情報を受け取ると、図 7 及び図 9 に示すように、レーザ光源 4 4 - 1（レーザ 1）、レーザ光源 4 4 - 4（レーザ 4）、及びレーザ光源 4 4 - 5（レーザ 5）を点灯し、それらレーザ光源 4 4 - 1、4 4 - 4 及び 4 4 - 5 から第 1 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光を出射させる。

【 0 2 3 9 】

すなわち、光源駆動部 4 6 の光量比変更部 7 2 は、第 1 乃至第 3 の光量比を次のように変更する。

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比（第 1 の光量比）= 1 : 0、

第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比（第 2 の光量比）= 0 : 1、

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比（第 3 の光量比）= 1 : 0。

【 0 2 4 0 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 1（レーザ 1）は、表層血管 6 8 s（表層領域 7 0 s）に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 1（レーザ 1）から出射される第 1 のレーザ光は、表層血管 6 8 s（表層領域 7 0 s）に対する強調狭帯域光である。この第 1 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 1 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

【 0 2 4 1 】

また、レーザ光源 4 4 - 4（レーザ 4）は、中層血管 6 8 m（中層領域 7 0 m）における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 4（レーザ 4）から出射される第 4 のレーザ光は、中層血管 6 8 m（中層領域 7 0 m）における非強調狭帯域光である。この第 4 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 1 5 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

10

20

30

40

50

## 【 0 2 4 2 】

そして、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) から出射される第 5 のレーザ光は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における強調狭帯域光である。この第 5 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 9 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

## 【 0 2 4 3 】

これら第 1 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 から照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。

## 【 0 2 4 4 】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、前述したように、撮像部 2 2 で検出され、撮像部 2 2 から B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号が画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号を生成する。

## 【 0 2 4 5 】

すなわち、表層血管 6 8 s 及び深層血管 6 8 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、中層血管 6 8 m における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部 ( 粘膜部など ) における反射散乱光 R L に対する光強度との強度差が大きい。

## 【 0 2 4 6 】

観察モード M 5 ( 表層-深層血管強調モード ) における照明光 I L においては、表層領域 7 0 s 及び深層領域 7 0 d が注目深さ領域であり、中層領域 7 0 m が非注目深さ領域である。

## 【 0 2 4 7 】

表層血管 6 8 s 及び深層血管 6 8 d を詳細に観察したい場合に、この観察モードが有効である。

## 【 0 2 4 8 】

画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれる色領域に対応する撮像信号 ( この場合、B 撮像信号及び R 撮像信号 ) に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭 ( エッジ ) 強調画像処理と、血管構造画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。また、画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号 ( この場合、G 撮像信号 ) に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭 ( エッジ ) 抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。

## 【 0 2 4 9 】

そして、画像処理部 2 4 で生成された B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号は、画像表示部 1 6 に送信され、図 1 0 に示すように、観察体画像 8 0 として表示される。すなわち、この観察体画像 8 0 では、表層血管 6 8 s 及び深層血管 6 8 d を示す表層血管画像 8 2 s 及び深層血管画像 8 2 d が強調して表示され、中層血管 6 8 m を示す中層血管画像 8 2 m については強調表示されない。

## 【 0 2 5 0 】

< 観察モード M 6 ( 中層-深層血管強調モード ) >

ユーザによって、入力部 1 8 に観察モードとして、観察モード M 6 ( 中層-深層血管強調モード ) が入力されると、入力部 1 8 から光源駆動部 4 6 と画像処理部 2 4 へ観察モード M 6 ( 中層-深層血管強調モード ) の観察モード情報が出力される。

## 【 0 2 5 1 】

光源駆動部 4 6 は、観察モード M 6 ( 中層-深層血管強調モード ) の観察モード情報を受け取ると、図 7 及び図 9 に示すように、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 )、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 )、及びレーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) を点灯し、それらレーザ光

10

20

30

40

50

源 4 4 - 2、4 4 - 3 及び 4 4 - 5 から第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光を出射させる。

【 0 2 5 2 】

すなわち、光源駆動部 4 6 の光量比変更部 7 2 は、第 1 乃至第 3 の光量比を次のように変更する。

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比（第 1 の光量比）＝ 0 : 1、

第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比（第 2 の光量比）＝ 1 : 0、

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比（第 3 の光量比）＝ 1 : 0。

【 0 2 5 3 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 2（レーザ 2）は、表層血管 6 8 s（表層領域 7 0 s）に対する非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 2（レーザ 2）から出射される第 2 のレーザ光は、表層血管 6 8 s（表層領域 7 0 s）に対する非強調狭帯域光である。この第 2 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 4 5 nm であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

10

【 0 2 5 4 】

また、レーザ光源 4 4 - 3（レーザ 3）は、中層血管 6 8 m（中層領域 7 0 m）における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 3（レーザ 3）から出射される第 3 のレーザ光は、中層血管 6 8 m（中層領域 7 0 m）における強調狭帯域光である。この第 3 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 4 0 nm であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

【 0 2 5 5 】

20

そして、レーザ光源 4 4 - 5（レーザ 5）は、深層血管 6 8 d（深層領域 7 0 d）における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 5（レーザ 5）から出射される第 5 のレーザ光は、深層血管 6 8 d（深層領域 7 0 d）における強調狭帯域光である。この第 5 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 9 5 nm であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

【 0 2 5 6 】

これら第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 から照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。

【 0 2 5 7 】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、前述したように、撮像部 2 2 で検出され、撮像部 2 2 から B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号が画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号を生成する。

30

【 0 2 5 8 】

すなわち、中層血管 6 8 m 及び深層血管 6 8 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、表層血管 6 8 s における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部（粘膜部など）における反射散乱光 R L に対する光強度との強度差が大きい。

【 0 2 5 9 】

40

観察モード M 6（中層-深層血管強調モード）における照明光 I L においては、中層領域 7 0 m 及び深層領域 7 0 d が注目深さ領域であり、表層領域 7 0 s が非注目深さ領域である。

【 0 2 6 0 】

中層血管 6 8 m 及び深層血管 6 8 d を詳細に観察したい場合に、この観察モードが有効である。

【 0 2 6 1 】

画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれる色領域に対応する撮像信号（この場合、G 撮像信号及び R 撮像信号）に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の 3 種

50

の画像処理のうち、少なくとも1つを行う。また、画像処理部24は、B撮像信号、G撮像信号、R撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号（この場合、B撮像信号）に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭（エッジ）抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の3種の画像処理のうち、少なくとも1つを行う。

【0262】

そして、画像処理部24で生成されたB画像信号、G画像信号、及びR画像信号は、画像表示部16に送信され、図10に示すように、観察体画像80として表示される。すなわち、この観察体画像80では、中層血管68m及び深層血管68dを示す中層血管画像82m及び深層血管画像82dが強調して表示され、表層血管68sを示す表層血管画像82sについては強調表示されない。

10

【0263】

<観察モードM7（表層-中層-深層血管強調モード）>

ユーザによって、入力部18に観察モードとして、観察モードM7（表層-中層-深層血管強調モード）が入力されると、入力部18から光源駆動部46と画像処理部24へ観察モードM7（表層-中層-深層血管強調モード）の観察モード情報が出力される。

【0264】

光源駆動部46は、観察モードM7（表層-中層-深層血管強調モード）の観察モード情報を受け取ると、図7及び図9に示すように、レーザ光源44-1（レーザ1）、レーザ光源44-3（レーザ3）、及びレーザ光源44-5（レーザ5）を点灯し、それらレーザ光源44-1、44-3及び44-5から第1のレーザ光、第3のレーザ光、及び第5

20

【0265】

すなわち、光源駆動部46の光量比変更部72は、第1乃至第3の光量比を次のように変更する。

第1のレーザ光と第2のレーザ光の光量比（第1の光量比）＝1：0、

第3のレーザ光と第4のレーザ光の光量比（第2の光量比）＝1：0、

第5のレーザ光と第6のレーザ光の光量比（第3の光量比）＝1：0。

【0266】

ここで、レーザ光源44-1（レーザ1）は、表層血管68s（表層領域70s）に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源44-1（レーザ1）から出射される第1のレーザ光は、表層血管68s（表層領域70s）に対する強調狭帯域光である。この第1のレーザ光の波長は、図9に示すように、415nmであり、青色領域58Bに含まれる。

30

【0267】

また、レーザ光源44-3（レーザ3）は、中層血管68m（中層領域70m）における強調狭帯域光源であり、レーザ光源44-3（レーザ3）から出射される第3のレーザ光は、中層血管68m（中層領域70m）における強調狭帯域光である。この第3のレーザ光の波長は、図9に示すように、540nmであり、緑色領域58Gに含まれる。

【0268】

そして、レーザ光源44-5（レーザ5）は、深層血管68d（深層領域70d）における強調狭帯域光源であり、レーザ光源44-5（レーザ5）から出射される第5のレーザ光は、深層血管68d（深層領域70d）における強調狭帯域光である。この第5のレーザ光の波長は、図9に示すように、595nmであり、赤色領域58Rに含まれる。

40

【0269】

これら第1のレーザ光、第3のレーザ光、及び第5のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部26の先端の光変換部54から照明光ILとして出射され、観察体Oに照射される。

【0270】

観察体Oにおける照明光ILの反射散乱光RLは、前述したように、撮像部22で検出され、撮像部22からB撮像信号、G撮像信号、及びR撮像信号が画像処理部24へ出力される。画像処理部24は、撮像部22から出力されたB撮像信号、G撮像信号、及びR

50

撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B画像信号、G画像信号、及びR画像信号を生成する。

【0271】

観察モードM7（表層-中層-深層血管強調モード）における照明光ILにおいては、表層領域70s、中層領域70m、及び深層領域70dが注目深さ領域である。非強調狭帯域光は無いため、非注目深さ領域は無い。

【0272】

表層血管68s、中層血管68m、及び深層血管68dのすべてを詳細に観察したい場合に、この観察モードが有効である。

【0273】

画像処理部24は、B撮像信号、G撮像信号、R撮像信号のすべてに対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の3種の画像処理のうち、少なくとも1つを行う。

【0274】

そして、画像処理部24で生成されたB画像信号、G画像信号、及びR画像信号は、画像表示部16に送信され、図10に示すように、観察体画像80として表示される。すなわち、この観察体画像80では、表層血管68s、中層血管68m、及び深層血管68dを示す表層血管画像82s、中層血管画像82m、及び深層血管画像82dのすべてが強調して表示される。

【0275】

<観察モードM8（表層-中層血管強調中間モード1）>

ユーザによって、入力部18に観察モードとして、観察モードM8（表層-中層血管強調中間モード1）が入力されると、入力部18から光源駆動部46と画像処理部24へ観察モードM8（表層-中層血管強調中間モード1）の観察モード情報が出力される。

【0276】

光源駆動部46は、観察モードM8（表層-中層血管強調中間モード1）の観察モード情報を受け取ると、図7、図9及び図19に示すように、レーザ光源44-1（レーザ1）、レーザ光源44-3（レーザ3）、レーザ光源44-4（レーザ4）、及びレーザ光源44-6（レーザ6）を点灯し、それらレーザ光源44-1、44-3、44-4及び44-6から第1のレーザ光、第3のレーザ光、第4のレーザ光、及び第6のレーザ光を出射させる。

【0277】

この場合、光源駆動部46の光量比変更部72は、第1乃至第3の光量比を次のように変更する。

第1のレーザ光と第2のレーザ光の光量比（第1の光量比）＝1：0、

第3のレーザ光と第4のレーザ光の光量比（第2の光量比）＝0.5：0.5、

第5のレーザ光と第6のレーザ光の光量比（第3の光量比）＝0：1。

【0278】

ここで、レーザ光源44-1（レーザ1）は、表層血管68s（表層領域70s）に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源44-1（レーザ1）から出射される第1のレーザ光は、表層血管68s（表層領域70s）に対する強調狭帯域光である。この第1のレーザ光の波長は、図9及び図19に示すように、415nmであり、青色領域58Bに含まれる。

【0279】

また、レーザ光源44-3（レーザ3）は、中層血管68m（中層領域70m）における強調狭帯域光源であり、レーザ光源44-3（レーザ3）から出射される第3のレーザ光は、中層血管68m（中層領域70m）における強調狭帯域光である。この第3のレーザ光の波長は、図9及び図19に示すように、540nmであり、緑色領域58Gに含まれる。

【0280】

10

20

30

40

50

また、レーザ光源 44 - 4 (レーザ 4) は、中層血管 68 m (中層領域 70 m) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 44 - 4 (レーザ 4) から出射される第 4 のレーザ光は、中層血管 68 m (中層領域 70 m) における非強調狭帯域光である。この第 4 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 19 に示すように、515 nm であり、緑色領域 58 G に含まれる。

【0281】

そして、レーザ光源 44 - 6 (レーザ 6) は、深層血管 68 d (深層領域 70 d) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 44 - 6 (レーザ 6) から出射される第 6 のレーザ光は、深層血管 68 d (深層領域 70 d) における非強調狭帯域光である。この第 6 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 19 に示すように、635 nm であり、赤色領域 58 R

10

【0282】

これら第 1 のレーザ光、第 3 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 26 の先端の光変換部 54 から照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。つまり、この観察モード M8 (表層-中層血管強調中間モード 1) では、中層血管 68 m を強調する第 3 のレーザ光と中層血管 68 m を強調しない第 4 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。

【0283】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、前述したように、撮像部 22 で検出され、撮像部 22 から B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号が画像処理部 24 へ出力される。画像処理部 24 は、撮像部 22 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号を生成する。

20

【0284】

すなわち、表層血管 68 s における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、中層血管 68 m における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部 (粘膜部など) における反射散乱光 R L に対する光強度との差が大きい。また、中層血管 68 m における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、深層血管 68 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部 (粘膜部など) における反射散乱光 R L に対する光強度との強度差が大きい。

30

【0285】

画像処理部 24 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光のみが含まれる色領域に対応する撮像信号 (この場合、B 撮像信号) に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭 (エッジ) 強調画像処理と、血管構造画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。また、画像処理部 24 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号 (この場合、R 撮像信号) に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭 (エッジ) 抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、残りの色領域に対応する撮像信号 (この場合、G 撮像信号) に対しては、特に強調画像処理や抑制画像処理は行わない。

40

【0286】

そして、画像処理部 24 で生成された B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号は、画像表示部 16 に送信され、図 10 及び図 20 に示すように、観察体画像 80 として表示される。すなわち、この観察体画像 80 では、表層血管 68 s は、観察モード M1 (表層血管強調モード) と同様に表層血管画像 82 s として強調して表示され、深層血管 68 d を示す深層血管画像 82 d については強調表示されない。

【0287】

一方、この観察モード M8 (表層-中層血管強調中間モード 1) では、中層血管 68 m を強調する第 3 のレーザ光と中層血管 68 m を強調しない第 4 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。そのため、結果として、中層血管 68 m は、第 3 のレーザ光のみが照射

50

されて強調された状態と、第4のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、中層血管68mを示す中層血管画像82mは、観察モードM1（表層血管強調モード）と観察モードM4（表層-中層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

【0288】

このような、中間レベルの強調状態の画像では、表層血管68sのみ強調された画像、及び、表層血管68sと中層血管68mが強調された画像、よりも奥行き感のある観察体画像80が生成できる。

【0289】

また、第3のレーザ光と第4のレーザ光の光量比（第2の光量比）は、上記のような0.5:0.5に限るものではない。中層血管68mの強調レベルが、第3のレーザ光のみが照射されて強調された状態と第4のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態との間で、所望の強調レベルになるように設定される。また、用途に応じて連続的に第2の光量比を変更して、強調レベルを変更することも可能である。

【0290】

ここで、第3のレーザ光と第4のレーザ光の光量比（第2の光量比）は、緑色領域58Gにおける光量が一定となるように、変更される。なお、光量が一定とは、出射光量が一定でも良いし、撮像部22の撮像素子で受光される光量が一定でも良い。また、第2の光量比は、撮像素子における分光感度を考慮して変更されても良い。

【0291】

また、第3のレーザ光と第4のレーザ光の光量比（第2の光量比）の変更において、緑色領域58Gの光量（色）が変化する場合は、第3及び第4のレーザ光が含まれる以外の色領域に含まれるレーザ光の光量変更によって、青色領域58Bの光量と、緑色領域58Gの光量と、赤色領域58Rの光量と、の比率を一定としても良い。

【0292】

なお、この観察モードM8（表層-中層血管強調中間モード1）では、第6のレーザ光が含まれず、第1のレーザ光と第3のレーザ光と第4のレーザ光のみを用いても良い。

【0293】

<観察モードM9（表層-中層血管強調中間モード2）>

ユーザによって、入力部18に観察モードとして、観察モードM9（表層-中層血管強調中間モード2）が入力されると、入力部18から光源駆動部46と画像処理部24へ観察モードM9（表層-中層血管強調中間モード2）の観察モード情報が出力される。

【0294】

光源駆動部46は、観察モードM9（表層-中層血管強調中間モード2）の観察モード情報を受け取ると、図7及び図9に示すように、レーザ光源44-1（レーザ1）、レーザ光源44-2（レーザ2）、レーザ光源44-3（レーザ3）、及びレーザ光源44-6（レーザ6）を点灯し、それらレーザ光源44-1、44-2、44-3及び44-6から第1のレーザ光、第2のレーザ光、第3のレーザ光、及び第6のレーザ光を出射させる。

【0295】

この場合、光源駆動部46の光量比変更部72は、第1乃至第3の光量比を次のように変更する。

第1のレーザ光と第2のレーザ光の光量比（第1の光量比）= 0.5:0.5、

第3のレーザ光と第4のレーザ光の光量比（第2の光量比）= 1:0、

第5のレーザ光と第6のレーザ光の光量比（第3の光量比）= 0:1。

【0296】

ここで、レーザ光源44-1（レーザ1）は、表層血管68s（表層領域70s）に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源44-1（レーザ1）から出射される第1のレーザ光は、表層血管68s（表層領域70s）に対する強調狭帯域光である。この第1のレーザ光の波長は、図9に示すように、415nmであり、青色領域58Bに含まれる。

## 【 0 2 9 7 】

また、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) から出射される第 2 のレーザ光は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光である。この第 2 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 4 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

## 【 0 2 9 8 】

また、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) から出射される第 3 のレーザ光は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光である。この第 3 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 4 0 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

10

## 【 0 2 9 9 】

そして、レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) から出射される第 6 のレーザ光は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における非強調狭帯域光である。この第 6 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、6 3 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

## 【 0 3 0 0 】

これら第 1 のレーザ光、第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 から照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。つまり、この観察モード M 9 ( 表層-中層血管強調中間モード 2 ) では、表層血管 6 8 s を強調する第 1 のレーザ光と表層血管 6 8 s を強調しない第 2 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。

20

## 【 0 3 0 1 】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、前述したように、撮像部 2 2 で検出され、撮像部 2 2 から B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号が画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号を生成する。

## 【 0 3 0 2 】

すなわち、中層血管 6 8 m における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、表層血管 6 8 s における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部 ( 粘膜部など ) における反射散乱光 R L に対する光強度との差が大きい。また、表層血管 6 8 s における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、深層血管 6 8 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部 ( 粘膜部など ) における反射散乱光 R L に対する光強度との強度差が大きい。

30

## 【 0 3 0 3 】

画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光のみが含まれる色領域に対応する撮像信号 ( この場合、G 撮像信号 ) に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭 ( エッジ ) 強調画像処理と、血管構造画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。また、画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号 ( この場合、R 撮像信号 ) に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭 ( エッジ ) 抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、残りの色領域に対応する撮像信号 ( この場合、B 撮像信号 ) に対しては、特に強調画像処理や抑制画像処理は行わない。

40

## 【 0 3 0 4 】

そして、画像処理部 2 4 で生成された B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号は、画像表示部 1 6 に送信され、図 1 0 に示すように、観察体画像 8 0 として表示される。すなわち、この観察体画像 8 0 では、中層血管 6 8 m は、観察モード M 2 ( 中層血管強調モード ) 同様に中層血管画像 8 2 m として強調して表示され、深層血管 6 8 d を示す深層血管

50

画像 8 2 d については強調表示されない。

【 0 3 0 5 】

一方、この観察モード M 9 ( 表層-中層血管強調中間モード 2 ) では、表層血管 6 8 s を強調する第 1 のレーザ光と表層血管 6 8 s を強調しない第 2 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。そのため、結果として、表層血管 6 8 s は、第 1 のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第 2 のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、表層血管 6 8 s を示す表層血管画像 8 2 s は、観察モード M 2 ( 中層血管強調モード ) と観察モード M 4 ( 表層-中層血管強調モード ) との中間レベルに強調して表示される。

【 0 3 0 6 】

このような、中間レベルの強調状態の画像では、中層血管 6 8 m のみ強調された画像、及び、表層血管 6 8 s と中層血管 6 8 m が強調された画像、よりも奥行き感のある観察体画像 8 0 が生成できる。

【 0 3 0 7 】

なお、第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比 ( 第 1 の光量比 ) は、上記観察モード M 8 ( 表層-中層血管強調中間モード 1 ) における第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比 ( 第 2 の光量比 ) と同様、変更可能なことは勿論である。

【 0 3 0 8 】

< 観察モード M 1 0 ( 表層-深層血管強調中間モード 1 ) >

ユーザによって、入力部 1 8 に観察モードとして、観察モード M 1 0 ( 表層-深層血管強調中間モード 1 ) が入力されると、入力部 1 8 から光源駆動部 4 6 と画像処理部 2 4 へ観察モード M 1 0 ( 表層-深層血管強調中間モード 1 ) の観察モード情報が出力される。

【 0 3 0 9 】

光源駆動部 4 6 は、観察モード M 1 0 ( 表層-深層血管強調中間モード 1 ) の観察モード情報を受け取ると、図 7 及び図 9 に示すように、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 )、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 )、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 )、及びレーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) を点灯し、それらレーザ光源 4 4 - 1、4 4 - 4、4 4 - 5 及び 4 4 - 6 から第 1 のレーザ光、第 4 のレーザ光、第 5 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光を出射させる。

【 0 3 1 0 】

この場合、光源駆動部 4 6 の光量比変更部 7 2 は、第 1 乃至第 3 の光量比を次のように変更する。

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比 ( 第 1 の光量比 ) = 1 : 0、

第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比 ( 第 2 の光量比 ) = 0 : 1、

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比 ( 第 3 の光量比 ) = 0 . 5 : 0 . 5。

【 0 3 1 1 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 ) は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 ) から出射される第 1 のレーザ光は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する強調狭帯域光である。この第 1 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 1 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

【 0 3 1 2 】

また、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 ) は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 ) から出射される第 4 のレーザ光は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における非強調狭帯域光である。この第 4 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 1 5 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

【 0 3 1 3 】

また、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) から出射される第 5 のレーザ光は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) に対する強調狭帯域光である。この第 5 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 9 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

10

20

30

40

50

## 【0314】

そして、レーザ光源44-6(レーザ6)は、深層血管68d(深層領域70d)における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源44-6(レーザ6)から出射される第6のレーザ光は、深層血管68d(深層領域70d)における非強調狭帯域光である。この第6のレーザ光の波長は、図9に示すように、635nmであり、赤色領域58Rに含まれる。

## 【0315】

これら第1のレーザ光、第4のレーザ光、第5のレーザ光、及び第6のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部26の先端の光変換部54から照明光ILとして出射され、観察体Oに照射される。つまり、この観察モードM10(表層-深層血管強調中間モード1)では、深層血管68dを強調する第5のレーザ光と深層血管68dを強調しない第6のレーザ光とが共に観察体Oへ照射される。

10

## 【0316】

観察体Oにおける照明光ILの反射散乱光RLは、前述したように、撮像部22で検出され、撮像部22からB撮像信号、G撮像信号、及びR撮像信号が画像処理部24へ出力される。画像処理部24は、撮像部22から出力されたB撮像信号、G撮像信号、及びR撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B画像信号、G画像信号、及びR画像信号を生成する。

## 【0317】

すなわち、表層血管68sにおける照明光ILの反射散乱光RLに対する光強度は、深層血管68dにおける照明光ILの反射散乱光RLに対する光強度よりも、血管周辺部(粘膜部など)における反射散乱光RLに対する光強度との差が大きい。また、深層血管68dにおける照明光ILの反射散乱光RLに対する光強度は、中層血管68mにおける照明光ILの反射散乱光RLに対する光強度よりも、血管周辺部(粘膜部など)における反射散乱光RLに対する光強度との強度差が大きい。

20

## 【0318】

画像処理部24は、B撮像信号、G撮像信号、R撮像信号のうち、強調狭帯域光のみが含まれる色領域に対応する撮像信号(この場合、B撮像信号)に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭(エッジ)強調画像処理と、血管構造画像処理と、の3種の画像処理のうち、少なくとも1つを行う。また、画像処理部24は、B撮像信号、G撮像信号、R撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号(この場合、G撮像信号)に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭(エッジ)抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の3種の画像処理のうち、少なくとも1つを行う。B撮像信号、G撮像信号、R撮像信号のうち、残りの色領域に対応する撮像信号(この場合、R撮像信号)に対しては、特に強調画像処理や抑制画像処理は行わない。

30

## 【0319】

そして、画像処理部24で生成されたB画像信号、G画像信号、及びR画像信号は、画像表示部16に送信され、図10に示すように、観察体画像80として表示される。すなわち、この観察体画像80では、表層血管68sは、観察モードM1(表層血管強調モード)同様に表層血管画像82sとして強調して表示され、中層血管68mを示す中層血管画像82mについては強調表示されない。

40

## 【0320】

一方、この観察モードM10(表層-深層血管強調中間モード1)では、深層血管68dを強調する第5のレーザ光と深層血管68dを強調しない第6のレーザ光とが共に観察体Oへ照射される。そのため、結果として、深層血管68dは、第5のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第6のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、深層血管68dを示す深層血管画像82dは、観察モードM1(表層血管強調モード)と観察モードM5(表層-深層血管強調モード)との中間レベルに強調して表示される。

## 【0321】

50

このような、中間レベルの強調状態の画像では、表層血管 6 8 s のみ強調された画像、及び、表層血管 6 8 s と深層血管 6 8 d が強調された画像、よりも奥行き感のある観察体画像 8 0 が生成できる。

【 0 3 2 2 】

なお、第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比（第 3 の光量比）は、上記観察モード M 8（表層-中層血管強調中間モード 1）における第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比（第 2 の光量比）と同様、変更可能なことは勿論である。

【 0 3 2 3 】

< 観察モード M 1 1（表層-深層血管強調中間モード 2）>

ユーザによって、入力部 1 8 に観察モードとして、観察モード M 1 1（表層-深層血管強調中間モード 2）が入力されると、入力部 1 8 から光源駆動部 4 6 と画像処理部 2 4 へ観察モード M 1 1（表層-深層血管強調中間モード 2）の観察モード情報が出力される。

【 0 3 2 4 】

光源駆動部 4 6 は、観察モード M 1 1（表層-深層血管強調中間モード 2）の観察モード情報を受け取ると、図 7 及び図 9 に示すように、レーザ光源 4 4 - 1（レーザ 1）、レーザ光源 4 4 - 2（レーザ 2）、レーザ光源 4 4 - 4（レーザ 4）、及びレーザ光源 4 4 - 5（レーザ 5）を点灯し、それらレーザ光源 4 4 - 1、4 4 - 2、4 4 - 4 及び 4 4 - 5 から第 1 のレーザ光、第 2 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光を射出させる。

【 0 3 2 5 】

この場合、光源駆動部 4 6 の光量比変更部 7 2 は、第 1 乃至第 3 の光量比を次のように変更する。

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比（第 1 の光量比） = 0 . 5 : 0 . 5、

第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比（第 2 の光量比） = 0 : 1、

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比（第 3 の光量比） = 1 : 0。

【 0 3 2 6 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 1（レーザ 1）は、表層血管 6 8 s（表層領域 7 0 s）に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 1（レーザ 1）から射出される第 1 のレーザ光は、表層血管 6 8 s（表層領域 7 0 s）に対する強調狭帯域光である。この第 1 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 1 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

【 0 3 2 7 】

また、レーザ光源 4 4 - 2（レーザ 2）は、表層血管 6 8 s（表層領域 7 0 s）に対する非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 2（レーザ 2）から射出される第 2 のレーザ光は、表層血管 6 8 s（表層領域 7 0 s）に対する非強調狭帯域光である。この第 2 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 4 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

【 0 3 2 8 】

また、レーザ光源 4 4 - 4（レーザ 4）は、中層血管 6 8 m（中層領域 7 0 m）における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 4（レーザ 4）から射出される第 4 のレーザ光は、中層血管 6 8 m（中層領域 7 0 m）における非強調狭帯域光である。この第 4 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 1 5 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

【 0 3 2 9 】

そして、レーザ光源 4 4 - 5（レーザ 5）は、深層血管 6 8 d（深層領域 7 0 d）に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 5（レーザ 5）から射出される第 5 のレーザ光は、深層血管 6 8 d（深層領域 7 0 d）に対する強調狭帯域光である。この第 5 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 9 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

【 0 3 3 0 】

これら第 1 のレーザ光、第 2 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 から照明光 I L として射出され、観察体 O に照射される。つまり、この観察モード M 1 1（表層-深層血管強調中間モード 2）では、表層血管 6 8 s を強調する第 1 のレーザ光と表層血管 6 8 s を強調しな

10

20

30

40

50

い第2のレーザ光とが共に観察体Oへ照射される。

【0331】

観察体Oにおける照明光ILの反射散乱光RLは、前述したように、撮像部22で検出され、撮像部22からB撮像信号、G撮像信号、及びR撮像信号が画像処理部24へ出力される。画像処理部24は、撮像部22から出力されたB撮像信号、G撮像信号、及びR撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B画像信号、G画像信号、及びR画像信号を生成する。

【0332】

すなわち、表層血管68sにおける照明光ILの反射散乱光RLに対する光強度は、中層血管68mにおける照明光ILの反射散乱光RLに対する光強度よりも、血管周辺部（粘膜部など）における反射散乱光RLに対する光強度との差が大きい。また、深層血管68dにおける照明光ILの反射散乱光RLに対する光強度は、表層血管68sにおける照明光ILの反射散乱光RLに対する光強度よりも、血管周辺部（粘膜部など）における反射散乱光RLに対する光強度との強度差が大きい。

10

【0333】

画像処理部24は、B撮像信号、G撮像信号、R撮像信号のうち、強調狭帯域光のみが含まれる色領域に対応する撮像信号（この場合、R撮像信号）に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の3種の画像処理のうち、少なくとも1つを行う。また、画像処理部24は、B撮像信号、G撮像信号、R撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号（この場合、G撮像信号）に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭（エッジ）抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の3種の画像処理のうち、少なくとも1つを行う。B撮像信号、G撮像信号、R撮像信号のうち、残りの色領域に対応する撮像信号（この場合、B撮像信号）に対しては、特に強調画像処理や抑制画像処理は行わない。

20

【0334】

そして、画像処理部24で生成されたB画像信号、G画像信号、及びR画像信号は、画像表示部16に送信され、図10に示すように、観察体画像80として表示される。すなわち、この観察体画像80では、深層血管68dは、観察モードM3（深層血管強調モード）同様に深層血管画像82dとして強調して表示され、中層血管68mを示す中層血管画像82mについては強調表示されない。

30

【0335】

一方、この観察モードM11（表層-深層血管強調中間モード2）では、表層血管68sを強調する第1のレーザ光と表層血管68sを強調しない第2のレーザ光とが共に観察体Oへ照射される。そのため、結果として、表層血管68sは、第1のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第2のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、表層血管68sを示す表層血管画像82sは、観察モードM3（深層血管強調モード）と観察モードM5（表層-深層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

【0336】

このような、中間レベルの強調状態の画像では、深層血管68dのみ強調された画像、及び、表層血管68sと深層血管68dが強調された画像、よりも奥行き感のある観察体画像80が生成できる。

40

【0337】

なお、第1のレーザ光と第2のレーザ光の光量比（第1の光量比）は、上記観察モードM8（表層-中層血管強調中間モード1）における第3のレーザ光と第4のレーザ光の光量比（第2の光量比）と同様、変更可能なことは勿論である。

【0338】

<観察モードM12（中層-深層血管強調中間モード1）>

ユーザによって、入力部18に観察モードとして、観察モードM12（中層-深層血管強調中間モード1）が入力されると、入力部18から光源駆動部46と画像処理部24へ

50

観察モード M 1 2 ( 中層-深層血管強調中間モード 1 ) の観察モード情報が出力される。

【 0 3 3 9 】

光源駆動部 4 6 は、観察モード M 1 2 ( 中層-深層血管強調中間モード 1 ) の観察モード情報を受け取ると、図 7 及び図 9 に示すように、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 )、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 )、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 )、及びレーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) を点灯し、それらレーザ光源 4 4 - 2、4 4 - 3、4 4 - 5 及び 4 4 - 6 から第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、第 5 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光を出射させる。

【 0 3 4 0 】

この場合、光源駆動部 4 6 の光量比変更部 7 2 は、第 1 乃至第 3 の光量比を次のように変更する。

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比 ( 第 1 の光量比 ) = 0 : 1、

第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比 ( 第 2 の光量比 ) = 1 : 0、

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比 ( 第 3 の光量比 ) = 0 . 5 : 0 . 5。

【 0 3 4 1 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 1 ) から出射される第 2 のレーザ光は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光である。この第 2 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 4 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

【 0 3 4 2 】

また、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) から出射される第 3 のレーザ光は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光である。この第 3 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 4 0 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

【 0 3 4 3 】

また、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) から出射される第 5 のレーザ光は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) に対する強調狭帯域光である。この第 5 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 9 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

【 0 3 4 4 】

そして、レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) から出射される第 6 のレーザ光は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における非強調狭帯域光である。この第 6 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、6 3 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

【 0 3 4 5 】

これら第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、第 5 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 から照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。つまり、この観察モード M 1 2 ( 中層-深層血管強調中間モード 1 ) では、深層血管 6 8 d を強調する第 5 のレーザ光と深層血管 6 8 d を強調しない第 6 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。

【 0 3 4 6 】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、前述したように、撮像部 2 2 で検出され、撮像部 2 2 から B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号が画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号を生成する。

【 0 3 4 7 】

すなわち、深層血管 6 8 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、表

10

20

30

40

50

層血管 6 8 s における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部（粘膜部など）における反射散乱光 R L に対する光強度との差が大きい。また、中層血管 6 8 m における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、深層血管 6 8 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部（粘膜部など）における反射散乱光 R L に対する光強度との強度差が大きい。

【 0 3 4 8 】

画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光のみが含まれる色領域に対応する撮像信号（この場合、G 撮像信号）に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。また、画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号（この場合、B 撮像信号）に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭（エッジ）抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、残りの色領域に対応する撮像信号（この場合、R 撮像信号）に対しては、特に強調画像処理や抑制画像処理は行わない。

10

20

【 0 3 4 9 】

そして、画像処理部 2 4 で生成された B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号は、画像表示部 1 6 に送信され、図 1 0 に示すように、観察体画像 8 0 として表示される。すなわち、この観察体画像 8 0 では、中層血管 6 8 m は、観察モード M 2（中層血管強調モード）同様に中層血管画像 8 2 m として強調して表示され、表層血管 6 8 s を示す表層血管画像 8 2 s については強調表示されない。

【 0 3 5 0 】

一方、この観察モード M 1 2（中層-深層血管強調中間モード 1）では、深層血管 6 8 d を強調する第 5 のレーザ光と深層血管 6 8 d を強調しない第 6 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。そのため、結果として、深層血管 6 8 d は、第 5 のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第 6 のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、深層血管 6 8 d を示す深層血管画像 8 2 d は、観察モード M 2（中層血管強調モード）と観察モード M 6（中層-深層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

30

【 0 3 5 1 】

このような、中間レベルの強調状態の画像では、中層血管 6 8 m のみ強調された画像、及び、中層血管 6 8 m と深層血管 6 8 d が強調された画像、よりも奥行き感のある観察体画像 8 0 が生成できる。

【 0 3 5 2 】

なお、第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比（第 3 の光量比）は、上記観察モード M 8（表層-中層血管強調中間モード 1）における第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比（第 2 の光量比）と同様、変更可能なことは勿論である。

【 0 3 5 3 】

< 観察モード M 1 3（中層-深層血管強調中間モード 2） >

ユーザによって、入力部 1 8 に観察モードとして、観察モード M 1 3（中層-深層血管強調中間モード 2）が入力されると、入力部 1 8 から光源駆動部 4 6 と画像処理部 2 4 へ観察モード M 1 3（中層-深層血管強調中間モード 2）の観察モード情報が出力される。

40

【 0 3 5 4 】

光源駆動部 4 6 は、観察モード M 1 3（中層-深層血管強調中間モード 2）の観察モード情報を受け取ると、図 7 及び図 9 に示すように、レーザ光源 4 4 - 2（レーザ 2）、レーザ光源 4 4 - 3（レーザ 3）、レーザ光源 4 4 - 4（レーザ 4）、及びレーザ光源 4 4 - 5（レーザ 5）を点灯し、それらレーザ光源 4 4 - 2、4 4 - 3、4 4 - 4 及び 4 4 - 5 から第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光を出射させる。

【 0 3 5 5 】

50

この場合、光源駆動部 4 6 の光量比変更部 7 2 は、第 1 乃至第 3 の光量比を次のように変更する。

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比（第 1 の光量比）＝ 0 : 1、

第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比（第 2 の光量比）＝ 0 . 5 : 0 . 5、

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比（第 3 の光量比）＝ 1 : 0。

【 0 3 5 6 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 2（レーザ 2）は、表層血管 6 8 s（表層領域 7 0 s）に対する非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 2（レーザ 2）から出射される第 2 のレーザ光は、表層血管 6 8 s（表層領域 7 0 s）に対する非強調狭帯域光である。この第 2 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 4 5 nm であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

10

【 0 3 5 7 】

また、レーザ光源 4 4 - 3（レーザ 3）は、中層血管 6 8 m（中層領域 7 0 m）における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 3（レーザ 3）から出射される第 3 のレーザ光は、中層血管 6 8 m（中層領域 7 0 m）における強調狭帯域光である。この第 3 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 9 に示すように、5 4 0 nm であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

【 0 3 5 8 】

また、レーザ光源 4 4 - 4（レーザ 4）は、中層血管 6 8 m（中層領域 7 0 m）における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 4（レーザ 4）から出射される第 4 のレーザ光は、中層血管 6 8 m（中層領域 7 0 m）における非強調狭帯域光である。この第 4 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 1 9 に示すように、5 1 5 nm であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

20

【 0 3 5 9 】

そして、レーザ光源 4 4 - 5（レーザ 5）は、深層血管 6 8 d（深層領域 7 0 d）における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 5（レーザ 5）から出射される第 5 のレーザ光は、深層血管 6 8 d（深層領域 7 0 d）における強調狭帯域光である。この第 5 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 9 5 nm であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

【 0 3 6 0 】

これら第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 から照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。つまり、この観察モード M 1 3（中層-深層血管強調中間モード 2）では、中層血管 6 8 m を強調する第 3 のレーザ光と中層血管 6 8 m を強調しない第 4 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。

30

【 0 3 6 1 】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、前述したように、撮像部 2 2 で検出され、撮像部 2 2 から B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号が画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号を生成する。

40

【 0 3 6 2 】

すなわち、中層血管 6 8 m における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、表層血管 6 8 s における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部（粘膜部など）における反射散乱光 R L に対する光強度との差が大きい。また、深層血管 6 8 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、中層血管 6 8 m における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部（粘膜部など）における反射散乱光 R L に対する光強度との強度差が大きい。

【 0 3 6 3 】

画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光のみが含まれる色領域に対応する撮像信号（この場合、R 撮像信号）に対して、コントラスト強

50

調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の３種の画像処理のうち、少なくとも１つを行う。また、画像処理部２４は、Ｂ撮像信号、Ｇ撮像信号、Ｒ撮像信号のうち、強調狭帯域光が含まれない色領域に対応する撮像信号（この場合、Ｂ撮像信号）に対して、コントラスト抑制画像処理と、輪郭（エッジ）抑制画像処理と、血管構造抑制画像処理と、の３種の画像処理のうち、少なくとも１つを行う。Ｂ撮像信号、Ｇ撮像信号、Ｒ撮像信号のうち、残りの色領域に対応する撮像信号（この場合、Ｇ撮像信号）に対しては、特に強調画像処理や抑制画像処理は行わない。

【０３６４】

そして、画像処理部２４で生成されたＢ画像信号、Ｇ画像信号、及びＲ画像信号は、画像表示部１６に送信され、図１０に示すように、観察体画像８０として表示される。すなわち、この観察体画像８０では、深層血管６８ｄは、観察モードＭ３（深層血管強調モード）と同様に深層血管画像８２ｄとして強調して表示され、表層血管６８ｓを示す表層血管画像８２ｓについては強調表示されない。

10

【０３６５】

一方、この観察モードＭ１３（中層-深層血管強調中間モード２）では、中層血管６８ｍを強調する第３のレーザ光と中層血管６８ｍを強調しない第４のレーザ光とが共に観察体Ｏへ照射される。そのため、結果として、中層血管６８ｍは、第３のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第４のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、中層血管６８ｍを示す中層血管画像８２ｍは、観察モードＭ３（深層血管強調モード）と観察モードＭ６（中層-深層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

20

【０３６６】

このような、中間レベルの強調状態の画像では、深層血管６８ｄのみ強調された画像、及び、中層血管６８ｍと深層血管６８ｄが強調された画像、よりも奥行き感のある観察体画像８０が生成できる。

【０３６７】

なお、第３のレーザ光と第４のレーザ光の光量比（第２の光量比）は、上記観察モードＭ８（表層-中層血管強調中間モード１）におけるそれと同様、変更可能なことは勿論である。

【０３６８】

30

< 観察モードＭ１４（表層-中層-深層血管強調中間モード１） >

ユーザによって、入力部１８に観察モードとして、観察モードＭ１４（表層-中層-深層血管強調中間モード１）が入力されると、入力部１８から光源駆動部４６と画像処理部２４へ観察モードＭ１４（表層-中層-深層血管強調中間モード１）の観察モード情報が出力される。

【０３６９】

光源駆動部４６は、観察モードＭ１４（表層-中層-深層血管強調中間モード１）の観察モード情報を受け取ると、図７、図９及び図２１に示すように、レーザ光源４４－１（レーザ１）、レーザ光源４４－３（レーザ３）、レーザ光源４４－４（レーザ４）、レーザ光源４４－５（レーザ５）、及びレーザ光源４４－６（レーザ６）を点灯し、それらレーザ光源４４－１、４４－３、４４－４、４４－５、及び４４－６から第１のレーザ光、第３のレーザ光、第４のレーザ光、第５のレーザ光、及び第６のレーザ光を出射させる。

40

【０３７０】

この場合、光源駆動部４６の光量比変更部７２は、第１乃至第３の光量比を次のように変更する。

第１のレーザ光と第２のレーザ光の光量比（第１の光量比）＝１：０、

第３のレーザ光と第４のレーザ光の光量比（第２の光量比）＝０．５：０．５、

第５のレーザ光と第６のレーザ光の光量比（第３の光量比）＝０．５：０．５。

【０３７１】

ここで、レーザ光源４４－１（レーザ１）は、表層血管６８ｓ（表層領域７０ｓ）に対

50

する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 44 - 1 (レーザ 1) から出射される第 1 のレーザ光は、表層血管 68 s (表層領域 70 s) に対する強調狭帯域光である。この第 1 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 21 に示すように、415 nm であり、青色領域 58 B に含まれる。

【0372】

また、レーザ光源 44 - 3 (レーザ 3) は、中層血管 68 m (中層領域 70 m) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 44 - 3 (レーザ 3) から出射される第 3 のレーザ光は、中層血管 68 m (中層領域 70 m) における強調狭帯域光である。この第 3 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 21 に示すように、540 nm であり、緑色領域 58 G に含まれる。

10

【0373】

また、レーザ光源 44 - 4 (レーザ 4) は、中層血管 68 m (中層領域 70 m) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 44 - 4 (レーザ 4) から出射される第 4 のレーザ光は、中層血管 68 m (中層領域 70 m) における非強調狭帯域光である。この第 4 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 21 に示すように、515 nm であり、緑色領域 58 G に含まれる。

【0374】

また、レーザ光源 44 - 5 (レーザ 5) は、深層血管 68 d (深層領域 70 d) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 44 - 5 (レーザ 5) から出射される第 5 のレーザ光は、深層血管 68 d (深層領域 70 d) における強調狭帯域光である。この第 5 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 21 に示すように、595 nm であり、赤色領域 58 R に含まれる。

20

【0375】

そして、レーザ光源 44 - 6 (レーザ 6) は、深層血管 68 d (深層領域 70 d) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 44 - 6 (レーザ 6) から出射される第 6 のレーザ光は、深層血管 68 d (深層領域 70 d) における非強調狭帯域光である。この第 6 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 21 に示すように、635 nm であり、赤色領域 58 R に含まれる。

【0376】

これら第 1 のレーザ光、第 3 のレーザ光、第 4 のレーザ光、第 5 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 26 の先端の光変換部 54 から照明光 IL として出射され、観察体 O に照射される。つまり、この観察モード M14 (表層 - 中層 - 深層血管強調中間モード 1) では、中層血管 68 m を強調する第 3 のレーザ光と中層血管 68 m を強調しない第 4 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射されると共に、深層血管 68 d を強調する第 5 のレーザ光と深層血管 68 d を強調しない第 6 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。

30

【0377】

観察体 O における照明光 IL の反射散乱光 RL は、前述したように、撮像部 22 で検出され、撮像部 22 から B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号が画像処理部 24 へ出力される。画像処理部 24 は、撮像部 22 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号を生成する。

40

【0378】

すなわち、表層血管 68 s における照明光 IL の反射散乱光 RL に対する光強度は、中層血管 68 m 及び深層血管 68 d における照明光 IL の反射散乱光 RL に対する光強度よりも、血管周辺部 (粘膜部など) における反射散乱光 RL に対する光強度との差が大きい。

【0379】

画像処理部 24 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光のみが含まれる色領域に対応する撮像信号 (この場合、B 撮像信号) に対して、コントラスト強

50

調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の３種の画像処理のうち、少なくとも１つを行う。その他の色領域に対応する撮像信号（この場合、G撮像信号及びR撮像信号）に対しては、特に強調画像処理や抑制画像処理は行わない。

【0380】

そして、画像処理部24で生成されたB画像信号、G画像信号、及びR画像信号は、画像表示部16に送信され、図10及び図22に示すように、観察体画像80として表示される。すなわち、この観察体画像80では、表層血管68sは、観察モードM1（表層血管強調モード）と同様に表層血管画像82sとして強調して表示される。

【0381】

一方、この観察モードM14（表層-中層-深層血管強調中間モード1）では、中層血管68mを強調する第3のレーザ光と中層血管68mを強調しない第4のレーザ光とが共に観察体Oへ照射される。そのため、結果として、中層血管68mは、第3のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第4のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、中層血管68mを示す中層血管画像82mは、観察モードM1（表層血管強調モード）と観察モードM4（表層-中層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

10

【0382】

また、深層血管68dを強調する第5のレーザ光と深層血管68dを強調しない第6のレーザ光とが共に観察体Oへ照射される。そのため、結果として、深層血管68dは、第5のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第6のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、深層血管68dを示す深層血管画像82dは、観察モードM1（表層血管強調モード）と観察モードM5（表層-深層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

20

【0383】

このような、中間レベルの強調状態の画像では、表層血管68sのみ強調された画像、表層血管68sと中層血管68mが強調された画像、及び、表層血管68sと深層血管68dが強調された画像、よりも奥行き感のある観察体画像80が生成できる。

【0384】

なお、第3のレーザ光と第4のレーザ光の光量比（第2の光量比）は、上記観察モードM8（表層-中層血管強調中間モード1）におけるそれと同様、変更可能なことは勿論である。

30

【0385】

また、第5のレーザ光と第6のレーザ光の光量比（第3の光量比）についても、上記観察モードM8（表層-中層血管強調中間モード1）における第3のレーザ光と第4のレーザ光の光量比（第2の光量比）と同様、変更可能なことは勿論である。

【0386】

<観察モードM15（表層-中層-深層血管強調中間モード2）>

ユーザによって、入力部18に観察モードとして、観察モードM15（表層-中層-深層血管強調中間モード2）が入力されると、入力部18から光源駆動部46と画像処理部24へ観察モードM15（表層-中層-深層血管強調中間モード2）の観察モード情報が出力される。

40

【0387】

光源駆動部46は、観察モードM15（表層-中層-深層血管強調中間モード2）の観察モード情報を受け取ると、図7及び図9に示すように、レーザ光源44-1（レーザ1）、レーザ光源44-2（レーザ2）、レーザ光源44-3（レーザ3）、レーザ光源44-5（レーザ5）、及びレーザ光源44-6（レーザ6）を点灯し、それらレーザ光源44-1、44-2、44-3、44-5、及び44-6から第1のレーザ光、第2のレーザ光、第3のレーザ光、第5のレーザ光、及び第6のレーザ光を出射させる。

【0388】

この場合、光源駆動部46の光量比変更部72は、第1乃至第3の光量比を次のように

50

変更する。

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比 (第 1 の光量比) = 0 . 5 : 0 . 5 、

第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比 (第 2 の光量比) = 1 : 0 、

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比 (第 3 の光量比) = 0 . 5 : 0 . 5 。

【 0 3 8 9 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 1 (レーザ 1) は、表層血管 6 8 s (表層領域 7 0 s) に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 1 (レーザ 1) から出射される第 1 のレーザ光は、表層血管 6 8 s (表層領域 7 0 s) に対する強調狭帯域光である。この第 1 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 1 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

【 0 3 9 0 】

また、レーザ光源 4 4 - 2 (レーザ 2) は、表層血管 6 8 s (表層領域 7 0 s) に対する非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 2 (レーザ 2) から出射される第 2 のレーザ光は、表層血管 6 8 s (表層領域 7 0 s) に対する非強調狭帯域光である。この第 2 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 4 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

【 0 3 9 1 】

また、レーザ光源 4 4 - 3 (レーザ 3) は、中層血管 6 8 m (中層領域 7 0 m) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 3 (レーザ 3) から出射される第 3 のレーザ光は、中層血管 6 8 m (中層領域 7 0 m) における強調狭帯域光である。この第 3 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 4 0 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

【 0 3 9 2 】

また、レーザ光源 4 4 - 5 (レーザ 5) は、深層血管 6 8 d (深層領域 7 0 d) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 5 (レーザ 5) から出射される第 5 のレーザ光は、深層血管 6 8 d (深層領域 7 0 d) における強調狭帯域光である。この第 5 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 9 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

【 0 3 9 3 】

そして、レーザ光源 4 4 - 6 (レーザ 6) は、深層血管 6 8 d (深層領域 7 0 d) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 6 (レーザ 6) から出射される第 6 のレーザ光は、深層血管 6 8 d (深層領域 7 0 d) における非強調狭帯域光である。この第 6 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、6 3 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

【 0 3 9 4 】

これら第 1 のレーザ光、第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、第 5 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 から照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。つまり、この観察モード M 1 5 (表層 - 中層 - 深層血管強調中間モード 2) では、表層血管 6 8 s を強調する第 1 のレーザ光と表層血管 6 8 s を強調しない第 2 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射されると共に、深層血管 6 8 d を強調する第 5 のレーザ光と深層血管 6 8 d を強調しない第 6 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。

【 0 3 9 5 】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、前述したように、撮像部 2 2 で検出され、撮像部 2 2 から B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号が画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号を生成する。

【 0 3 9 6 】

すなわち、中層血管 6 8 m における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、表層血管 6 8 s 及び深層血管 6 8 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部 (粘膜部など) における反射散乱光 R L に対する光強度との差が大きい。

【 0 3 9 7 】

10

20

30

40

50

画像処理部 24 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光のみが含まれる色領域に対応する撮像信号（この場合、G 撮像信号）に対して、コントラスト強調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の 3 種の画像処理のうち、少なくとも 1 つを行う。その他の色領域に対応する撮像信号（この場合、B 撮像信号及び R 撮像信号）に対しては、特に強調画像処理や抑制画像処理は行わない。

【0398】

そして、画像処理部 24 で生成された B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号は、画像表示部 16 に送信され、図 10 に示すように、観察体画像 80 として表示される。すなわち、この観察体画像 80 では、中層血管 68m は、観察モード M2（中層血管強調モード）と同様に中層血管画像 82m として強調して表示される。

10

【0399】

一方、この観察モード M15（表層-中層-深層血管強調中間モード 2）では、表層血管 68s を強調する第 1 のレーザ光と表層血管 68s を強調しない第 2 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。そのため、結果として、表層血管 68s は、第 1 のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第 2 のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、表層血管 68s を示す表層血管画像 82s は、観察モード M2（中層血管強調モード）と観察モード M4（表層-中層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

【0400】

また、深層血管 68d を強調する第 5 のレーザ光と深層血管 68d を強調しない第 6 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。そのため、結果として、深層血管 68d は、第 5 のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第 6 のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、深層血管 68d を示す深層血管画像 82d は、観察モード M2（中層血管強調モード）と観察モード M6（中層-深層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

20

【0401】

このような、中間レベルの強調状態の画像では、中層血管 68m のみ強調された画像、表層血管 68s と中層血管 68m が強調された画像、及び、中層血管 68m と深層血管 68d が強調された画像、よりも奥行き感のある観察体画像 80 が生成できる。

【0402】

なお、第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比（第 1 の光量比）、及び、第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比（第 3 の光量比）は、上記観察モード M8（表層-中層血管強調中間モード 1）における第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比（第 2 の光量比）と同様、変更可能なことは勿論である。

30

【0403】

< 観察モード M16（表層-中層-深層血管強調中間モード 3） >

ユーザによって、入力部 18 に観察モードとして、観察モード M16（表層-中層-深層血管強調中間モード 3）が入力されると、入力部 18 から光源駆動部 46 と画像処理部 24 へ観察モード M16（表層-中層-深層血管強調中間モード 3）の観察モード情報が出力される。

40

【0404】

光源駆動部 46 は、観察モード M16（表層-中層-深層血管強調中間モード 3）の観察モード情報を受け取ると、図 7 及び図 9 に示すように、レーザ光源 44-1（レーザ 1）、レーザ光源 44-2（レーザ 2）、レーザ光源 44-3（レーザ 3）、レーザ光源 44-4（レーザ 4）、及びレーザ光源 44-5（レーザ 5）を点灯し、それらレーザ光源 44-1、44-2、44-3、44-4、及び 44-5 から第 1 のレーザ光、第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光を出射させる。

【0405】

この場合、光源駆動部 46 の光量比変更部 72 は、第 1 乃至第 3 の光量比を次のように変更する。

50

第 1 のレーザ光と第 2 のレーザ光の光量比 ( 第 1 の光量比 ) = 0 . 5 : 0 . 5 、  
第 3 のレーザ光と第 4 のレーザ光の光量比 ( 第 2 の光量比 ) = 0 . 5 : 0 . 5 、  
第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比 ( 第 3 の光量比 ) = 1 : 0 。

【 0 4 0 6 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 ) は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 ) から出射される第 1 のレーザ光は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する強調狭帯域光である。この第 1 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 1 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

【 0 4 0 7 】

また、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) から出射される第 2 のレーザ光は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光である。この第 2 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、4 4 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

【 0 4 0 8 】

また、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) から出射される第 3 のレーザ光は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光である。この第 3 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 4 0 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

【 0 4 0 9 】

また、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 ) は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 ) から出射される第 4 のレーザ光は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における非強調狭帯域光である。この第 4 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 1 5 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

【 0 4 1 0 】

そして、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) から出射される第 5 のレーザ光は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における強調狭帯域光である。この第 5 のレーザ光の波長は、図 9 に示すように、5 9 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

【 0 4 1 1 】

これら第 1 のレーザ光、第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、第 4 のレーザ光、及び第 5 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 から照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。つまり、この観察モード M 1 6 ( 表層 - 中層 - 深層血管強調中間モード 3 ) では、表層血管 6 8 s を強調する第 1 のレーザ光と表層血管 6 8 s を強調しない第 2 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射されると共に、中層血管 6 8 m を強調する第 3 のレーザ光と中層血管 6 8 m を強調しない第 4 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。

【 0 4 1 2 】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、前述したように、撮像部 2 2 で検出され、撮像部 2 2 から B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号が画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B 画像信号、G 画像信号、及び R 画像信号を生成する。

【 0 4 1 3 】

すなわち、深層血管 6 8 d における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度は、表層血管 6 8 s 及び中層血管 6 8 m における照明光 I L の反射散乱光 R L に対する光強度よりも、血管周辺部 ( 粘膜部など ) における反射散乱光 R L に対する光強度との差が大きい。

【 0 4 1 4 】

画像処理部 2 4 は、B 撮像信号、G 撮像信号、R 撮像信号のうち、強調狭帯域光のみが含まれる色領域に対応する撮像信号 ( この場合、R 撮像信号 ) に対して、コントラスト強

10

20

30

40

50

調画像処理と、輪郭（エッジ）強調画像処理と、血管構造画像処理と、の３種の画像処理のうち、少なくとも１つを行う。その他の色領域に対応する撮像信号（この場合、Ｂ撮像信号及びＧ撮像信号）に対しては、特に強調画像処理や抑制画像処理は行わない。

【０４１５】

そして、画像処理部２４で生成されたＢ画像信号、Ｇ画像信号、及びＲ画像信号は、画像表示部１６に送信され、図１０に示すように、観察体画像８０として表示される。すなわち、この観察体画像８０では、深層血管６８ｄは、観察モードＭ３（深層血管強調モード）と同様に深層血管画像８２ｄとして強調して表示される。

【０４１６】

一方、この観察モードＭ１６（表層-中層-深層血管強調中間モード３）では、表層血管６８ｓを強調する第１のレーザ光と表層血管６８ｓを強調しない第２のレーザ光とが共に観察体Ｏへ照射される。そのため、結果として、表層血管６８ｓは、第１のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第２のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、表層血管６８ｓを示す表層血管画像８２ｓは、観察モードＭ３（深層血管強調モード）と観察モードＭ５（表層-深層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

10

【０４１７】

また、中層血管６８ｍを強調する第３のレーザ光と中層血管６８ｍを強調しない第４のレーザ光とが共に観察体Ｏへ照射される。そのため、結果として、中層血管６８ｍは、第３のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第４のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、中層血管６８ｍを示す中層血管画像８２ｍは、観察モードＭ３（深層血管強調モード）と観察モードＭ６（中層-深層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

20

【０４１８】

このような、中間レベルの強調状態の画像では、深層血管６８ｄのみ強調された画像、表層血管６８ｓと深層血管６８ｄが強調された画像、及び、中層血管６８ｍと深層血管６８ｄが強調された画像、よりも奥行き感のある観察体画像８０が生成できる。

【０４１９】

なお、第１のレーザ光と第２のレーザ光の光量比（第１の光量比）、及び、第３のレーザ光と第４のレーザ光の光量比（第２の光量比）は、上記観察モードＭ８（表層-中層血管強調中間モード１）における第３のレーザ光と第４のレーザ光の光量比（第２の光量比）と同様、変更可能なことは勿論である。

30

【０４２０】

< 観察モードＭ１７（通常観察モード） >

ユーザによって、入力部１８に観察モードとして、観察モードＭ１７（通常観察モード）が入力されると、入力部１８から光源駆動部４６と画像処理部２４へ観察モードＭ１７（通常観察モード）の観察モード情報が出力される。

【０４２１】

光源駆動部４６は、観察モードＭ３（深層血管強調モード）の観察モード情報を受け取ると、図７、図９及び図２３に示すように、レーザ光源４４-１（レーザ１）、レーザ光源４４-２（レーザ２）、レーザ光源４４-３（レーザ３）、レーザ光源４４-４（レーザ４）、レーザ光源４４-５（レーザ５）、及びレーザ光源４４-６（レーザ６）のすべてを点灯し、それらレーザ光源４４-１～４４-６から第１のレーザ光、第２のレーザ光、第３のレーザ光、第４のレーザ光、第５のレーザ光、及び乃至第６のレーザ光を出射させる。

40

【０４２２】

この場合、光源駆動部４６の光量比変更部７２は、第１乃至第３の光量比を次のように変更する。

第１のレーザ光と第２のレーザ光の光量比（第１の光量比）＝０．５：０．５、

第３のレーザ光と第４のレーザ光の光量比（第２の光量比）＝０．５：０．５、

50

第 5 のレーザ光と第 6 のレーザ光の光量比 ( 第 3 の光量比 ) = 0 . 5 : 0 . 5 。

【 0 4 2 3 】

ここで、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 ) は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 1 ( レーザ 1 ) から出射される第 1 のレーザ光は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する強調狭帯域光である。この第 1 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 2 3 に示すように、4 1 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

【 0 4 2 4 】

また、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 2 ( レーザ 2 ) から出射される第 2 のレーザ光は、表層血管 6 8 s ( 表層領域 7 0 s ) に対する非強調狭帯域光である。この第 2 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 2 3 に示すように、4 4 5 n m であり、青色領域 5 8 B に含まれる。

10

【 0 4 2 5 】

また、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 3 ( レーザ 3 ) から出射される第 3 のレーザ光は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における強調狭帯域光である。この第 3 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 2 3 に示すように、5 4 0 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

【 0 4 2 6 】

20

また、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 ) は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 4 ( レーザ 4 ) から出射される第 4 のレーザ光は、中層血管 6 8 m ( 中層領域 7 0 m ) における非強調狭帯域光である。この第 4 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 2 3 に示すように、5 1 5 n m であり、緑色領域 5 8 G に含まれる。

【 0 4 2 7 】

また、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 5 ( レーザ 5 ) から出射される第 5 のレーザ光は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における強調狭帯域光である。この第 5 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 2 3 に示すように、5 9 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

30

【 0 4 2 8 】

そして、レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における非強調狭帯域光源であり、レーザ光源 4 4 - 6 ( レーザ 6 ) から出射される第 6 のレーザ光は、深層血管 6 8 d ( 深層領域 7 0 d ) における非強調狭帯域光である。この第 6 のレーザ光の波長は、図 9 及び図 2 3 に示すように、6 3 5 n m であり、赤色領域 5 8 R に含まれる。

【 0 4 2 9 】

これら第 1 のレーザ光、第 2 のレーザ光、第 3 のレーザ光、第 4 のレーザ光、第 5 のレーザ光、及び第 6 のレーザ光は、前述したように、合波されて、挿入部 2 6 の先端の光変換部 5 4 から照明光 I L として出射され、観察体 O に照射される。つまり、この観察モード M 1 7 ( 通常観察モード ) では、表層血管 6 8 s を強調する第 1 のレーザ光と表層血管 6 8 s を強調しない第 2 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射され、中層血管 6 8 m を強調する第 3 のレーザ光と中層血管 6 8 m を強調しない第 4 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射され、深層血管 6 8 d を強調する第 5 のレーザ光と深層血管 6 8 d を強調しない第 6 のレーザ光とが共に観察体 O へ照射される。

40

【 0 4 3 0 】

観察体 O における照明光 I L の反射散乱光 R L は、前述したように、撮像部 2 2 で検出され、撮像部 2 2 から B 撮像信号、G 撮像信号、及び R 撮像信号が画像処理部 2 4 へ出力される。画像処理部 2 4 は、撮像部 2 2 から出力された B 撮像信号、G 撮像信号、及び R

50

撮像信号に対して、観察モード情報に応じた画像処理を行い、B画像信号、G画像信号、及びR画像信号を生成する。

【0431】

そして、画像処理部24で生成されたB画像信号、G画像信号、及びR画像信号は、画像表示部16に送信され、図10及び図24に示すように、観察体画像80として表示される。

【0432】

すなわち、この観察モードM17（通常観察モード）では、表層血管68sを強調する第1のレーザ光と表層血管68sを強調しない第2のレーザ光とが共に観察体Oへ照射される。そのため、結果として、表層血管68sは、第1のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第2のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、表層血管68sを示す表層血管画像82sは、観察モードM1（表層血管強調モード）と観察モードM6（中層-深層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

10

【0433】

また、中層血管68mを強調する第3のレーザ光と中層血管68mを強調しない第4のレーザ光とが共に観察体Oへ照射される。そのため、結果として、中層血管68mは、第3のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第4のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、中層血管68mを示す中層血管画像82mは、観察モードM2（中層血管強調モード）と観察モードM5（表層-深層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

20

【0434】

そして、深層血管68dを強調する第5のレーザ光と深層血管68dを強調しない第6のレーザ光とが共に観察体Oへ照射される。そのため、結果として、深層血管68dは、第5のレーザ光のみが照射されて強調された状態と、第6のレーザ光のみが照射されて強調されていない状態と、の中間のレベルで強調される。すなわち、深層血管68dを示す深層血管画像82dは、観察モードM3（深層血管強調モード）と観察モードM4（表層-中層血管強調モード）との中間レベルに強調して表示される。

【0435】

この観察モードM17（通常観察モード）においては、演色性または色再現性の高い照明光ILとなるように、レーザ光源44-1～44-6の光量比が設定される。したがって、第1のレーザ光と第2のレーザ光の光量比（第1の光量比）、第3のレーザ光と第4のレーザ光の光量比（第2の光量比）及び、第5のレーザ光と第6のレーザ光の光量比（第3の光量比）は、上記のような0.5：0.5に限るものではない。例えば、キセノンランプやハロゲンランプのような広帯域な照明光ILの色を再現する。または、キセノンランプやハロゲンランプのような広帯域な照明光ILに照射されたときの観察体Oの色を再現する。

30

【0436】

観察モードM17（通常観察モード）においては、演色性または色再現性を高めるために、血管強調モードに対して、点灯するレーザ光源の数が多い。

40

【0437】

以上のように、本発明の一実施形態に係る内視鏡装置10は、複数の狭帯域光源を有し、互いにピーク波長または中心波長の異なる複数の狭帯域光を含む照明光ILを出射する照明部20を備える内視鏡装置10であって、複数の狭帯域光源は、観察体Oに存在する診断対象物質の光吸収スペクトルに対して、少なくとも1つの極大値をとる少なくとも1つの極大波長、及び、青色領域58B、緑色領域58G、及び赤色領域58Rの3つの色領域のうち何れかの色領域における光吸収スペクトルの最大値である色領域最大値をとる色領域最大波長、の少なくとも一方を1つ含む強調波長領域に、ピーク波長または中心波長が含まれる第1の強調狭帯域光を出射する第1の強調狭帯域光源と、青色領域58B、緑色領域58G、及び赤色領域58Rの強調波長領域を含まない波長領域である非強調波

50

長領域に、ピーク波長または中心波長が含まれる第 1 の非強調狭帯域光を出射する第 1 の非強調狭帯域光源と、を少なくとも有し、照明部 20 は、複数の狭帯域光に含まれる第 1 の強調狭帯域光と第 1 の非強調狭帯域光との光量比である第 1 の光量比を変更する光量比変更部 72 を更に有する。

このように、第 1 の強調狭帯域光と第 1 の非強調狭帯域光との光量比である第 1 の光量比を変更することで、第 1 の強調狭帯域光により強調される診断対象物質の強調度合いが変更されるので、特定の深さ領域における、診断対象物質の相対的な強調の度合いを変更可能となる。

#### 【0438】

ここで、第 1 の強調狭帯域光及び第 1 の非強調狭帯域光は、それぞれ、第 1 の深さ領域まで侵達長を有し、第 1 の深さ領域は、観察体 0 に対する表層領域 70 s、中層領域 70 m、及び深層領域 70 d の 3 つの深さ領域の何れかである。

従って、観察体 0 に対する表層領域 70 s、中層領域 70 m、または深層領域 70 d における、診断対象物質の相対的な強調の度合いを変更可能となる。

#### 【0439】

この場合、表層領域 70 s まで侵達長を有する狭帯域光は、青色領域 58 B に含まれ、中層領域 70 m まで侵達長を有する狭帯域光は、緑色領域 58 G に含まれ、深層領域 70 d まで侵達長を有する狭帯域光は、赤色領域 58 R に含まれ、第 1 の強調狭帯域光及び第 1 の非強調狭帯域光は、それぞれ、それら 3 つの色領域の何れかである第 1 の色領域に含まれる。

このように、深さ領域と色領域とには相関がある。

#### 【0440】

なお、光量比変更部 72 は、照明光 IL において、第 1 の色領域の光量が一定となるように、第 1 の光量比を変更する。

従って、光量比変更により照明光 IL の色が変化しない。

#### 【0441】

また、複数の狭帯域光源は、更に、第 2 の強調狭帯域光を出射する第 2 の強調狭帯域光源と、第 2 の非強調狭帯域光を出射する第 2 の非強調狭帯域光源と、のどちらか一方を少なくとも有し、照明光 IL における複数の狭帯域光は、第 2 の強調狭帯域光と第 2 の非強調狭帯域光のどちらか一方を少なくとも含み、第 2 の強調狭帯域光と第 2 の非強調狭帯域光は、上記 3 つの深さ領域の何れかであり、且つ、第 1 の深さ領域とは異なる第 2 の深さ領域まで侵達長を有し、また、上記 3 つの色領域の何れかであり、且つ、第 1 の色領域とは異なる第 2 の色領域に含まれる。

このように、第 2 の色領域に含まれ、第 2 の深さ領域まで侵達する第 2 の強調狭帯域光を有することで、2 つの深さ領域の中間の強調状態の画像が生成可能となる。また、第 2 の色領域に含まれ、第 2 の深さ領域まで侵達する第 2 の非強調狭帯域光を有することで、色再現性を向上することが可能となる。

#### 【0442】

またこの場合、複数の狭帯域光源は、第 2 の強調狭帯域光源と第 2 の非強調狭帯域光源の両方を有し、光量比変更部 72 は、第 1 の光量比に加えて、第 2 の強調狭帯域光と第 2 の非強調狭帯域光との光量比である第 2 の光量比を変更する。

このように、第 1 の光量比に加え、第 2 の強調狭帯域光と第 2 の非強調狭帯域光の光量比（第 2 の光量比）を変更することで、第 2 の深さ領域の血管強調の度合いを第 2 の光量比で変更することが可能となる。従って、例えば血管に対しては、表層血管 68 s と深層血管 68 d が強調された画像以外に、表層血管 68 s のみ強調された画像、深層血管 68 d のみ強調された画像、及びそれらの中間の強調状態の画像を生成可能となる。また、中間の強調状態の画像では、表層血管 68 s と深層血管 68 d とが強調された画像、表層血管 68 s のみ強調された画像、及び深層血管 68 d のみ強調された画像、よりも奥行き感のある観察体画像 80 が生成できる。

#### 【0443】

なおこの場合、光量比変更部 7 2 は、照明光 I L において、第 2 の色領域の光量が一定となるように、第 2 の光量比を変更することが望ましい。

このように、第 2 の色領域における光量が一定となるように第 2 の光量比を変更することで、光量比変更により照明光 I L の色が変化しないようにすることができる。

【 0 4 4 4 】

またさらに、複数の狭帯域光源は、更に、第 3 の強調狭帯域光を出射する第 3 の強調狭帯域光源と、第 3 の非強調狭帯域光を出射する第 3 の非強調狭帯域光源と、のどちらか一方を少なくとも有し、照明光 I L における複数の狭帯域光は、第 3 の強調狭帯域光と第 3 の非強調狭帯域光のどちらか一方を少なくとも含み、第 3 の強調狭帯域光と第 3 の非強調狭帯域光は、上記 3 つの深さ領域の何れかであり、且つ、第 1 の深さ領域及び第 2 の深さ領域とは異なる第 3 の深さ領域まで侵達長を有し、また、上記 3 つの色領域の何れかであり、且つ、第 1 の色領域及び第 2 の色領域とは異なる第 3 の色領域に含まれる。

10

このように、第 3 の色領域に含まれ、第 3 の深さ領域まで侵達する第 3 の強調狭帯域光を有することで、3 つの深さ領域の中間の強調状態の画像が生成可能となる。また、第 3 の色領域に含まれ、第 3 の深さ領域まで侵達する第 3 の非強調狭帯域光を有することで、色再現性を向上することが可能となる。

【 0 4 4 5 】

またこの場合、複数の狭帯域光源は、第 3 の強調狭帯域光源と第 3 の非強調狭帯域光源の両方を有し、光量比変更部 7 2 は、第 1 の光量比と第 2 の光量比に加えて、第 3 の強調狭帯域光と第 3 の非強調狭帯域光との光量比である第 3 の光量比を変更する。

20

このように、第 1 及び第 2 の光量比に加え、第 3 の強調狭帯域光と第 3 の非強調狭帯域光の光量比（第 3 の光量比）を変更することで、第 3 の深さ領域の血管強調の度合いを第 3 の光量比で変更することが可能となる。

【 0 4 4 6 】

なおこの場合、光量比変更部 7 2 は、照明光 I L において、第 3 の色領域の光量が一定となるように、第 3 の光量比を変更することが望ましい。

このように、第 3 の色領域における光量が一定となるように第 3 の光量比を変更することで、光量比変更により照明光 I L の色が変化しないようにすることができる。

【 0 4 4 7 】

また、照明光 I L において、青色領域 5 8 B の光量と、緑色領域 5 8 G の光量と、赤色領域 5 8 R の光量と、の比率を色領域間光量比としたとき、光量比変更部 7 2 は、複数の狭帯域光源を、色領域間光量比が一定となるように制御する。

30

このように、複数の狭帯域光源を、色領域間光量比が一定となるように制御することで、光量比を変えても照明光 I L の色が変化しないようにすることができる。なお、強調狭帯域光でも非強調狭帯域光でもない狭帯域光がある場合は、それも含めて一定とする。

【 0 4 4 8 】

この場合、色領域間光量比は、照明光 I L が白色となる光量比である。

このように、色領域間光量比を照明光 I L が白色となる光量比とすることで、色再現よく観察が可能となる。

【 0 4 4 9 】

40

また、光量比変更部 7 2 は、第 1 の強調狭帯域光源と第 1 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせである第 1 の点灯組み合わせ（第 1 の強調狭帯域光源のみ点灯、第 1 の非強調狭帯域光源のみ点灯、両方点灯）を切り替える。

このように、第 1 の強調狭帯域光源と第 1 の非強調狭帯域光源の点灯の組み合わせ（第 1 の点灯組み合わせ）を変更することで、第 1 の光量比を変更することができる。

【 0 4 5 0 】

また、光量比変更部 7 2 は、第 1 の強調狭帯域光源と第 1 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせである第 1 の点灯組み合わせ（第 1 の強調狭帯域光源のみ点灯、第 1 の非強調狭帯域光源のみ点灯、両方点灯）と、第 2 の強調狭帯域光源と第 2 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせである第 2 の点灯組み合わせ（第 2 の強調狭帯域光源のみ点灯、第

50

2 の非強調狭帯域光源のみ点灯、両方点灯) と、を切り替える。

このように、第 1 の強調狭帯域光源と第 1 の非強調狭帯域光源の点灯の組み合わせ (第 1 の点灯組み合わせ) と第 2 の強調狭帯域光源と第 2 の非強調狭帯域光源の点灯の組み合わせ (第 2 の点灯組み合わせ) とを変更することで、第 1 及び第 2 の光量比を変更することができる。

【0451】

また、光量比変更部 72 は、第 1 の強調狭帯域光源と第 1 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせである第 1 の点灯組み合わせ (第 1 の強調狭帯域光源のみ点灯、第 1 の非強調狭帯域光源のみ点灯、両方点灯) と、第 2 の強調狭帯域光源と前記第 2 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせである第 2 の点灯組み合わせ (第 2 の強調狭帯域光源のみ点灯、第 2 の非強調狭帯域光源のみ点灯、両方点灯) と、第 3 の強調狭帯域光源と第 3 の非強調狭帯域光源との点灯の組み合わせである第 3 の点灯組み合わせ (第 3 の強調狭帯域光源のみ点灯、第 3 の非強調狭帯域光源のみ点灯、両方点灯) と、を切り替える。

10

このように、第 1 の強調狭帯域光源と第 1 の非強調狭帯域光源の点灯の組み合わせ (第 1 の点灯組み合わせ)、第 2 の強調狭帯域光源と第 2 の非強調狭帯域光源の点灯の組み合わせ (第 2 の点灯組み合わせ)、及び第 3 の強調狭帯域光源と第 3 の非強調狭帯域光源の点灯の組み合わせ (第 3 の点灯組み合わせ) を変更することで、第 1、第 2 及び第 3 の光量比を変更することができる。

【0452】

なお、強調波長領域は、極大波長及び色領域最大波長の少なくとも一方に対して、 $\pm 20 \text{ nm}$  以内の波長領域である。

20

強調波長領域がこのような波長領域であると、光吸収が大きいため、好ましい。

【0453】

あるいは、強調波長領域は、極大値または色領域最大値が存在する色領域であって、極大値または色領域最大値に対して  $1/2$  以上の値を有する波長領域であっても良い。

強調波長領域がこのような波長領域であると、吸収が大きいため、好ましい。

【0454】

また、非強調波長領域は、診断対象物質の光吸収スペクトルに対して、極小値をとる少なくとも 1 つの極小波長、及び、3 つの色領域のうち何れかの色領域における最小値である色領域最小値をとる色領域最小波長、の少なくとも一方を 1 つ含む。

30

非強調波長領域がこのような波長領域であると、吸収が小さいため、好ましい。

【0455】

この場合、非強調波長領域は、極小波長及び色領域最小波長の少なくとも一方に対して、 $\pm 20 \text{ nm}$  以内の波長領域である。

非強調波長領域がこのような波長領域であると、光吸収が小さいため、好ましい。

【0456】

あるいは、非強調波長領域は、極小値または色領域最小値が存在する色領域であって、極小値及び色領域最小値の少なくとも一方に対して  $1.5$  倍以下の値を有する波長領域であっても良い。

非強調波長領域がこのような波長領域であると、吸収が小さいため、好ましい。

40

【0457】

また、非強調波長領域は、極大値または色領域最大値が存在する色領域であって、極大値及び色領域最大値の少なくとも一方に対して、 $1/2$  以下の値をとる波長領域であっても良い。

非強調波長領域がこのような波長領域であると、吸収が小さいため、好ましい。

【0458】

なお、観察体 O は、生体組織であり、診断対象物質は、観察体 O に含まれるヘモグロビンである。

これにより、生体組織に存在する血管を強調することができる。

【0459】

50

この場合、少なくとも1つの強調狭帯域光のピーク波長は、395乃至435nmの波長領域に含まれる。

これにより、表層血管68sを強調することができる。

【0460】

あるいは、少なくとも1つの強調狭帯域光のピーク波長は、520乃至560nmまたは560乃至595nmの波長領域のどちらか一方に含まれていても良い。

これにより、中層血管68mまたは深層血管68dを強調することができる。

【0461】

また、複数の狭帯域光は、波長幅が50nm以下の狭帯域光である。

これにより、複数の狭帯域光源としてLEDを用いることが可能となる。

10

【0462】

あるいは、複数の狭帯域光は、波長幅が5nm以下の超狭帯域光であっても良い。

これにより、複数の狭帯域光源としてレーザ光源を用いることが可能となる。

【0463】

なお、青色領域58Bは、380乃至510nmの波長領域であり、緑色領域58Gは、490乃至610nmの波長領域であり、赤色領域58Rは、590乃至780nmの波長領域である。

このような波長設定とすることで、色再現性の良い照明光ILを生成することが可能となる。

【0464】

20

また、内視鏡装置10は、用途に応じた複数の観察モードのうちの1つを入力する入力部18を更に有し、光量比変更部72は、入力部18に入力された観察モードに基づいて、第1の光量比を変更する。

したがって、観察モード入力に基づいて光量比を変更することができる。

【0465】

また、内視鏡装置10は、観察体Oに照射された照明光ILの反射散乱光RLを検出して撮像信号を出力する撮像部22と、撮像信号から画像信号を生成する画像処理部24と、を更に備える。

従って、例えば第1の強調狭帯域光と第1の非強調狭帯域光との光量比である第1の光量比を変更することで、第1の強調狭帯域光により強調される診断対象物質の強調度合いが変更されるので、特定の深さ領域における、診断対象物質の相対的な強調の度合いを変更可能となる。

30

【0466】

[変形例1]

観察モードM1(表層血管強調モード)における照明光スペクトルの変形例を図25乃至図27に示す。

【0467】

中層血管68mに対する非強調狭帯域光である第4のレーザ光の波長は、515nmではなくて、図25に示すように、560nm(緑色領域58Gにおける極小値)でも良い。

40

【0468】

また、照明光ILに含まれる強調狭帯域光と非強調狭帯域光の数が、合わせて4つ以上でも良い。このように狭帯域光の数を4つ以上とした場合、照明光ILの演色性及び色再現性がより良くなる。この場合、図26に示すように、同じ色領域に2つ以上の非強調狭帯域光が含まれていて良い。また、図27に示すように、同じ色領域(観察モードM1(表層血管強調モード)においては青色領域58B)に2つ以上の強調狭帯域光が含まれていても良い。

【0469】

観察モードM1(表層血管強調モード)以外の強調モードについても、同様である。

【0470】

50

## [ 変形例 2 ]

また、複数の観察モードに対応するレーザ光源の組み合わせを順次切り替えることで、画像表示部 16 に複数の観察モードに対する観察体画像 80 を複数同時に表示させても良い。

## 【 0 4 7 1 】

例えば、4つの観察モードに対する観察体画像 80 を複数同時に表示させる場合には、次のようにする。すなわち、一般的な撮像信号の取得期間である 1 フレーム期間を、図 28 に示すように 4 つのサブフレーム期間に分割し、各サブフレームを一つの観察モードに対応させて、それら複数の観察モードに対応するレーザ光源の組み合わせを順次切り替える。この図 28 は、観察モード M1 ( 表層血管強調モード )、観察モード M2 ( 中層血管強調モード )、観察モード M3 ( 深層血管強調モード )、及び観察モード M17 ( 通常観察モード ) の 4 つの観察モードに対する観察体画像 80 を同時に表示させる例である。その他の 4 つの観察モードに関しても同様である。

## 【 0 4 7 2 】

光源駆動部 46 の記憶部 74 は、この図 28 に示すようなレーザ光源の点灯タイミング / 撮像信号取得のテーブルを記憶しており、光源駆動部 46 は、サブフレーム毎に、この記憶部 74 に記憶されているテーブルに基づいて、レーザ光源の組み合わせを順次切り替える。

## 【 0 4 7 3 】

あるいは、例えば、図 29 のように、1 フレーム期間を 2 つのサブフレーム期間に分割し、各サブフレームにおいて 3 つずつレーザ光源を点灯させるようにしても良い。すなわち、2 つサブフレームのうち、1 つ目のサブフレームにおいて、レーザ光源 44 - 1 ( レーザ 1 ) とレーザ光源 44 - 3 ( レーザ 3 ) とレーザ光源 44 - 5 ( レーザ 5 ) とを点灯させ、2 つ目のサブフレームにおいて、レーザ光源 44 - 2 ( レーザ 2 ) とレーザ光源 44 - 4 ( レーザ 4 ) とレーザ光源 44 - 6 ( レーザ 6 ) とを点灯させる。このようにして、2 つのサブフレームでレーザ光源 44 - 1 ~ 44 - 6 の撮像信号をすべて取得し、それらの撮像信号を用いて各観察モードにおける画像を生成する。すなわち、光源駆動部 46 の記憶部 74 は、この図 29 に示すようなレーザ光源の点灯タイミング / 撮像信号取得テーブルを記憶しており、光源駆動部 46 は、サブフレーム毎に、この記憶部 74 に記憶されているテーブルに基づいて、レーザ光源の組み合わせを順次切り替える。

## 【 0 4 7 4 】

なお、図 28 及び図 29 の点灯タイミングは、あくまで一例であり、その他の、複数の観察モードの画像生成に必要な青色、緑色、及び赤色撮像信号の取得方法でも良い。

## 【 0 4 7 5 】

また、順次切替及び同時表示する観察モードは 4 つに限らず、任意の 2 つ以上の観察モードで実施が可能である。

## 【 0 4 7 6 】

## [ 変形例 3 ]

第 1 の実施形態においては、ユーザによって入力部 18 に入力された観察モードに応じて、光量比変更部 72 は第 1 の光量比、第 2 の光量比及び第 3 の光量比を変更して観察モードを切り替えている。しかし、入力部 18 を介さずに自動で第 1 ~ 第 3 の光量比を変更して観察モードを切り替えるようにしても良い。

## 【 0 4 7 7 】

例えば、内視鏡 12 の挿入部 26 の先端部と観察体 O との間の距離に応じて観察モードを切り替える。内視鏡検査においてスクリーニングを行う状況では、挿入部 26 の先端部から観察体 O までの距離は比較的遠い。また、スクリーニングにおいては、病変部の発見を目的とするため、表層血管 68 s に対する観察が重要となる。そのため、挿入部 26 の先端部と観察体 O との間の距離が比較的遠い場合には、例えば表層血管 68 s が強調される観察モード M1 ( 表層血管強調モード )、観察モード 4 ( 表層-中層血管強調モード )、観察モード 8 ( 表層-中層血管強調中間モード 1 )、及び観察モード M14 ( 表層-中層

-深層血管強調中間モード１)の何れかの観察モードとなるように、光量比変更部７２は第１の光量比、第２の光量比及び第３の光量比を変更する。

【０４７８】

また例えば、内視鏡治療におけるＥＭＲ（内視鏡的粘膜切除術）やＥＳＤ（内視鏡的粘膜下層剥離術）においては、中層血管６８ｍや深層血管６８ｄのような比較的太い血管を切らないように気を付ける必要がある。そのため、例えば中層血管６８ｍや深層血管６８ｄが強調される観察モード２（中層血管強調モード）、観察モード３（深層血管強調モード）、観察モード６（中層-深層血管強調モード）、観察モードＭ１２（中層-深層血管強調中間モード１）、観察モードＭ１３（中層-深層血管強調中間モード２）、観察モードＭ１５（表層-中層-深層血管強調中間モード２）、及び観察モードＭ１６（表層-中層-深層血管強調中間モード３）の何れかの観察モードとなるように、光量比変更部７２は第１の光量比、第２の光量比及び第３の光量比を変更する。このとき、観察モードＭ１２（中層-深層血管強調中間モード１）、観察モードＭ１３（中層-深層血管強調中間モード２）、観察モードＭ１５（表層-中層-深層血管強調中間モード２）、及び観察モードＭ１６（表層-中層-深層血管強調中間モード３）のような中間モードの観察モードを用いると、より奥行き感のある観察体画像８０となる。そのため、観察モード２（中層血管強調モード）、観察モード３（深層血管強調モード）、及び観察モード６（中層-深層血管強調モード）のような１つまたは２つの血管を強調する観察モードよりも、これら中間モードの観察モードを用いる方が、中層血管６８ｍや深層血管６８ｄがどれくらいの深さにあるのかを把握し易くなるため、好ましい。

10

20

【０４７９】

[変形例４]

上記第１実施形態においては、内視鏡装置１０は、観察モードＭ１（表層血管強調モード）と、観察モードＭ２（中層血管強調モード）と、観察モードＭ３（深層血管強調モード）と、観察モードＭ４（表層-中層血管強調モード）と、観察モードＭ５（表層-深層血管強調モード）と、観察モードＭ６（中層-深層血管強調モード）と、観察モードＭ７（表層-中層-深層血管強調モード）と、観察モードＭ８（表層-中層血管強調中間モード１）と、観察モードＭ９（表層-中層血管強調中間モード２）と、観察モードＭ１０（表層-深層血管強調中間モード１）と、観察モードＭ１１（表層-深層血管強調中間モード２）と、観察モードＭ１２（中層-深層血管強調中間モード１）と、観察モードＭ１３（中層-深層血管強調中間モード２）と、観察モードＭ１４（表層-中層-深層血管強調中間モード１）と、観察モードＭ１５（表層-中層-深層血管強調中間モード２）と、観察モードＭ１６（表層-中層-深層血管強調中間モード３）と、観察モードＭ１７（通常観察モード）と、の１７つの観察モードを有していたが、それらのすべての観察モードを有することは必須では無い。

30

【０４８０】

内視鏡装置１０は、上記のうち、観察モードＭ１（表層血管強調モード）、観察モードＭ２（中層血管強調モード）、及び観察モードＭ３（深層血管強調モード）のうち何れか、または、観察モードＭ８（表層-中層血管強調中間モード１）、観察モードＭ９（表層-中層血管強調中間モード２）、観察モードＭ１０（表層-深層血管強調中間モード１）、観察モードＭ１１（表層-深層血管強調中間モード２）、観察モードＭ１２（中層-深層血管強調中間モード１）、観察モードＭ１３（中層-深層血管強調中間モード２）、観察モードＭ１４（表層-中層-深層血管強調中間モード１）、観察モードＭ１５（表層-中層-深層血管強調中間モード２）、及び観察モードＭ１６（表層-中層-深層血管強調中間モード３）のうち何れかを含んでいれば良い。

40

【０４８１】

また、内視鏡装置１０は、その他の観察モードを有していても良い。内視鏡装置１０は、色合いの異なる通常光を照射するモード、観察体Ｏにおける特定の対象物質を強調表示するその他の特殊光観察モード、観察体Ｏや薬剤に励起光を照射した際に発生する蛍光を観察する蛍光観察モード、などを有することができる。

50

## 【 0 4 8 2 】

## [ 変形例 5 ]

第 1 実施形態においては、診断対象物質を酸化ヘモグロビンとしたが、その他の物質でも良い。

## 【 0 4 8 3 】

例えば、診断対象物質は、図 3 0 にその吸収スペクトルを示すような、還元ヘモグロビンでも良い。

## 【 0 4 8 4 】

また、診断対象物質は、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンが混合された血液でも良い。その場合は、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの吸収スペクトルを混合比を掛けた吸収スペクトルとなる。

10

## 【 0 4 8 5 】

また、診断対象物質は、ヘモグロビン以外にも、例えば、公知の自家蛍光物質または蛍光薬剤でも良いし、脂肪、ビリルビン、糖、などの生体に含まれる物質でも良い。

## 【 0 4 8 6 】

以上、実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。

## 【 符号の説明 】


## 【 0 4 8 7 】

1 0 ... 内視鏡装置、 1 2 ... 内視鏡、 1 4 ... 本体部（ビデオプロセッサ）、 1 6 ... 画像表示部（モニタ）、 1 8 ... 入力部、 2 0 ... 照明部、 2 2 ... 撮像部、 2 4 ... 画像処理部、 2 6 ... 挿入部、 2 8 ... 操作部、 3 0 ... 先端硬質部、 3 2 ... 湾曲部、 3 4 ... 可撓管部、 3 6 ... 湾曲操作部、 3 8 ... 本体部（スコープ）、 4 0 ... 把持部、 4 2 ... ユニバーサルコード、 4 4 - 1 ~ 4 4 - 6 ... レーザ光源、 4 6 ... 光源駆動部、 4 8 - 1 ~ 4 8 - 6 , 5 2 ... 光ファイバ、 5 0 ... 光合波部、 5 4 ... 光変換部、 5 6 B ... 青色（B）のカラーフィルタの分光特性、 5 6 G ... 緑色（G）のカラーフィルタの分光特性、 5 6 R ... 赤色（R）のカラーフィルタの分光特性、 5 8 B ... 青色領域、 5 8 G ... 緑色領域、 5 8 R ... 赤色領域、 6 0 B ... 青色領域極大値、 6 0 G ... 緑色領域極大値、 6 2 B ... 青色領域最大値、 6 2 G ... 緑色領域最大値、 6 2 R ... 赤色領域最大値、 6 4 B ... 青色領域極小値、 6 4 G ... 緑色領域極小値、 6 6 B ... 青色領域最小値、 6 6 G ... 緑色領域最小値、 6 6 R ... 赤色領域最小値、 6 8 d ... 深層血管、 6 8 m ... 中層血管、 6 8 s ... 表層血管、 7 0 d ... 深層領域、 7 0 m ... 中層領域、 7 0 s ... 表層領域、 7 2 ... 光量比変更部、 7 4 ... 記憶部、 7 6 ... 拡散部材、 7 8 ... ホルダ、 8 0 ... 観察体画像、 8 2 d ... 深層血管画像、 8 2 m ... 中層血管画像、 8 2 s ... 表層血管画像。


20

30


【 図 1 】

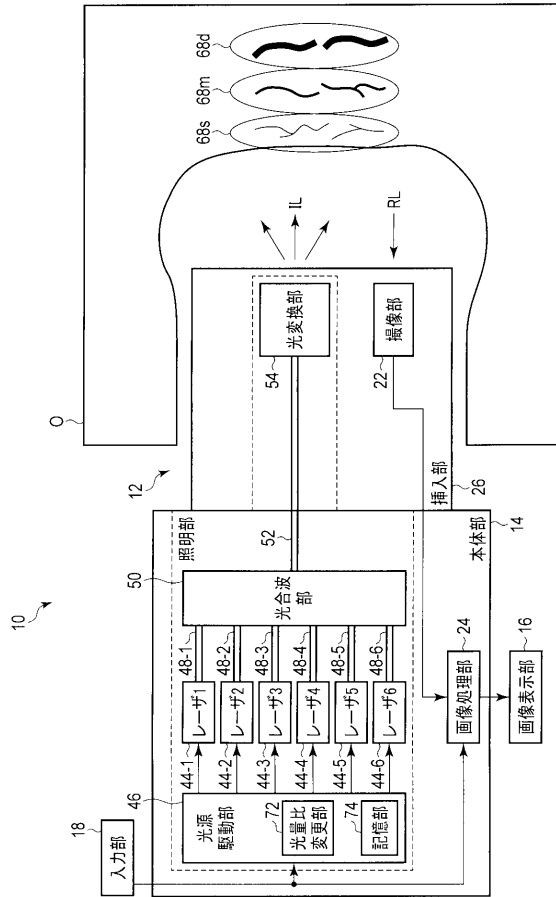


【 図 4 】

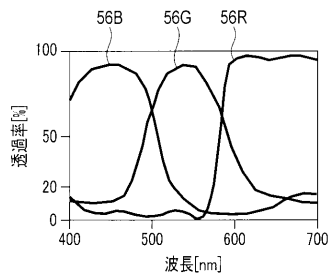


【 図 5 】

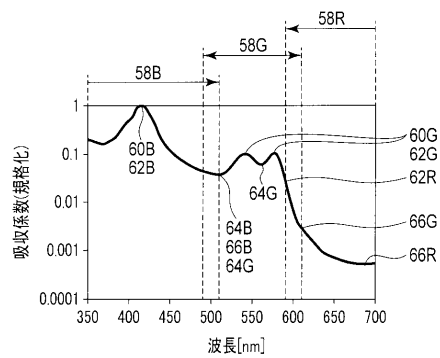

【 図 2 】

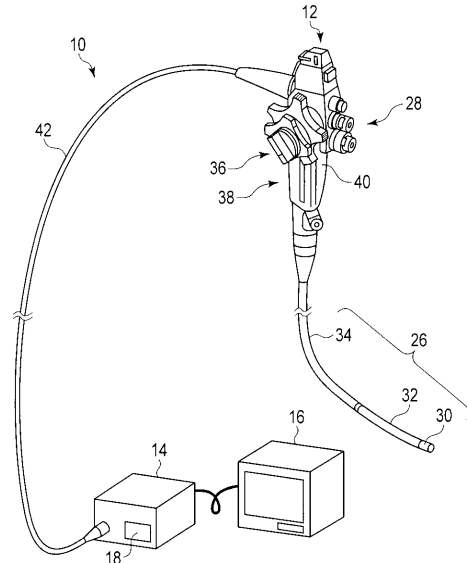


【 図 3 】

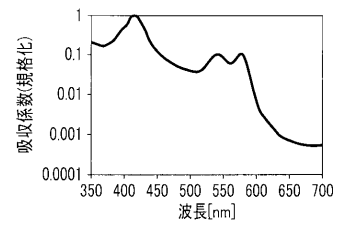

【 図 6 A 】




【 図 6 B 】

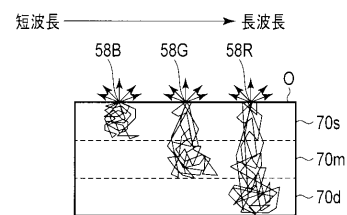


【 図 7 】

|     | レーザー1<br>(表層血管における<br>強調光源) | レーザー2<br>(表層血管における<br>非強調光源) | レーザー3<br>(中層血管における<br>強調光源) | レーザー4<br>(中層血管における<br>非強調光源) | レーザー5<br>(深層血管における<br>強調光源) | レーザー6<br>(深層血管における<br>非強調光源) |
|-----|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| M1  | ON                          | -                            | -                           | ON                           | -                           | ON                           |
| M2  | -                           | ON                           | ON                          | -                            | -                           | ON                           |
| M3  | -                           | ON                           | -                           | ON                           | ON                          | -                            |
| M4  | ON                          | -                            | ON                          | -                            | -                           | ON                           |
| M5  | ON                          | -                            | -                           | ON                           | ON                          | -                            |
| M6  | -                           | ON                           | ON                          | -                            | ON                          | -                            |
| M7  | ON                          | -                            | ON                          | -                            | ON                          | -                            |
| M8  | ON                          | -                            | ON                          | ON                           | -                           | ON                           |
| M9  | ON                          | ON                           | ON                          | -                            | -                           | ON                           |
| M10 | ON                          | -                            | -                           | ON                           | ON                          | ON                           |
| M11 | ON                          | ON                           | -                           | ON                           | ON                          | -                            |
| M12 | -                           | ON                           | ON                          | -                            | ON                          | ON                           |
| M13 | -                           | ON                           | ON                          | ON                           | ON                          | -                            |
| M14 | ON                          | -                            | ON                          | ON                           | ON                          | ON                           |
| M15 | ON                          | ON                           | ON                          | -                            | ON                          | ON                           |
| M16 | ON                          | ON                           | ON                          | ON                           | ON                          | -                            |
| M17 | ON                          | ON                           | ON                          | ON                           | ON                          | ON                           |


【 図 8 】




【 図 9 】

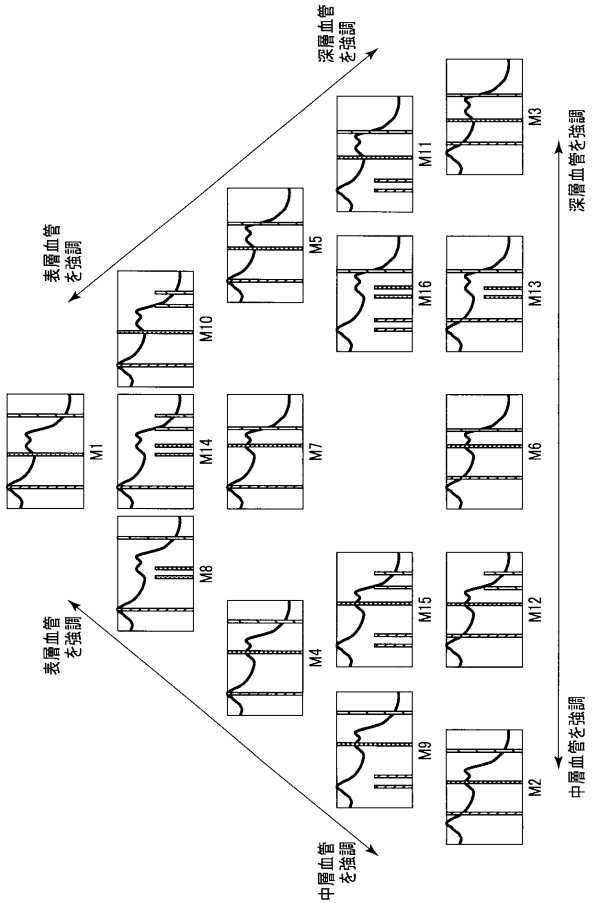


【 図 10 】

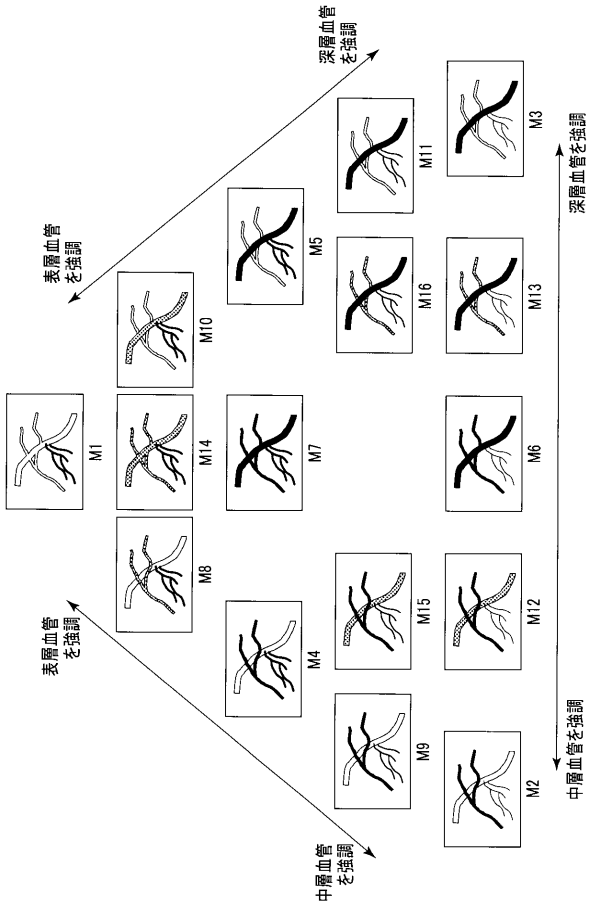


【図 1 1】

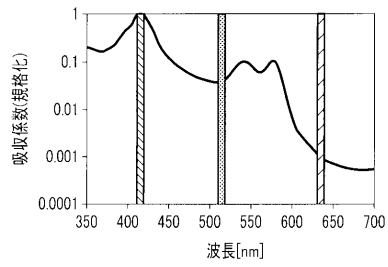


【図 1 2】

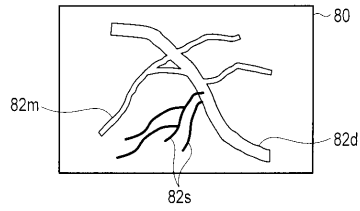


【図 1 3】

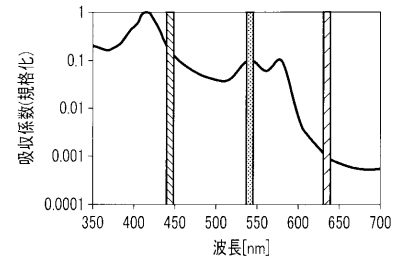


【図 1 4】

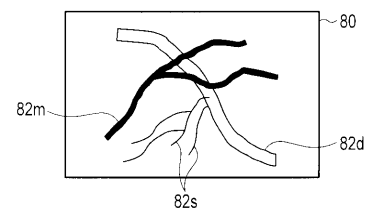


【図 1 5】

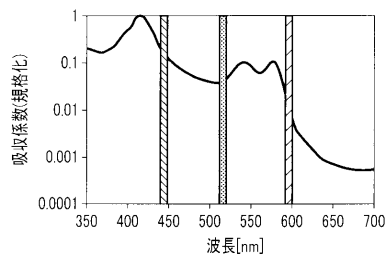


【図 1 7】

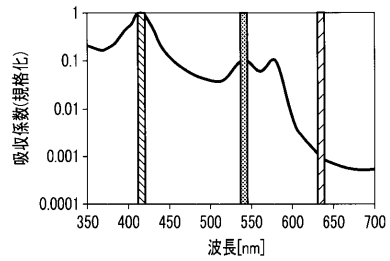


【図 1 6】

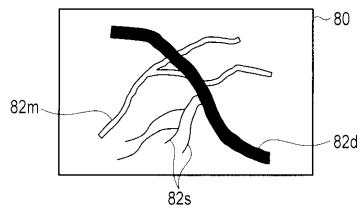


【図 1 8】

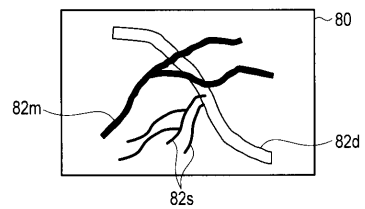


【図 19】

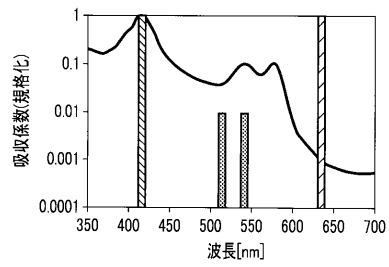


【図 21】

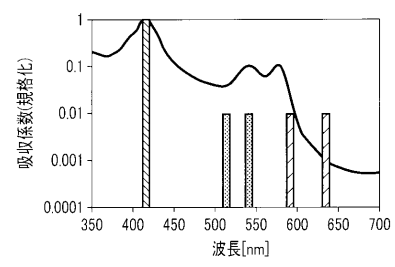


【図 20】

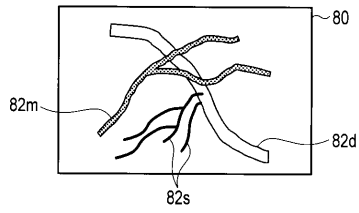


【図 22】

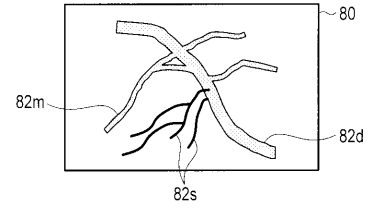


【図 23】

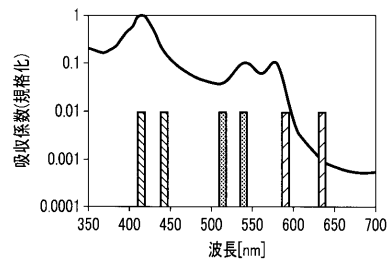


【図 25】

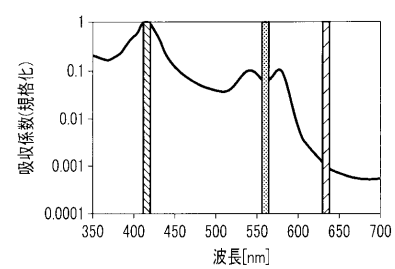


【図 24】

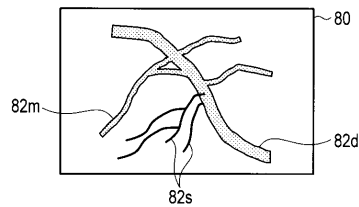

【図 26】

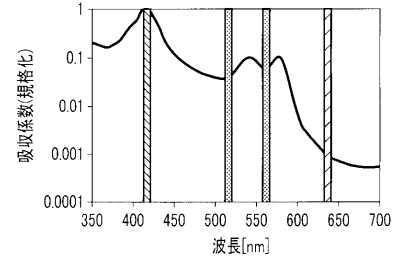


【 図 2 8 】

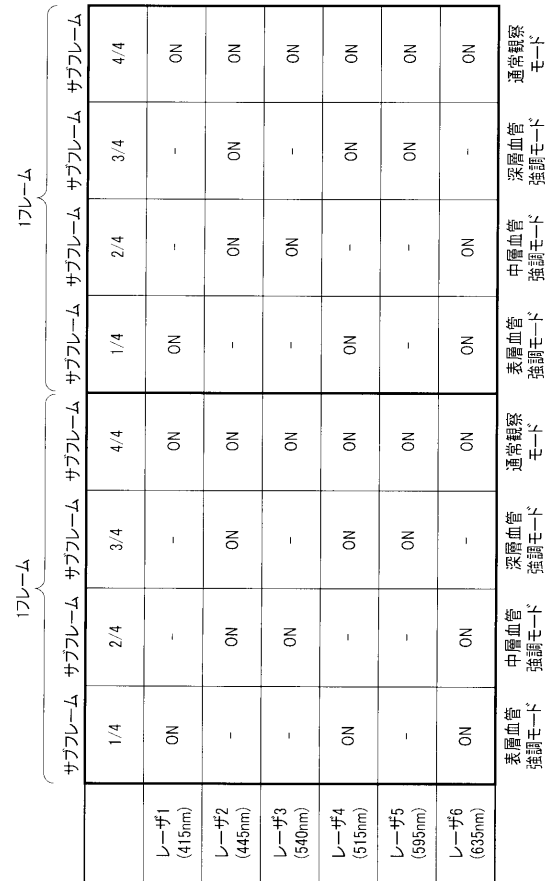

【 図 2 9 】

|                 | 1フレーム  |        | 1フレーム  |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                 | サブフレーム | サブフレーム | サブフレーム | サブフレーム |
|                 | 1/2    | 2/2    | 1/2    | 2/2    |
| レーザ1<br>(415nm) | ON     | -      | ON     | -      |
| レーザ2<br>(445nm) | -      | ON     | -      | ON     |
| レーザ3<br>(540nm) | ON     | -      | ON     | -      |
| レーザ4<br>(515nm) | -      | ON     | -      | ON     |
| レーザ5<br>(595nm) | ON     | -      | ON     | -      |
| レーザ6<br>(635nm) | -      | ON     | -      | ON     |

【 図 3 0 】

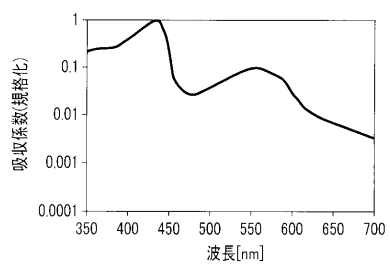

## 【国際調査報告】

| INTERNATIONAL SEARCH REPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | International application No.<br>PCT/JP2015/078620                               |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b><br>A61B1/06(2006.01) i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                  |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                  |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| <b>B. FIELDS SEARCHED</b><br>Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)<br>A61B1/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                  |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched<br>Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2015<br>Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2015 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                  |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                  |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| <b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category*</th> <th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th>Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>JP 2013-5981 A (Hoya Corp.),<br/>10 January 2013 (10.01.2013),<br/>fig. 3 to 5<br/>(Family: none)</td> <td>1-29</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 2015-527718 A (University of South Alabama),<br/>17 September 2015 (17.09.2015),<br/>&amp; US 2015-185421 A1 &amp; WO 2014-25777 A1</td> <td>1-29</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 2015-66050 A (Fujifilm Corp.),<br/>13 April 2015 (13.04.2015),<br/>&amp; US 2015-94538 A1</td> <td>1-29</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 2014-161627 A (Olympus Corp.),<br/>08 September 2014 (08.09.2014),<br/>&amp; WO 2014/132695 A1 &amp; CN 105025776 A</td> <td>1-29</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                  | Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | X | JP 2013-5981 A (Hoya Corp.),<br>10 January 2013 (10.01.2013),<br>fig. 3 to 5<br>(Family: none) | 1-29 | A | JP 2015-527718 A (University of South Alabama),<br>17 September 2015 (17.09.2015),<br>& US 2015-185421 A1 & WO 2014-25777 A1 | 1-29 | A | JP 2015-66050 A (Fujifilm Corp.),<br>13 April 2015 (13.04.2015),<br>& US 2015-94538 A1 | 1-29 | A | JP 2014-161627 A (Olympus Corp.),<br>08 September 2014 (08.09.2014),<br>& WO 2014/132695 A1 & CN 105025776 A | 1-29 |
| Category*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                           | Relevant to claim No.                                                            |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JP 2013-5981 A (Hoya Corp.),<br>10 January 2013 (10.01.2013),<br>fig. 3 to 5<br>(Family: none)                               | 1-29                                                                             |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JP 2015-527718 A (University of South Alabama),<br>17 September 2015 (17.09.2015),<br>& US 2015-185421 A1 & WO 2014-25777 A1 | 1-29                                                                             |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JP 2015-66050 A (Fujifilm Corp.),<br>13 April 2015 (13.04.2015),<br>& US 2015-94538 A1                                       | 1-29                                                                             |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JP 2014-161627 A (Olympus Corp.),<br>08 September 2014 (08.09.2014),<br>& WO 2014/132695 A1 & CN 105025776 A                 | 1-29                                                                             |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| <input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                  |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| * Special categories of cited documents:<br>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance<br>"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date<br>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)<br>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means<br>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed<br>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention<br>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone<br>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art<br>"&" document member of the same patent family |                                                                                                                              |                                                                                  |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| Date of the actual completion of the international search<br>25 December 2015 (25.12.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | Date of mailing of the international search report<br>12 January 2016 (12.01.16) |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |
| Name and mailing address of the ISA/<br>Japan Patent Office<br>3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,<br>Tokyo 100-8915, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | Authorized officer<br><br>Telephone No.                                          |           |                                                                                    |                       |   |                                                                                                |      |   |                                                                                                                              |      |   |                                                                                        |      |   |                                                                                                              |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 国際調査報告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              | 国際出願番号 PCT/J P 2015/078620                             |         |
| A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））<br>Int.Cl. A61B1/06(2006.01)i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                        |         |
| B. 調査を行った分野<br>調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））<br>Int.Cl. A61B1/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                        |         |
| 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの<br>日本国実用新案公報 1922-1996年<br>日本国公開実用新案公報 1971-2015年<br>日本国実用新案登録公報 1996-2015年<br>日本国登録実用新案公報 1994-2015年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                        |         |
| 国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                        |         |
| C. 関連すると認められる文献                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                        |         |
| 引用文献の<br>カテゴリー*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                                                            | 関連する<br>請求項の番号                                         |         |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JP 2013-5981 A (HOYA株式会社)<br>2013.01.10, 【図3】 - 【図5】 (ファミリーなし)                               | 1-29                                                   |         |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JP 2015-527718 A (ユニバーシティ・オブ・サウス・アラバマ)<br>2015.09.17, & US 2015-185421 A1 & WO 2014-25777 A1 | 1-29                                                   |         |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JP 2015-66050 A (富士フイルム株式会社)<br>2015.04.13, & US 2015-94538 A1                               | 1-29                                                   |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                        |         |
| * 引用文献のカテゴリー<br>「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの<br>「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの<br>「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）<br>「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献<br>「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願<br>の日の後に公表された文献<br>「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの<br>「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの<br>「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの<br>「&」 同一パテントファミリー文献 |                                                                                              |                                                        |         |
| 国際調査を完了した日<br>25.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 国際調査報告の発送日<br>12.01.2016                               |         |
| 国際調査機関の名称及びあて先<br>日本国特許庁 (ISA/J P)<br>郵便番号100-8915<br>東京都千代田区霞が関三丁目4番3号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | 特許庁審査官（権限のある職員）<br>小田倉 直人<br>電話番号 03-3581-1101 内線 3292 | 2Q 9163 |

国際調査報告

国際出願番号 PCT/J P 2015/078620

| C (続き) . 関連すると認められる文献 |                                                                                  |                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 引用文献の<br>カテゴリー*       | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                                                | 関連する<br>請求項の番号 |
| A                     | JP 2014-161627 A (オリンパス株式会社)<br>2014.09.08, & WO 2014/132695 A1 & CN 105025776 A | 1 - 29         |

---

フロントページの続き

(72)発明者 大道寺 麦穂

東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地 オリンパス株式会社内

(72)発明者 伊藤 毅

東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地 オリンパス株式会社内

Fターム(参考) 4C161 AA22 HH54 QQ07 RR02 RR22 WW02 WW08

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

|                |                                                                                                                                            |         |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | <无法获取翻译>                                                                                                                                   |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JPWO2017061003A5</a>                                                                                                           | 公开(公告)日 | 2018-09-06 |
| 申请号            | JP2017544128                                                                                                                               | 申请日     | 2015-10-08 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 奥林巴斯株式会社                                                                                                                                   |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 奥林巴斯公司                                                                                                                                     |         |            |
| [标]发明人         | 大道寺麦穗<br>伊藤毅                                                                                                                               |         |            |
| 发明人            | 大道寺 麦穗<br>伊藤 毅                                                                                                                             |         |            |
| IPC分类号         | A61B1/06 A61B1/00                                                                                                                          |         |            |
| CPC分类号         | A61B1/00009 A61B1/063 A61B1/0638 A61B1/043 A61B1/0646 A61B1/0653 A61B1/0684 A61B1/07<br>G01N21/6456 G01N2021/6484 G01N2201/0612 G02B6/4296 |         |            |
| FI分类号          | A61B1/06.612 A61B1/00.513 A61B1/06.510                                                                                                     |         |            |
| F-TERM分类号      | 4C161/AA22 4C161/HH54 4C161/QQ07 4C161/RR02 4C161/RR22 4C161/WW02 4C161/WW08                                                               |         |            |
| 代理人(译)         | 河野直树<br>井上 正<br>肯·鹤饲<br>饭野滋                                                                                                                |         |            |
| 其他公开文献         | JP6596502B2<br>JPWO2017061003A1                                                                                                            |         |            |

#### 摘要(译)

内窥镜装置 ( 10 ) 的照明单元 ( 20 ) 对于存在于观察对象 ( O ) 中的诊断目标物质的光吸收光谱而言, 至少具有一个最大值的至少一个最大波长是蓝色。 在红色区域的三个颜色区域中的任何一个中, 取光吸收光谱的颜色区域最大值的最大值的区域, 绿色区域和颜色区域最大波长, 增强波长区域包括以下至少之一: 在激光光源中, 其发射包括峰波长或中心波长 ( 44-1 ; 44-3 ; 44-5 ) 以及不包括三个颜色区域的强调波长区域的波长的第一强调窄带光。 作为该区域的非强调波长区域发出包括峰值波长或中心波长的第一非强调窄带光, 激光光源 ( 44-2 ; 44-4 ; 44-6 ) 和第一强调窄波长区域。 光量比改变单元 ( 72 ), 用于改变第一光量比, 该第一光量比是带光和第一非强调窄带光之间的光量比。