

(19) 日本国特許庁 (JP)

再 公 表 特 許 (A1)

(11) 国際公開番号

W02015/019669

発行日 平成29年3月2日 (2017.3.2)

(43) 国際公開日 平成27年2月12日 (2015.2.12)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/04 (2006.01)	A 6 1 B 1/04 3 7 2	2 H 0 4 O
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 P	4 C 1 6 1
G 0 2 B 23/26 (2006.01)	G 0 2 B 23/26 D	5 C 1 2 2
H 0 4 N 5/225 (2006.01)	H 0 4 N 5/225 C	


審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 21 頁)

出願番号	特願2014-559003 (P2014-559003)	(71) 出願人	304050923 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
(21) 国際出願番号	PCT/JP2014/061889	(74) 代理人	100076233 弁理士 伊藤 進
(22) 国際出願日	平成26年4月28日 (2014.4.28)	(74) 代理人	100101661 弁理士 長谷川 靖
(11) 特許番号	特許第5722512号 (P5722512)	(74) 代理人	100135932 弁理士 篠浦 治
(45) 特許公報発行日	平成27年5月20日 (2015.5.20)	(72) 発明者	永瀬 正俊 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ リンパスメディカルシステムズ株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願2013-162449 (P2013-162449)	F ターム (参考)	2H040 GA03 4C161 CC06 FF40 FF45 JJ01 JJ06 JJ11 LL02 NN01 PP08 最終頁に続く
(32) 優先日	平成25年8月5日 (2013.8.5)		
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		

(54) 【発明の名称】 内視鏡用撮像ユニット

(57) 【要約】

裏面に接続用端子部を有する撮像素子と、前記撮像素子が実装される撮像素子実装部、前記撮像素子実装部から延出する延出部、延出部の基端部に設けられた屈曲部、及び2層の導電層を有するフレキシブルプリント配線板と、を具備する内視鏡用撮像ユニットにおいて、前記撮像素子への電圧の入力及び信号の入出力を行うための入出力パッドを、前記撮像素子をグランドに接続するためのグランドパッドよりも前記屈曲部に近接した位置に配置し、かつ前記入出力パッドに接続される入出力配線を前記入出力パッドと同じ導電層によって形成する。

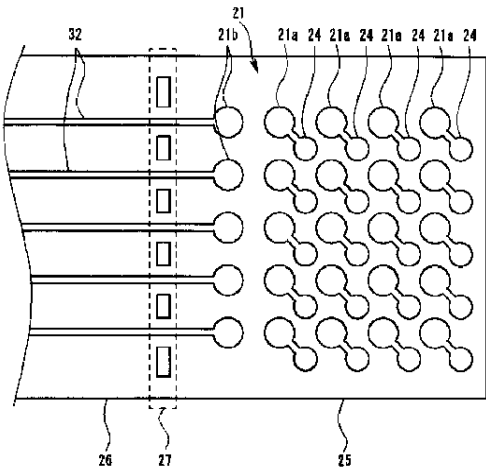

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

受光面とは反対側の面である裏面上に配列された複数の接続用端子部を有する撮像素子と、

前記複数の接続用端子部と接合される複数のパッドが形成された第 1 面及び前記第 1 面とは反対の第 2 面のそれぞれに第 1 導電層及び第 2 導電層を含む可撓性を有する回路基板であって、

前記パッドが形成された撮像素子実装部、

前記撮像素子実装部の 1 つ又は複数の外辺を基端として、前記チップ実装部から延出する 1 つ又は複数の延出部、及び

前記延出部の基端において、当該フレキシブルプリント配線板を前記第 2 面を内側として屈曲する屈曲部、

からなるフレキシブルプリント配線板と、

を具備する、内視鏡に設けられる内視鏡用撮像ユニットであって、

前記フレキシブルプリント配線板は、

前記延出部に設けられ、前記撮像素子と前記内視鏡内に配設された電気ケーブルとを電氣的に接続するための外部接続部、及び

前記パッドと前記外部接続部とを電氣的に接続する配線、を備え、

前記パッドは、前記第 1 導電層によって形成されており、

前記撮像素子をグランドに接続するためのグランドパッド、及び

前記グランドパッドよりも前記屈曲部に近接して設けられ、前記撮像素子への電圧の入力及び信号の入出力を行うための入出力パッド、

によって構成され、

前記配線は、

前記入出力パッド及び前記外部接続部を電氣的に接続し、少なくとも前記撮像素子実装部及び前記屈曲部において、前記第 1 導電層により形成された入出力配線、及び

前記グランドパッド及び前記外部接続部を電氣的に接続し、少なくとも前記撮像素子実装部及び前記屈曲部において、前記第 2 導電層により形成されたグランド配線、

によって構成される

ことを特徴とする内視鏡用撮像ユニット。

【請求項 2】

前記撮像素子は、外形が四辺形状であり、

前記屈曲部は、前記撮像素子の 4 つの外辺のうちの 1 つ又は複数の所定の辺に沿う直線を折り目としたものであり、

前記入出力パッドは、全ての前記パッドの群の最も外周において、前記撮像素子の前記所定の辺に沿って 1 列で配置されていることを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡用撮像ユニット。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、裏面に接続用端子部を有する撮像素子がフレキシブルプリント配線板上に実装されてなる内視鏡用撮像ユニットに関する。

【背景技術】

【0002】

生体の体内や構造物の内部等の観察が困難な箇所を観察するために、生体や構造物の外部から内部に導入可能であって、光学像を撮像するための撮像ユニットを具備した内視鏡が、例えば医療分野や工業分野において利用されている。

【0003】

内視鏡用撮像ユニットは、被写体像を結像する対物レンズと、対物レンズの結像面に配

10

20

30

40

50

設された一般にＣＣＤ（電荷結合素子）やＣＭＯＳ（相補型金属酸化膜半導体）センサ等と称される撮像素子を具備してなる。

【０００４】

撮像素子には、基板上への実装面積を小さくするために、撮像素子の光が入射する面（受光面）とは反対側である裏面に、基板との電氣的な接続を行うための接続用端子部が設けられた形態のものがある。例えば日本国特開２００７－７３９５８号公報には、裏面に接続用端子部が設けられた撮像素子のパッケージが開示されている。このような裏面に接続用端子部を有する撮像素子を用いれば、実装面積を小さくすることが可能である。

【０００５】

日本国特開２００７－７３９５８号に開示されているような、裏面に接続用端子部を有する撮像素子を内視鏡用撮像ユニットに用いる場合、撮像素子をフレキシブルプリント配線板上に実装し、当該フレキシブルプリント配線板を屈曲させて光軸に沿って後方（被写体とは反対方向）へ延出させ、その先端部において内視鏡内に配設された電気ケーブルを接続する形態が採用され得る。このように、撮像素子が実装されたフレキシブルプリント配線板を屈曲させて後方へ延出させることによって、撮像ユニットの外形の光軸に直交する平面への投影面積を小さくすることが可能となる。

【０００６】

撮像素子の接続用端子部は、グランドに接続するためのグランド端子部と、グランド端子以外の端子であって電源への接続及び信号の入出力に用いられる入出力端子部とによって構成されている。入出力端子部は、配列された接続用端子部において分散して配置される。このため、フレキシブルプリント配線板において、これらの接続用端子部と接合されるパッドに接続される配線は、隣接するパッドの間を通るように配置される。このため、パッドの配置間隔を狭くする、すなわち撮像素子の接続用端子部の配置間隔を狭くすることができず、小型な撮像素子を使用することが困難である。

【０００７】

また、フレキシブルプリント配線板が有する導電層を厚さ方向に複数重ねれば、配線をパッドの間を通過させることなく配置することが可能となる。しかしながら、この場合においては、フレキシブルプリント配線板の厚さが増し、屈曲部の曲げ半径が大きくなるため、屈曲部の部分が撮像素子の外形よりも外側に大きく突出してしまう。内視鏡用撮像ユニットに使用される撮像素子は、例えば１辺が３ｍｍ程度の大きさであるため、フレキシブルプリント配線板の屈曲部の突出量の変化による撮像ユニットの形状への影響は相対的に大きい。

【０００８】

撮像素子が実装されたフレキシブルプリント配線板を屈曲させて後方へ延出させる形態の内視鏡用の撮像ユニットにおいては、以上に説明したように、撮像ユニットの外形の光軸に直交する平面への投影面積を小さくすることを阻害する要素が存在する。

【０００９】

本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、裏面に接続用端子部を有する撮像素子を具備してなる内視鏡用撮像ユニットの外形の光軸に直交する平面への投影面積を小さくすることを課題とする。

【発明の開示】

【課題を解決するための手段】

【００１０】

本発明の一態様による内視鏡用撮像ユニットは、受光面とは反対側の面である裏面上に配列された複数の接続用端子部を有する撮像素子と、前記複数の接続用端子部と接合される複数のパッドが形成された第１面及び前記第１面とは反対の第２面のそれぞれに第１導電層及び第２導電層を含む可撓性を有する回路基板であって、前記パッドが形成された撮像素子実装部、前記撮像素子実装部の１つ又は複数の外辺を基端として、前記チップ実装部から延出する１つ又は複数の延出部、及び前記延出部の基端において、当該フレキシブルプリント配線板を前記第２面を内側として屈曲する屈曲部、からなるフレキシブルプリ

10

20

30

40

50

ント配線板と、を具備する、内視鏡に設けられる内視鏡用撮像ユニットであって、前記フレキシブルプリント配線板は、前記延出部に設けられ、前記撮像素子と前記内視鏡内に配設された電気ケーブルとを電氣的に接続するための外部接続部、及び前記パッドと前記外部接続部とを電氣的に接続する配線、を備え、前記パッドは、前記第１導電層によって形成されており、前記撮像素子をグランドに接続するためのグランドパッド、及び前記グランドパッドよりも前記屈曲部に近接して設けられ、前記撮像素子への電圧の入力及び信号の入出力を行うための入出力パッド、によって構成され、前記配線は、前記入出力パッド及び前記外部接続部を電氣的に接続し、少なくとも前記撮像素子実装部及び前記屈曲部において、前記第１導電層により形成された入出力配線、及び前記グランドパッド及び前記外部接続部を電氣的に接続し、少なくとも前記撮像素子実装部及び前記屈曲部において、前記第２導電層により形成されたグランド配線、によって構成される。

10

【図面の簡単な説明】

【００１１】

【図１】内視鏡の構成を説明する図である。

【図２】内視鏡の先端部の構成を説明する図である。

【図３】撮像ユニットの断面図である。

【図４】実装される前の状態である撮像素子を裏面側から見た図である。

【図５】フレキシブルプリント配線板を平面状に展開した状態における第１面を見た図である。

【図６】フレキシブルプリント配線板の構造を説明するための模式的な断面図である。

20

【図７】撮像素子が実装されたフレキシブルプリント配線板を第２面側から見た図である。

【図８】フレキシブルプリント配線板の第１面側に設けられた第１導電層の形状を示した図である。

【図９】フレキシブルプリント配線板の第２面側に設けられた第２導電層の形状を示した図である。

【図１０】第１の変形例における、撮像素子の入出力端子部の配置を示す図である。

【図１１】第１の変形例における、パッド及び入出力配線の配置を示す図である。

【図１２】第２の変形例における、延出部の配置を示す図である。

【図１３】第２の変形例における、撮像素子の入出力端子部の配置を示す図である。

30

【発明を実施するための最良の形態】

【００１２】

以下に、本発明の好ましい形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明に用いる各図においては、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、構成要素毎に縮尺を異ならせてあるものであり、本発明は、これらの図に記載された構成要素の数量、構成要素の形状、構成要素の大きさの比率、及び各構成要素の相対的な位置関係のみに限定されるものではない。

【００１３】

以下に、本発明の実施形態の一例を説明する。まず、図１を参照して、本発明に係る内視鏡用撮像ユニット１を具備する内視鏡１０１の構成の一例を説明する。なお、以下では、内視鏡用撮像ユニット１を、単に撮像ユニット１と称するものとする。

40

【００１４】

本実施形態の内視鏡１０１は、人体等の被検体内に導入可能であって被検体内の所定の観察部位を光学的に撮像する構成を有する。なお、内視鏡１０１が導入される被検体は、人体に限らず、他の生体であってもよいし、機械や建造物等の人工物であってもよい。

【００１５】

本実施形態の内視鏡１０１は一例として、被検体の内部に導入される挿入部１０２と、この挿入部１０２の基端に位置する操作部１０３と、この操作部１０３の側部から延出するユニバーサルコード１０４とで主に構成されている。

【００１６】

50

挿入部 102 は、先端に配設される先端部 110、先端部 110 の基端側に配設される遠隔操作によって湾曲する湾曲部 109、及び湾曲部 109 の基端側に配設され操作部 103 の先端側に接続される可撓性を有する可撓管部 108 が連設されて構成されている。なお、内視鏡 101 は、挿入部に可撓性を有する部位を具備しない、いわゆる硬性鏡と称される形態のものであってもよい。また、内視鏡 101 は、遠隔操作によって湾曲する湾曲部を有していない形態であってもよい。

【0017】

先端部 110 には、撮像ユニット 1 及び照明光出射部 113 (図 1 には不図示) が設けられている。また、操作部 103 には、湾曲部 109 の湾曲を操作するためのアングル操作ノブ 106 が設けられている。

10

【0018】

ユニバーサルコード 104 の基端部には外部装置 120 に接続される内視鏡コネクタ 105 が設けられている。内視鏡コネクタ 105 が接続される外部装置 120 は、例えば、光源部、画像処理部及び画像表示部 121 を具備して構成されている。

【0019】

また、内視鏡 101 は、ユニバーサルコード 104、操作部 103 及び挿入部 102 内に挿通された、電気ケーブル 115 及び光ファイバ束 114 (図 1 には不図示) を具備している。

【0020】

電気ケーブル 115 は、コネクタ部 105 と撮像ユニット 1 とを電氣的に接続するように構成されている。コネクタ部 105 が外部装置 120 に接続されることによって、撮像ユニット 1 は、電気ケーブル 115 を介して外部装置 120 に電氣的に接続される。この電気ケーブル 115 を介して、外部装置 120 から撮像ユニット 1 へのグラウンド (接地電位) への接続、電力の供給及び外部装置 120 と撮像ユニット 1 との間の信号の入出力が行われる。

20

【0021】

外部装置 120 に設けられた画像処理部は、撮像ユニット 1 から出力された撮像素子出力信号に基づいて映像信号を生成し、画像表示部 121 に出力する構成を有している。すなわち、本実施形態では、撮像ユニット 1 により撮像された光学像が、映像として表示部 121 に表示される。なお、画像処理部及び画像表示部 121 の一部又は全部は、内視鏡 101 に配設される構成であってもよい。

30

【0022】

また、光ファイバ束 114 は、外部装置 120 の光源部から発せられた光を、先端部 110 の照明光出射部 113 にまで伝えるように構成されている。なお、光源部は、内視鏡 101 の操作部 103 や先端部 110 に配設される構成であってもよい。

【0023】

次に、先端部 110 の構成を説明する。図 2 に示すように、先端部 110 には、撮像ユニット 1 及び照明光出射部 113 が、保持部 111 に対して固定された状態で配設されている。保持部 111 は、先端部 110 の先端面に露出する硬質な部材である。

40

【0024】

本実施形態では一例として、撮像ユニット 1 は、図 2 中に矢印 L で示す先端部 110 の長手方向 (挿入軸方向) に沿って先端方向を撮像するように配設されている。より具体的には、撮像ユニット 1 は、後述する対物レンズ 4 の光軸 O が挿入部 102 の長手方向に沿うように配設されている。なお、撮像ユニット 1 は、光軸 O が、挿入部 102 の長手方向に対して所定の角度をなすように配設されるものであってもよい。

【0025】

また、照明光出射部 113 は、光ファイバ束 114 から出射された光を、撮像ユニット 1 の被写体を照明するように出射する構成を有している。本実施形態では、照明光出射部 113 は、挿入部 102 の長手方向に沿って、先端部 110 の先端面から先端方向に向かって光を出射するように構成されている。

50

【 0 0 2 6 】

次に、本実施形態の撮像ユニット 1 の構成を説明する。図 3 に示すように、撮像ユニット 1 は、対物レンズ 4、撮像素子 1 0 及びフレキシブルプリント配線板 2 0 を具備して構成されている。撮像ユニット 1 を構成するこれらの部材は、略棒形状の保持棒 3 によって保持されている。本実施形態では、保持棒 3 は、光軸 O の周囲を囲う筒状の部材である。

【 0 0 2 7 】

なお以下において、撮像ユニット 1 の光軸 O に沿って、撮像ユニット 1 から被写体へ向かう方向（図 3 において左方）を前方と称し、その反対の方向を後方と称するものとする。

【 0 0 2 8 】

対物レンズ 4 は、筒形状のレンズ鏡筒 2 内に配設され、被写体像を撮像素子 1 0 の受光面 1 0 a 上に結像するための 1 つ又は複数のレンズ等の光学部材からなる。なお、対物レンズ 4 は、反射鏡、プリズム又は光学フィルタ等の光学素子を含む形態であってもよい。また、対物レンズ 4 は、焦点距離の変更が可能な構成を有する形態であってもよい。

【 0 0 2 9 】

撮像素子 1 0 は、CCD や CMOS センサ等のイメージセンサである。本実施形態では、一例として、撮像素子 1 0 は、受光面 1 0 a 上に接着された透明な部材である保護ガラス 1 1 を介して、保持棒 3 内の所定の位置に固定されている。撮像素子 1 0 は、受光面 1 0 a が、光軸 O と略直交するように配設されている。

【 0 0 3 0 】

撮像素子 1 0 は、詳しくは後述するが、フレキシブルプリント配線板 2 0 の一方の面である第 1 面 2 0 a 上に実装されている。フレキシブルプリント配線板 2 0 には、電気ケーブル 1 1 5 の先端部が接続されており、撮像素子 1 0 は、フレキシブルプリント配線板 2 0 を介して電気ケーブル 1 1 5 に電氣的に接続されている。

【 0 0 3 1 】

撮像素子 1 0、フレキシブルプリント配線板 2 0 及び電気ケーブル 1 1 5 の接続の形態について、以下に説明する。

【 0 0 3 2 】

図 4 は、フレキシブルプリント配線板 2 0 に実装される前の状態である撮像素子 1 0 を裏面 1 0 b 側から見た図である。また、図 5 は、フレキシブルプリント配線板 2 0 を平面状に展開した状態における第 1 面 2 0 a を見た図である。

【 0 0 3 3 】

図 4 に示すように、撮像素子 1 0 は、受光面 1 0 a とは反対を向く面である裏面 1 0 b 上に、金属等の導電性の材料からなる複数の接続用端子部 1 2 が配列されている。撮像素子 1 0 は、受光面 1 0 a に直交する軸に沿って見た場合（光軸 O に沿って見た場合）に略矩形の外形を有する。本実施形態では、複数の接続用端子部 1 2 は、行列状に配列されており、この配列の行方向及び列方向は、略矩形である撮像素子 1 0 の外辺と略平行である。

【 0 0 3 4 】

撮像素子 1 0 の複数の接続用端子部 1 2 は、グラウンドに接続されるグラウンド端子部 1 2 a と、及び電圧の入力及び信号の入出力に用いられる入出力端子部 1 2 b によって構成されている。なお、図 4 において、接続用端子部 1 2 のうちの網掛け（交差したハッチング）がされたものが入出力端子部 1 2 b であり、その他のものがグラウンド端子部 1 2 a である。また図 6 において、符号 1 3 は、撮像素子 1 0 の向きを明確にするためのマークである。なお、マーク 1 3 は、撮像素子 1 0 に配設されない形態であってもよい。グラウンド端子部 1 2 a 及び入出力端子部 1 2 b の配置については後述するものとする。

【 0 0 3 5 】

本実施形態の撮像素子 1 0 のように、電子部品の所定の面に複数の接続用端子部 1 2 を配列された表面実装用電子部品の形態は、一般に BGA (Ball Grid Array) や LGA (Land Grid Array) 等と称される。このような形態の表面

10

20

30

40

50

実装用電子部品の接続用端子部と回路基板のパッドとは、例えば半田接合等の金属接合や導電性接着剤等の公知の技術によって接合され、電気的な導通がとられる。

【 0 0 3 6 】

近年では、シリコン貫通電極 (T S V : T h r o u g h S i l i c o n V i a) と称される技術によって、シリコンウェハから切り出された集積回路を有するチップ (ダイ) の裏面に、複数の接続用端子部を形成することが可能であり、当該集積回路を有するチップの実装面積を小さくすることができるようになっている。

【 0 0 3 7 】

本実施形態の内視鏡用の撮像ユニット 1 に使用される撮像素子 1 0 は、このようなシリコン貫通電極を用いたチップサイズレベル (ダイサイズレベル) の大きさのものであり、
10 受光面 1 0 a に直交する方向から見た場合の大きさが例えばおよそ 3 m m 四方である。

【 0 0 3 8 】

本実施形態では一例として、撮像素子 1 0 は、B G A と称される形態を有し、実装される前の状態において、複数の接続用端子部 1 2 のそれぞれに半田製の略球状の部位である半田ボールが形成されている。

【 0 0 3 9 】

図 5 に示すように、フレキシブルプリント配線板 2 0 の第 1 面 2 0 a には、撮像素子 1 0 のお複数の接続用端子部 1 2 に対応する位置に配列された、金属等の導電性の材料からなる複数のパッド 2 1 が形成されている。本実施形態では、撮像素子 1 0 の複数の接続用
20 端子部 1 2 と、フレキシブルプリント配線板 2 0 の複数のパッド 2 1 とは、半田接合法によって接合され、両者間の電気的な接続がなされる。

【 0 0 4 0 】

フレキシブルプリント配線板 2 0 は、可撓性を有する電子回路基板である。このような、可撓性を有する電子回路基板は、一般に F P C (F l e x i b l e P r i n t e d C i r c u i t) 等と称される。フレキシブルプリント配線板 2 0 は、電気絶縁性を有する樹脂等の材料からなるフィルム状の基材として、導電性の金属等の材料からなる導電パターンを形成したものである。フレキシブルプリント配線板 2 0 を構成する材料等は、公知の技術であるため、詳細な説明は省略するものとする。

【 0 0 4 1 】

本実施形態のフレキシブルプリント配線板 2 0 は、絶縁性の基材の両面に導電パターンが形成された、2 層の F P C である。図 6 は、フレキシブルプリント配線板 2 0 の両面に導電層が形成された箇所の断面の模式図である。
30

【 0 0 4 2 】

本実施形態のフレキシブルプリント配線板 2 0 は、ポリイミド等の電気絶縁性を有する材料からなるフィルム状の基材 3 3 の両面に、第 1 導電層 2 2 及び第 2 導電層 2 3 が設けられており、この第 1 導電層 2 2 及び第 2 導電層 2 3 と、両者を電気的に接続するビアによって、電子回路の配線が形成される。

【 0 0 4 3 】

第 1 導電層 2 2 は、撮像素子 1 0 が実装される第 1 面 2 0 a 側に配設されており、第 2 導電層 2 3 は、第 1 面 2 0 a とは反対側の第 2 面 2 0 b 側に配設されている。すなわち、
40 前述した複数のパッド 2 1 は、第 1 導電層 2 2 の一部によって形成されている。また、図 6 には、第 1 導電層 2 2 及び第 2 導電層 2 3 のそれぞれの上に形成された電気絶縁性を有する材料からなる絶縁層 3 4 が示されている。なお、絶縁層 3 4 は、パッド 2 1 等の、他の電子部品が接合される箇所には形成されないものであることは言うまでもない。

【 0 0 4 4 】

図 5 に示すように、フレキシブルプリント配線板 2 0 は、撮像素子 1 0 が実装される撮像素子実装部 2 5 と、撮像素子実装部 2 5 の 1 つまたは複数の外辺を基端として当該 1 つまたは複数の外辺から延出する 1 つまたは複数の延出部 2 6 と、の 2 つの領域を有して構成されている。

【 0 0 4 5 】

10

20

30

40

50

また、図 3 に示すように、撮像素子 10 が実装された状態のフレキシブルプリント配線板 20 は、撮像素子実装部 25 及び延出部 26 の間に屈曲部 27 が形成された状態で、撮像ユニット 1 内に配設される。

【0046】

撮像素子実装部 25 には、前述のように、第 1 面 20a に、撮像素子 10 の複数の接続用端子部 12 が接合される複数のパッド 21 が形成されている。撮像素子実装部 25 の外形は、パッド 21 及び後述する配線を形成可能な形状であれば特に限定されるものではないが、撮像素子 10 の受光面 10a と平行な平面上に外形を投影した場合において、撮像素子実装部 25 の外形は、撮像素子 10 の外形と略同等、もしくは撮像素子 10 の外形から外に出ない形状であることが好ましい。

10

【0047】

本実施形態においては、一例として、撮像素子実装部 25 の外形は略平行四辺形状であって、撮像素子実装部 25 の 4 つの外辺は、実装される撮像素子 10 の外辺と略平行である。そして、撮像素子実装部 25 の撮像素子 10 の受光面 10a と平行な平面への外形の投影形状は、撮像素子 10 の外形の同平面への投影形状よりも小さい。すなわち、撮像ユニット 1 を光軸 O に沿って前方から見た場合において、撮像素子実装部 25 は、撮像素子 10 の後方に隠れる形状を有している。

【0048】

このように、撮像素子実装部 25 の外形を、撮像素子 10 の外形に対して略同等または小さくすることは、これらを有する撮像ユニット 1 の外形の光軸 O に直交する平面への投影面積を小さくすることに貢献する。なお、撮像素子実装部 25 の外形は、撮像素子 10 の外形よりも大きいものであってもよい。

20

【0049】

そして、図 5 に示すように、フレキシブルプリント配線板 20 を平面状に展開した状態（屈曲部を形成する前の状態）とした場合において、延出部 26 は、撮像素子実装部 25 の 1 つの外辺から、当該外辺に略直交する方向に延出するように形成されている。

【0050】

延出部 26 の幅は、当該延出部 26 の基端に位置する撮像素子実装部 25 と略同一であるか撮像素子実装部 25 よりも狭い。本実施形態では一例として、延出部 26 は、撮像素子実装部 25 と同一の幅を有している。延出部 26 の長さは特に限定されるものではなく、後述する外部接続部 28、電子部品 29 及び配線を配置するのに必要な面積に応じて定められる。

30

【0051】

延出部 26 の先端部 26a には、外部接続部 28 が形成されている。外部接続部 28 は、電気ケーブル 115 の先端部が接続可能に構成されている。外部接続部 28 と電気ケーブル 115 とが接続されることによって、撮像素子 10 を含むフレキシブルプリント配線板 20 に形成された電子回路と、電気ケーブル 115 と、が電氣的に接続される。

【0052】

外部接続部 28 と電気ケーブル 115 との接続の形態は特に限定されるものではない。外部接続部 28 と電気ケーブル 115 との接続は、例えば半田接合によるものであってもよいし、着脱可能なコネクタ機構によるものであってもよい。

40

【0053】

本実施形態では一例として、外部接続部 28 と電気ケーブル 115 との接続は半田接合であり、外部接続部 28 は、撮像素子 10 を含むフレキシブルプリント配線板 20 に形成された電子回路に接続された導電性の材料からなる複数のパッドによって構成されている。

【0054】

なお、図示する本実施形態の外部接続部 28 は、フレキシブルプリント配線板 20 の第 1 面 20a に形成されているが、外部接続部 28 は第 2 面 20b に形成されるものであってもよいし、第 1 面 20a 及び第 2 面 20b の両面に形成されるものであってもよい。

50

【 0 0 5 5 】

また、延出部 2 6 には、必要に応じて一つ又は複数の電子部品 2 9 が実装される。本実施形態における電子部品 2 9 は、一例として、撮像素子 1 0 の電源電圧の変動の抑制や、電源配線におけるノイズの抑制を目的として配設されるコンデンサである。なお、延出部 2 6 は、複数の電子部品が実装される形態であってもよいし、電子部品が実装されない形態であってもよい。また、延出部 2 6 に電子部品 2 9 が実装される場合には、電子部品 2 9 は、第 1 面 2 0 a 及び第 2 面 2 0 b のいずれに実装される形態であってもよい。

【 0 0 5 6 】

そして、屈曲部 2 7 は、撮像素子実装部 2 5 及び延出部 2 6 の境界部において、フレキシブルプリント配線板 2 0 を、第 2 面 2 0 b を内側として折り曲げることによって形成されている。言い換えれば、屈曲部 2 7 は、フレキシブルプリント配線板 2 0 を、延出部 2 6 が設けられた撮像素子実装部 2 5 の外辺に沿って第 2 面 2 0 b を内側として折り曲げた部位である。

【 0 0 5 7 】

屈曲部 2 7 が形成されることによって、延出部 2 6 は、撮像ユニット 1 内において先端部 2 6 a が撮像ユニット 1 の後方に向かうように延在する。言い換えれば、撮像ユニット 1 内における延出部 2 6 は、撮像素子実装部 2 5 から、受光面 1 0 a に直交する軸に沿って撮像素子 1 0 の裏面 1 0 b から受光面 1 0 a とは反対側に向かって延出している。

【 0 0 5 8 】

さらに言い換えるならば、撮像素子 1 0 が実装されたフレキシブルプリント配線板 2 0 は、撮像素子 1 0 が実装された第 1 面 2 0 a とは反対側の第 2 面 2 0 b を内側として屈曲する屈曲部 2 7 と、屈曲部 2 7 を挟んだ一方の側であって撮像素子 1 0 が実装される領域である撮像素子実装部 2 5 と、屈曲部 2 7 を挟んだ他方の側であって該屈曲部 2 7 から受光面 1 0 a に直交する軸に沿って撮像素子 1 0 の裏面 1 0 b から受光面 1 0 a とは反対側に向かう方向に延出する延出部 2 6 と、を有して構成されている。

【 0 0 5 9 】

屈曲部 2 7 において撮像素子実装部 2 5 と延出部 2 6 とが成す角度（内角）は、特に限定されるものではなく、鋭角であってもよいし、直角であってもよいし、鈍角であってもよい。例えば、図示する本実施形態のように、屈曲部 2 7 において撮像素子実装部 2 5 と延出部 2 6 とが成す角度を直角または鋭角とすれば、撮像素子 1 0 の受光面 1 0 a と平行な平面上に外形を投影した場合の延出部 2 6 の外形は、撮像素子 1 0 の外形と重なる。このことはすなわち、撮像ユニット 1 の、光軸 O に直交する平面への投影面積を減少させることが可能であることを意味する。

【 0 0 6 0 】

本実施形態では一例として、屈曲部 2 7 の折り曲げの角度は鋭角であって、光軸 O に沿って前方から見た場合に、延出部 2 6 の全体が、撮像素子 1 0 によって隠されるように、屈曲部 2 7 の折り曲げの角度が定められている。言い換えれば、本実施形態の撮像ユニット 1 では、撮像素子 1 0 の受光面 1 0 a と平行な平面上に投影した場合に、撮像素子 1 0 の外形の中に、フレキシブルプリント配線板 2 0 の外形が収まっている。

【 0 0 6 1 】

また、図 5 に示すように、フレキシブルプリント配線板 2 0 には、屈曲部 2 7 に沿って複数のスリット 3 0 が形成されている。スリット 3 0 は、フレキシブルプリント配線板 2 0 の形成された後述する配線を避けて穿設された貫通孔であり、フレキシブルプリント配線板 2 0 に屈曲部 2 7 を形成する場合の折り曲げを容易にするために設けられている。

【 0 0 6 2 】

以上に説明したように、本実施形態の撮像ユニット 1 は、撮像素子 1 0 が実装されたフレキシブルプリント配線板 2 0 を有し、フレキシブルプリント配線板 2 0 は、撮像ユニットから延出する電気ケーブル 1 1 5 と電氣的に接続されている。フレキシブルプリント配線板 2 0 は、撮像素子 1 0 が実装される撮像素子実装部 2 5 と、撮像素子実装部 2 5 の外辺から延出し、電気ケーブル 1 1 5 が接続される外部接続部 2 8 を有する延出部 2 6 と、

10

20

30

40

50

を有している。そして、フレキシブルプリント配線板 20 は、撮像素子実装部 25 と延出部 26 との間に屈曲部 27 が形成されている。延出部 26 は、撮像素子 10 を、受光面 10a に直交する軸に沿って受光面側から見た場合において、撮像素子 10 の外形に略隠れるように配設されている。

【0063】

次に、撮像素子 10 の複数の接続用端子部 12 と、フレキシブルプリント配線板 20 に形成された複数のパッド 21 及び配線の詳細について説明する。

【0064】

図 4 に示すように、撮像素子 10 の複数の接続用端子部 12 は、グラウンドに接続されるグラウンド端子部 12a と、及び電圧の入力及び信号の入出力に用いられる入出力端子部 12b によって構成されている。

10

【0065】

撮像素子 10 に設けられた全ての接続用端子部 12 の集合において、入出力端子部 12b は、この集合の最も外周部であって、かつ略平行四辺形である撮像素子 10 の所定の 1 つ又は複数の外辺に沿うように配設されている。ここで、所定の 1 つ又は複数の外辺とは、撮像素子 10 がフレキシブルプリント配線板 20 に実装された場合において、屈曲部 27 に近接する辺 10c、及びこの辺と交わる 2 つの辺 10d である。

【0066】

図 7 は、撮像素子 10 が実装されたフレキシブルプリント配線板 20 を第 2 面 20b 側から見た図である。図 7 に示すように、本実施形態のフレキシブルプリント配線板 20 は、屈曲部 27 が 1 箇所形成されており、入出力端子部 12b は、この屈曲部 27 に最も近くかつ屈曲部 27 に略平行となる撮像素子 10 の 1 つの辺 10c に沿って、最外周部に 1 列で配列されている。

20

【0067】

一方、グラウンド端子部 12a は、前記の入出力端子部 12b が配置されていない箇所に配置されている。すなわち、グラウンド端子部 12a は、撮像素子 10 がフレキシブルプリント配線板 20 に実装された状態において、屈曲部 27 に近接する領域には配置されていない。さらに言い換えるならば、グラウンド端子部 12a は、撮像素子 10 がフレキシブルプリント配線板 20 に実装された状態において、屈曲部 27 との間に入出力端子部 12b を挟むように配置されている。なお、グラウンド端子部 12b の一部は、入出力端子部 12b が配列される最外周部に配置されていてもよい。

30

【0068】

図 8 は、フレキシブルプリント配線板 20 を展開した状態における、第 1 面 20a 側に設けられた第 1 導電層 22 の形状を示した図である。図 8 に示すように、フレキシブルプリント配線板 20 のパッド 21 は、撮像素子 10 のグラウンド端子部 12a 及び入出力端子部 12b がそれぞれ接合されるグラウンドパッド 21a 及び入出力パッド 21b によって構成されている。

【0069】

前述したように、撮像素子 10 の入出力端子部 12b は、接続用端子部 12 の配列の外周のうちの、屈曲部 27 に近接する辺に配置されている。したがって、パッド 21 の入出力パッド 21b も同様に、全てのパッド 21 からなる群のうちの、最も外周であって、屈曲部 27 に沿う辺上に配置されている。また、グラウンドパッド 21a は、入出力パッド 21b が配設されていない箇所に配設されている。

40

【0070】

次に、フレキシブルプリント配線板 20 における、撮像素子実装部 25 に設けられたパッド 21 と、延出部 26 に設けられた外部接続部 28 との電気的な接続の構成について説明する。

【0071】

フレキシブルプリント配線板 20 は、前述のように、第 1 面 20a 側に設けられた第 1 導電層 22、及び第 2 面側 23 に設けられた第 2 導電層 23 の 2 つの導電層を有している

50

。

【 0 0 7 2 】

グランドパッド 2 1 a 及び入出力パッド 2 1 b からなるパッド 2 1 は、第 1 導電層 2 2 によって形成されている。そして図 8 に示すように、入出力パッド 2 1 b と外部接続部 2 8 とを電氣的に接続するための配線である入出力配線 3 2 は、少なくとも個々の入出力パッド 2 1 b を基端として延出部 2 6 の所定の位置にまで至る範囲において、第 1 面 2 0 a 側に設けられた第 1 導電層 2 2 によって形成されている。

【 0 0 7 3 】

ここで、入出力配線 3 2 が第 1 導電層 2 2 によって形成される所定の範囲とは、電子部品 2 9 が延出部 2 6 に実装される場合においては、入出力パッド 2 1 b から電子部品 2 9 が実装されている領域までのことである。また、電子部品 2 9 が延出部 2 6 に実装されない場合においては、入出力配線 3 2 が第 1 導電層 2 2 によって形成される所定の範囲とは、入出力パッド 2 1 b から外部接続部 2 8 が形成されている領域までのことである。電子部品 2 9 や外部接続部 2 8 が形成されている領域においては、これらの形態に応じて入出力配線 3 2 が配置されるため、入出力配線 3 2 を構成する導電層は、第 1 導電層 2 2 であってもよいし、第 2 導電層 2 3 であってもよい。

【 0 0 7 4 】

すなわち、本実施形態においては、入出力パッド 2 1 b に接続される入出力配線 3 2 は、少なくとも入出力パッド 2 1 b から引き出された後に屈曲部 2 7 を通過して延出部 2 6 の先端部 2 6 a に向かって所定の距離に至るまでの範囲において、入出力パッド 2 1 b と同様に第 1 導電層 2 2 によって形成されている。そして、延出部 2 6 において屈曲部 2 7 から延出部 2 6 の先端部 2 6 a 側へ所定の距離よりも離れた範囲においては、入出力配線 3 2 を形成する導電層は特に限定されていない。

【 0 0 7 5 】

図 9 は、フレキシブルプリント配線板 2 0 を展開した状態における、第 2 面 2 0 b 側に設けられた第 2 導電層 2 3 の形状を示した図である。図 9 に示すように、グランドパッド 2 1 a と外部接続部 2 8 とを電氣的に接続するための配線であるグランド配線 3 1 は、少なくとも個々のグランドパッド 2 1 a を基端として延出部 2 6 の所定の位置にまで至る範囲において、第 2 面 2 0 b 側に設けられた第 2 導電層 2 3 によって形成されている。

【 0 0 7 6 】

ここで、グランド配線 3 1 が第 2 導電層 2 3 によって形成される所定の範囲とは、電子部品 2 9 が延出部 2 6 に実装される場合においては、グランドパッド 2 1 a から電子部品 2 9 が実装されている領域までのことである。また、電子部品 2 9 が延出部 2 6 に実装されない場合においては、グランド配線 3 1 が第 2 導電層 2 1 によって形成される所定の範囲とは、グランドパッド 2 1 a から外部接続部 2 8 が形成されている領域までのことである。電子部品 2 9 や外部接続部 2 8 が形成されている領域においては、これらの形態に応じてグランド配線 3 1 が配置されるため、グランド配線 3 1 を構成する導電層は、第 1 導電層 2 2 であってもよいし、第 2 導電層 2 3 であってもよい。

【 0 0 7 7 】

第 2 導電層 2 3 によって形成されたグランド配線 3 1 と、第 1 導電層 2 2 によって形成されたグランドパッド 2 1 a とは、フレキシブルプリント配線板 2 0 を貫通する金属等の導電性の材料からなる柱状のビア 2 4 (図 8 に図示) によって電氣的に接続される。なお、2 層の導電層を有するフレキシブルプリント配線板 2 0 において、2 層の導電層間の電氣的な接続を確立するための技術は公知のものであり、その詳細な説明は省略するものとする。なお、グランド配線 3 1 とグランドパッド 2 1 a とは、パッド・オン・ビアと称される技術によって電氣的に接続される形態であってもよい。

【 0 0 7 8 】

すなわち、本実施形態においては、グランドパッド 2 1 a に接続されるグランド配線 3 1 は、少なくとも撮像素子実装部 2 5 から屈曲部 2 7 を通過して延出部 2 6 の先端部 2 6 a に向かって所定の距離に至るまでの範囲において、グランドパッド 2 1 a に対して反対

側に設けられた第２導電層２３によって形成されている。そして、延出部２６において屈曲部２７から延出部２６の先端部２６ａ側へ所定の距離よりも離れた範囲においては、入出力配線３２を形成する導電層は特に限定されていない。

【００７９】

また、本実施形態においては、図９に示すように、グランド配線３１は、撮像素子実装部２５において、パッド２１が形成された領域の反対側を覆うように面状に形成されている。グランド配線３１をパッド２１が形成された領域の反対側を覆うように形成することによって、撮像素子１０の全てのグランド端子部１２ａを、グランドに接続することができる。

【００８０】

以上に説明した本実施形態のように、対物レンズ４に反射面が設けられておらず光軸Ｏが途中で屈曲することのない撮像ユニット１においては、撮像素子１０の外形及び実装面積を小さくすることは、撮像ユニット１の外形の光軸Ｏに直交する平面への投影面積を小さくすることに寄与する。

【００８１】

本実施形態では、撮像素子１０を、裏面１０ｂ上に接続用端子部１２を有する形態のものとすることによって撮像素子１０の実装面積を小さくするとともに、さらにフレキシブルプリント配線板２０に屈曲部２７を設けて延出部２６を撮像素子１０の後方に向かって延出させることによって、光軸Ｏに沿って前方から見た場合に外部接続部２８が撮像素子１０の後方に隠れるように配置している。フレキシブルプリント配線板２０は、撮像素子１０が接合されるパッド２１が設けられた第１面２０ａ側の第１導電層２２と、第１面２０ａとは反対の第２面２０ｂ側の第２導電層２３との２層の導電層を有した回路基板である。

【００８２】

ここで、本実施形態では、撮像素子１０が実装されるパッド２１において、入出力パッド２１ｂはパッド２１の群の最も外周において、屈曲部２７に近接して設けられている。言い換えれば、本実施形態では、フレキシブルプリント配線板２０上において、入出力パッド２１ｂは、パッド２１の群内において外部接続部２８に近接した外周部に配置されている。

【００８３】

したがって本実施形態では、図８に示すように、入出力パッド２１ｂと外部接続部２８とを電氣的に接続する入出力配線３２を、隣接し合うパッド２１の間を通過させることなく、単一の第１導電層２２によって形成することが可能であり、パッド２１の間隔を狭くすることができる。このように、本実施形態では、撮像素子１０の接続用端子部１２の間隔（中心間距離）を狭くすることができるため、撮像素子１０をより小型なものとすることができる。

【００８４】

また、本実施形態のフレキシブルプリント配線板２０は、２層の導電層を有する形態のものであることから、屈曲部２７の曲げ半径を小さくでき、撮像素子１０を前方から見た場合において、屈曲部２７を撮像素子１０の外形の内側に隠れるように配置する、又は屈曲部２７の撮像素子１０の外形からの突出量を僅かなものとすることができる。

【００８５】

以上に説明したように、本実施形態によれば、接続用端子部１２の配置間隔が狭い小型な撮像素子１０を採用しつつ、２層の導電層を有する比較的薄いフレキシブルプリント配線板２０を使用することができる。よって、本実施形態によれば、裏面１０ｂに接続用端子部１２を有する撮像素子１０を具備してなる内視鏡用撮像ユニット１の外形の光軸Ｏに直交する平面への投影面積を小さくすることが可能である。

【００８６】

また、本実施形態では、図８に示すように、入出力パッド２１ｂがパッド２１の群内において外部接続部２８に近接した外周部に配置されていることから、入出力配線３２はパ

10

20

30

40

50

ッド 2 1 の群の周囲を迂回するように配設される必要がない。言い換えれば、全ての入出力配線 3 2 は、入出力パッド 2 1 b から外部接続部 2 8 に向かって直線的に配設されている。また、本実施形態では、撮像素子実装部 2 5 において、全てのグランド配線 3 1 は、第 2 面 2 0 b 側の第 2 導電層 2 3 によって形成されていることから、グランド配線 3 1 もパッド 2 1 の群の周囲を迂回するように配設される必要がない。

【 0 0 8 7 】

このように、本実施形態では撮像素子実装部 2 5 において、パッド 2 1 の群の周囲を迂回する配線が無いことから、撮像素子実装部 2 5 の外形を小さくすることができ、撮像素子実装部 2 5 を撮像素子 1 0 の外形の内側に隠れるように配置する、又は撮像素子実装部 2 5 の撮像素子 1 0 の外形からの突出量を僅かなものとすることができる。このことは、内視鏡用撮像ユニット 1 の外形の光軸 O に直交する平面への投影面積を小さくすることに寄与する。

10

【 0 0 8 8 】

また、本実施形態では、全てのグランドパッド 2 1 a は、ビア 2 4 を介して、第 2 面 2 0 b 側のグランド配線 3 1 に接続されているが、グランドパッド 2 1 a 及びビア 2 4 は、屈曲部 2 6 との間に入出力パッド 2 1 b を挟むように配設されている。言い換えれば、本実施形態では、ビア 2 4 を伴うグランドパッド 2 1 a は、ビアによる接続のない入出力パッド 2 1 b よりも、屈曲部 2 6 から遠い位置に配設されている。一般に、フレキシブルプリント配線板において基材を貫通するビアが設けられた部分は、フレキシブルプリント配線板に曲げ応力が加えられた場合に破損しやすい。本実施形態においては、屈曲部 2 6 を形成する際の曲げ応力がビア 2 4 が形成された部分に加わりにくいいため、フレキシブルプリント配線板 2 0 の破損を防止することができる。

20

【 0 0 8 9 】

なお、上述した実施形態では、撮像素子 1 0 の入出力端子部 1 2 b は、撮像素子 1 0 の外辺のうちの、屈曲部 2 7 に最も近接し、かつ屈曲部 2 7 と略平行な 1 つの辺 1 0 c に沿って外周に設けられるのみであるが、入出力端子部 1 2 b は、複数の辺に沿って設けられる形態であってもよい。

【 0 0 9 0 】

例えば、図 1 0 に第 1 の変形例として示すように、撮像素子 1 0 の入出力端子部 1 2 b は、撮像素子 1 0 がフレキシブルプリント配線板 2 0 に実装された場合において、屈曲部 2 7 に近接する辺 1 0 c、及びこの辺と交わる 2 つの辺 1 0 d に沿って、接続用端子部 1 2 の群の最外周に設けられる形態であってもよい。この第 1 の変形例では、フレキシブルプリント配線板 2 0 の入出力配線 3 2 のうちの、辺 1 0 d に沿って配置された入出力端子部 1 2 b に対応するものは、図 1 1 に示すように、パッド 2 1 の群の外側に沿って配置される。

30

【 0 0 9 1 】

また、上述した実施形態では、フレキシブルプリント配線板 2 0 の延出部 2 6 は 1 つのみであるが、延出部 2 6 は、略四辺形状である撮像素子実装部 2 5 の 4 つの辺のうちの、2 つから 4 つのいずれかの数の辺から延出するように、複数設けられる形態であってもよい。

40

【 0 0 9 2 】

例えば、図 1 2 に第 2 の変形例として示すように、延出部 2 6 は、撮像素子実装部 2 5 の外辺のうちの互いに略平行な 2 辺から延出するように、2 箇所設けられる形態であってもよい。この場合、撮像素子 1 0 の入出力端子部 1 2 b は、図 1 3 に示すように、2 つの屈曲部 2 7 に最も近接し、かつ屈曲部 2 7 と略平行な 2 つの辺 1 0 c に沿って外周に設けられる。このような第 2 の変形例では、屈曲部 2 7 が形成された状態のフレキシブルプリント配線板 2 0 は、略コの字形状となる。

【 0 0 9 3 】

以上に説明した第 1 の変形例及び第 2 の変形例であっても、上述した効果が得られる。

【 0 0 9 4 】


50

なお、本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う内視鏡用撮像ユニットもまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。


【 0 0 9 5 】

本出願は、2013年8月5日に日本国に出願された特願2013-162449号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範囲、図面に引用されたものとする。


【 図 1 】

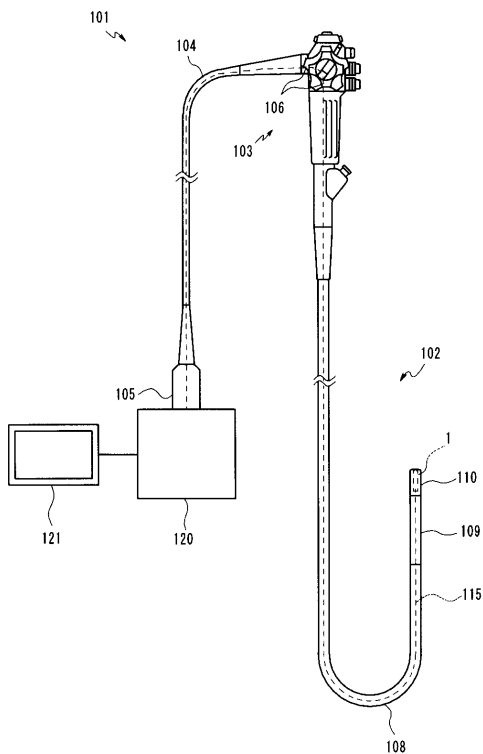


【 図 2 】

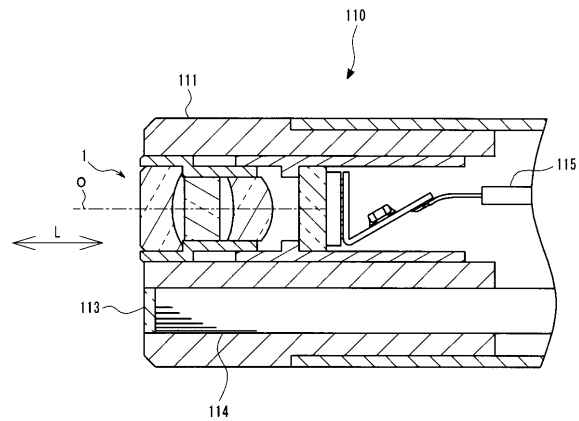


【 図 3 】

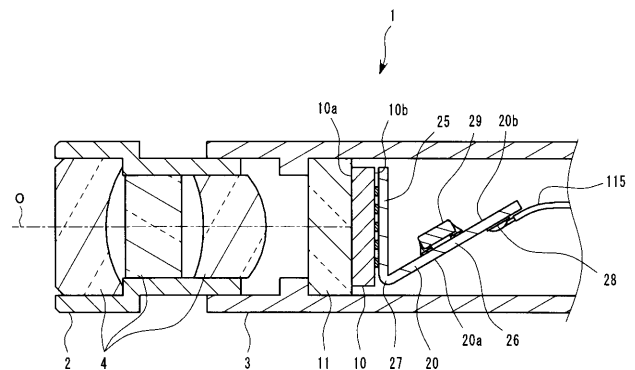


【図 4】

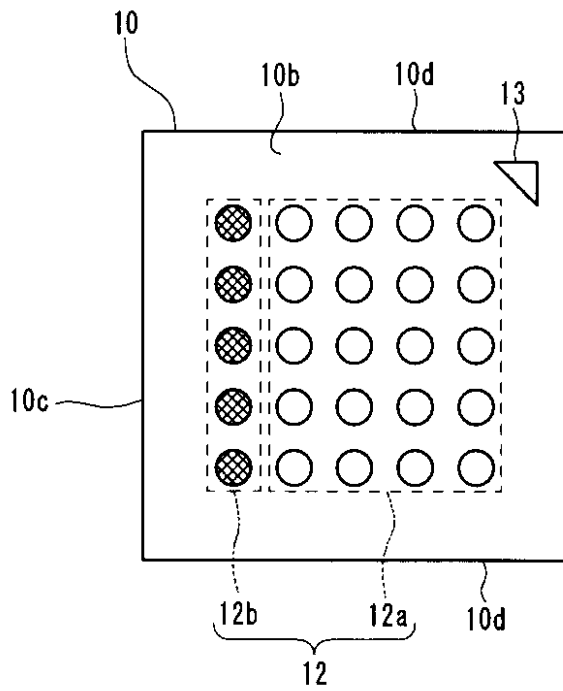


【図 5】

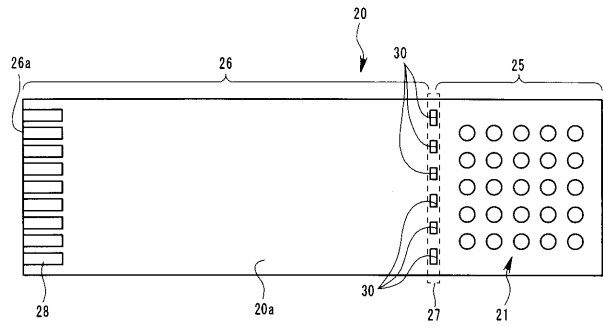


【図 6】

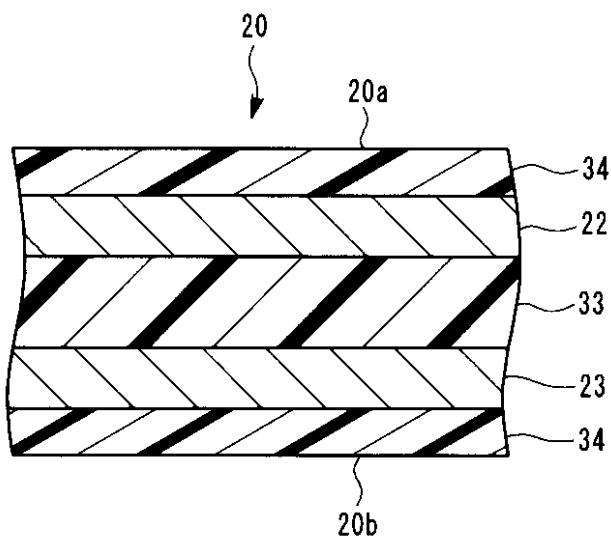


【図 7】

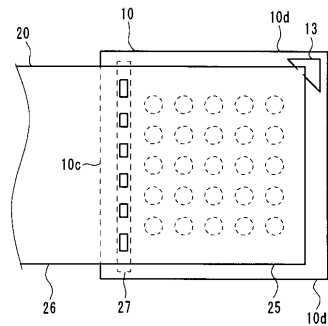


【図 8】

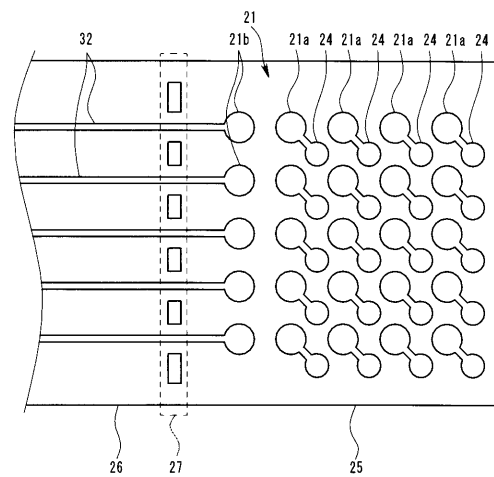


【図 9】

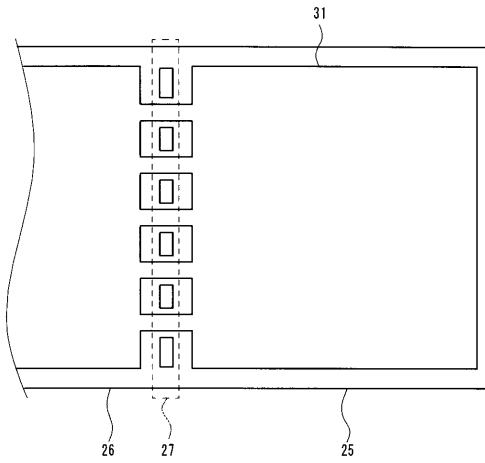


【図 10】

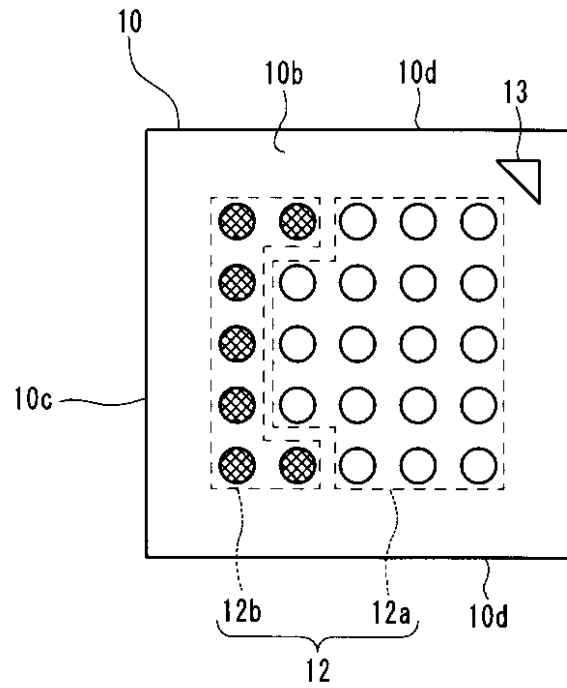


【図 11】

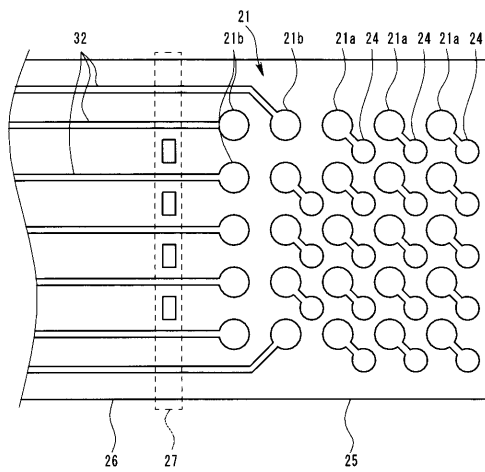

【図 13】

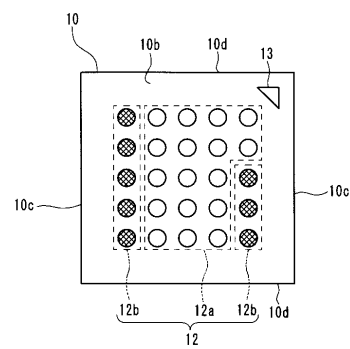

【図 12】

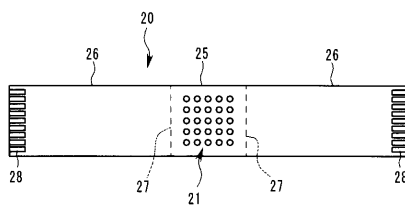

【手続補正書】

【提出日】平成26年12月5日(2014.12.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

本発明の一態様による内視鏡用撮像ユニットは、受光面とは反対側の面である裏面上に配列された複数の接続用端子部を有する撮像素子と、第1面及び前記第1面とは反対の第2面のそれぞれに第1導電層及び第2導電層を含むフレキシブルプリント配線板と、を具備した内視鏡用撮像ユニットであって、前記フレキシブルプリント配線板は、前記複数の接続用端子部と接合されるパッドが形成された第1領域と、電気ケーブルを接続するための外部接続部が形成された第2領域と、前記第1領域と前記第2領域との間に設けられ、当該フレキシブルプリント配線板を前記第2面を内側として屈曲する屈曲部と、前記パッドと前記外部接続部とを電氣的に接続する配線と、を備え、前記パッドは、前記撮像素子をグランドに接続するためのグランドパッドと、前記グランドパッドよりも前記屈曲部に近接して設けられ、前記撮像素子への電圧の入力及び信号の入出力を行うための入出力パッドと、によって構成され、前記配線は、前記入出力パッド及び前記外部接続部を電氣的に接続し、少なくとも前記撮像素子実装部及び前記屈曲部において、前記第1導電層により形成された入出力配線と、前記グランドパッド及び前記外部接続部を電氣的に接続し、少なくとも前記撮像素子実装部及び前記屈曲部において、前記第2導電層により形成されたグランド配線と、によって構成される。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

受光面とは反対側の面である裏面上に配列された複数の接続用端子部を有する撮像素子と、
第1面及び前記第1面とは反対の第2面のそれぞれに第1導電層及び第2導電層を含むフレキシブルプリント配線板と、
を具備した内視鏡用撮像ユニットであって、
前記フレキシブルプリント配線板は、
前記複数の接続用端子部と接合されるパッドが形成された第1領域と、
電気ケーブルを接続するための外部接続部が形成された第2領域と、
前記第1領域と前記第2領域との間に設けられ、当該フレキシブルプリント配線板を前記第2面を内側として屈曲する屈曲部と、
前記パッドと前記外部接続部とを電氣的に接続する配線と、
を備え、
前記パッドは、
前記撮像素子をグランドに接続するためのグランドパッドと、
前記グランドパッドよりも前記屈曲部に近接して設けられ、前記撮像素子への電圧の入力及び信号の入出力を行うための入出力パッドと、
によって構成され、
前記配線は、
前記入出力パッド及び前記外部接続部を電氣的に接続し、少なくとも前記撮像素子実装部及び前記屈曲部において、前記第1導電層により形成された入出力配線と、

前記グランドパッド及び前記外部接続部を電氣的に接続し、少なくとも前記撮像素子実装部及び前記屈曲部において、前記第２導電層により形成されたグランド配線と、
によって構成される
ことを特徴とする内視鏡用撮像ユニット。

【請求項２】

前記撮像素子は、外形が四辺形状であり、

前記屈曲部は、前記撮像素子の４つの外辺のうちの１つ又は複数の所定の辺に沿う直線を折り目としたものであり、

前記入出力パッドは、全ての前記パッドの群の最も外周において、前記撮像素子の前記所定の辺に沿って１列で配置されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用撮像ユニット。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/061889

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61B1/04(2006.01)i, A61B1/00(2006.01)i, G02B23/24(2006.01)i, H04N5/335(2011.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61B1/00-1/32, G02B23/24, H04N5/335

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2014
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2014	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2014

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamIII)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2013-123628 A (Olympus Medical Systems Corp.), 24 June 2013 (24.06.2013), paragraphs [0041] to [0044]; all drawings (Family: none)	1-2
A	JP 63-68128 A (Olympus Optical Co., Ltd.), 28 March 1988 (28.03.1988), page 3, upper left column, lines 5 to 15 (Family: none)	1-2
A	JP 2013-98182 A (Olympus Medical Systems Corp.), 20 May 2013 (20.05.2013), paragraph [0077]; fig. 2 (Family: none)	1-2

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
17 July, 2014 (17.07.14)Date of mailing of the international search report
05 August, 2014 (05.08.14)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 4 / 0 6 1 8 8 9									
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61B1/04(2006.01)i, A61B1/00(2006.01)i, G02B23/24(2006.01)i, H04N5/335(2011.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61B1/00-1/32, G02B23/24, H04N5/335											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2014年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2014年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2014年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2014年	日本国実用新案登録公報	1996-2014年	日本国登録実用新案公報	1994-2014年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2014年										
日本国実用新案登録公報	1996-2014年										
日本国登録実用新案公報	1994-2014年										
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamIII)											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
A	JP 2013-123628 A (オリンパスメディカルシステムズ株式会社) 2013.06.24, 【0041】-【0044】、全図 (ファミリーなし)	1-2									
A	JP 63-68128 A (オリンパス光学工業株式会社) 1988.03.28, 第3頁 左上欄第5-15行 (ファミリーなし)	1-2									
A	JP 2013-98182 A (オリンパスメディカルシステムズ株式会社) 2013.05.20, 【0077】【図2】 (ファミリーなし)	1-2									
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。											
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献											
国際調査を完了した日 17.07.2014		国際調査報告の発送日 05.08.2014									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 野田 洋平 電話番号 03-3581-1101 内線 3292									

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

Fターム(参考) 5C122 DA26 GE11 GE19

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	内窥镜成像装置		
公开(公告)号	JPWO2015019669A1	公开(公告)日	2017-03-02
申请号	JP2014559003	申请日	2014-04-28
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯医疗株式会社		
申请(专利权)人(译)	オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
[标]发明人	永瀬正俊		
发明人	永瀬 正俊		
IPC分类号	A61B1/04 A61B1/00 G02B23/26 H04N5/225		
CPC分类号	G02B23/2484 A61B1/051 H04N5/2253 H04N5/335 H04N2005/2255		
FI分类号	A61B1/04.372 A61B1/00.300.P G02B23/26.D H04N5/225.C		
F-TERM分类号	2H040/GA03 4C161/CC06 4C161/FF40 4C161/FF45 4C161/JJ01 4C161/JJ06 4C161/JJ11 4C161/LL02 4C161/NN01 4C161/PP08 5C122/DA26 5C122/GE11 5C122/GE19		
代理人(译)	伊藤 进 长谷川 靖 ShinoUra修		
优先权	2013162449 2013-08-05 JP		
其他公开文献	JP5722512B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

一种图像拾取装置，在其后表面上具有连接端子部分;图像拾取装置安装部分，其上安装有图像拾取装置;延伸部分，从图像拾取装置安装部分延伸;弯曲部分和具有两个导电层的柔性印刷线路板，其特征在于，在成像中提供用于输入电压并向/从成像元件输入/输出信号的输入/输出垫。连接到输入/输出焊盘的输出焊盘由与输入/输出焊盘相同的导电层形成，并且接地焊盘连接到输入/输出焊盘。

