

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2015-165847

(P2015-165847A)

(43) 公開日 平成27年9月24日(2015.9.24)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 P	2 H 0 4 0
A 6 1 B 1/04 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 Y	2 H 0 4 3
G 0 2 B 23/24 (2006.01)	A 6 1 B 1/04 3 7 2	4 C 1 6 1
G 0 2 B 23/26 (2006.01)	G 0 2 B 23/24 B	
G 0 2 B 7/00 (2006.01)	G 0 2 B 23/26 C	

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 12 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2014-41041 (P2014-41041)
 (22) 出願日 平成26年3月3日 (2014.3.3)

(71) 出願人 000000376
 オリンパス株式会社
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
 (74) 代理人 100089118
 弁理士 酒井 宏明
 (72) 発明者 藤森 紀幸
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
 リンパス株式会社内
 Fターム(参考) 2H040 CA23 CA24 CA25 GA03
 2H043 AB10 AB32
 4C161 FF35 JJ06 PP07


(54) 【発明の名称】 撮像装置、および内視鏡装置

(57) 【要約】

【課題】小型化可能な撮像装置、および内視鏡装置を提供する。

【解決手段】本発明の撮像装置100は、入射光を集光する対物レンズ40a-1~40a-3と、対物レンズ40a-1~40a-3が集光した光を反射させるプリズム51と、プリズム51により反射された光を受光して光電変換を行うことにより電気信号を生成する受光部52を有する撮像素子53と、を備え、プリズム51は受光部52上に実装されるとともに、対物レンズ40a-1~40a-3は撮像素子53表面に直接実装されることを特徴とする。

【選択図】図3B

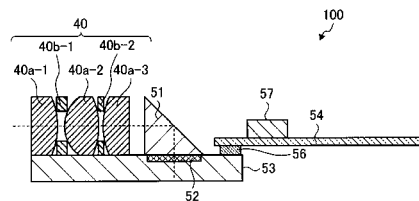

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

入射光を集光するレンズ群と、
前記レンズ群が集光した光を反射させるプリズムと、
前記プリズムにより反射された光を受光して光電変換を行うことにより電気信号を生成する受光部を有する撮像素子と、
を備え、前記プリズムは前記受光部上に実装されるとともに、前記レンズ群は前記撮像素子表面に直接実装されることを特徴とする撮像装置。

【請求項 2】

前記撮像素子と接する前記レンズ群の底面に平面状をなす平坦部が形成されることを特徴とする請求項 1 に記載の撮像装置。

10

【請求項 3】

前記撮像素子の表面上に、前記レンズ群の位置を規定するレンズ位置規定手段を有することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の撮像装置。

【請求項 4】

前記レンズ位置規定手段は、鉛直断面が V 字状をなすシリコンブロックであることを特徴とする請求項 3 に記載の撮像素子。

【請求項 5】

前記レンズ位置規定手段は、前記撮像素子表面に成膜された薄膜に形成された凹部であることを特徴とする請求項 3 に記載の撮像装置。

20

【請求項 6】

前記レンズ位置規定手段は、前記撮像素子表面に形成されたアライメントマークであることを特徴とする請求項 3 に記載の撮像装置。

【請求項 7】

前記レンズ群は、絞り部材および間隔保持部材とともに一体化した部組とされ、前記撮像素子上に前記部組の位置を規定する際、前記部組から入力された画像情報をもとに前記部組の搭載位置を調整することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の撮像装置。

【請求項 8】

生体内に挿入され、生体内を撮像する撮像装置を備えた内視鏡装置において、
前記撮像装置は、請求項 1 ～ 7 のいずれか一つに記載の撮像装置であることを特徴とする内視鏡装置。

30

【請求項 9】

入射光を集光するレンズ群と、
前記レンズ群が集光した光を反射させるプリズムと、
前記プリズムにより反射された光を受光して光電変換を行うことにより電気信号を生成する受光部を有する撮像素子と、
を備える撮像装置が挿入部の先端部に設けられ、前記挿入部を生体内に挿入して生体内情報を取得する内視鏡装置において、
前記撮像素子は前記先端部の構成物によって支持されていることを特徴とする内視鏡装置。

40

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、被検体内に挿入される内視鏡の挿入部の先端に設けられて被検体内を撮像する撮像装置、および該撮像装置を使用した内視鏡装置に関する。

【背景技術】**【0002】**

従来、医療分野および工業分野において、各種検査のために内視鏡装置が広く用いられている。このうち、医療用の内視鏡装置は、患者等の被検体の体腔内に、先端部に撮像装置が内蔵された可撓性を有する細長の挿入部を挿入することによって、被検部位の観察等

50

を行うことができるものであるが、被検体への導入のしやすさを考慮し、挿入部の細径化が求められている。

【 0 0 0 3 】

一般に、内視鏡等に用いられる撮像装置は、金属製の枠部材によって対物光学系としてのレンズ群の外周部を保持し、レンズ群の径方向および光軸方向の位置を規定しているが、挿入部を細径化する技術として、対物光学系の枠部材を保持する部材に光路方向の間隔を設け、この間隔部分の外周面をカットした後、固体撮像素子の上面側に近接配置することにより、高さ寸法を低減した内視鏡用撮像装置が開示されている（たとえば、特許文献 1 および 2 参照）。

【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

【 0 0 0 4 】

【 特許文献 1 】 特開 2 0 0 0 - 2 7 1 0 6 6 号 公 報

【 特許文献 2 】 特開 2 0 0 2 - 4 5 3 3 3 号 公 報

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 5 】

しかしながら、金属加工の限界により金属製の枠部材の肉厚を所定値以下とすることは困難であるため、特許文献 1 および 2 の技術では、対物光学系がさらに小型化された場合、対物光学系の外形寸法に比べ、枠部材の肉厚が相対的に大きくなり、撮像装置の小型化を阻害するおそれがある。また、枠部材の材質として樹脂を用いた場合であっても、枠部材の形成上（例えば、射出成型により枠部材を形成する場合）の限界により、金属製と同様に肉厚が制限され、小型化を阻害する要因となりうるものであった。

【 0 0 0 6 】

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、小型化可能な撮像装置、および内視鏡装置を提供することを目的とする。

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 0 7 】

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる撮像装置は、入射光を集光するレンズ群と、前記レンズ群が集光した光を反射させるプリズムと、前記プリズムにより反射された光を受光して光電変換を行うことにより電気信号を生成する受光部を有する撮像素子と、を備え、前記プリズムは前記受光部上に実装されるとともに、前記レンズ群は前記撮像素子表面に直接実装されることを特徴とする。

【 0 0 0 8 】

また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記撮像素子と接する前記レンズ群の底面に平面状をなす平坦部が形成されることを特徴とする。

【 0 0 0 9 】

また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記撮像素子の表面上に、前記レンズ群の位置を規定するレンズ位置規定手段を有することを特徴とする。

【 0 0 1 0 】

また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記レンズ位置規定手段は、鉛直断面が V 字状をなすシリコンブロックであることを特徴とする。

【 0 0 1 1 】

また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記レンズ位置規定手段は、前記撮像素子表面に成膜された薄膜に形成された凹部であることを特徴とする。

【 0 0 1 2 】

また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記レンズ位置規定手段は、前記撮像素子表面に形成されたアライメントマークであることを特徴とする。

【 0 0 1 3 】

また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記レンズ群は、絞り部材およ

10

20

30

40

50

び間隔保持部材とともに一体化した部組とされ、前記撮像素子上に前記部組の位置を規定する際、前記部組から入力された画像情報をもとに前記部組の搭載位置を調整することを特徴とする。

【0014】

また、本発明の内視鏡装置は、生体内に挿入され、生体内部を撮像する撮像装置を備えた内視鏡装置において、前記撮像装置は、上記のいずれか一つに記載の撮像装置であることを特徴とする。

【0015】

また、本発明の内視鏡装置は、入射光を集光するレンズ群と、前記レンズ群が集光した光を反射させるプリズムと、前記プリズムにより反射された光を受光して光電変換を行うことにより電気信号を生成する受光部を有する撮像素子と、を備える撮像装置が挿入部の先端部に設けられ、前記挿入部を生体内に挿入して生体内情報を取得する内視鏡装置において、前記撮像素子は前記先端部の構成物によって支持されていることを特徴とする。

10

【発明の効果】

【0016】

本発明によれば、レンズ群を撮像素子表面に直接実装することにより、撮像装置の細径化および短小化を図ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】図1は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システムの全体構成を模式的に示す図である。

20

【図2A】図2Aは、図1に示す内視鏡先端の光軸方向と平行な鉛直面での部分断面図である。

【図2B】図2Bは、図1に示す内視鏡先端の前面図である。

【図3A】図3Aは、図2Aに示す撮像装置の斜視図である。

【図3B】図3Bは、図3AのA-A線断面図である。

【図4】図4は、図2Aの撮像装置の製造工程を説明する図である。

【図5A】図5Aは、本実施の形態の変形例1にかかる撮像装置を説明する図である。

【図5B】図5Bは、本実施の形態の変形例2にかかる撮像装置のレンズ位置規定部材を説明する図である。

30

【図5C】図5Cは、本実施の形態の変形例3にかかる撮像装置のレンズ位置規定部材を説明する斜視図である。

【図5D】図5Dは、本実施の形態の変形例4にかかる撮像装置のレンズ位置規定部材を説明する斜視図である。

【図5E】図5Eは、図5DのB-B線断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0018】

以下の説明では、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」という）として、撮像モジュールを備えた内視鏡装置について説明する。また、この実施の形態により、この発明が限定されるものではない。さらに、図面の記載において、同一部分には同一の符号を付している。さらにまた、図面は、模式的なものであり、各部材の厚みと幅との関係、各部材の比率等は、現実と異なることに留意する必要がある。また、図面の相互間においても、互いの寸法や比率が異なる部分が含まれている。

40

【0019】

図1は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システムの全体構成を模式的に示す図である。図1に示すように、内視鏡装置1は、内視鏡2と、ユニバーサルコード6と、コネクタ7と、光源装置9と、プロセッサ（制御装置）10と、表示装置13とを備える。

【0020】

内視鏡2は、挿入部4を被検体の体腔内に挿入することによって、被検体の体内画像を撮像し撮像信号を出力する。ユニバーサルコード6内部の電気ケーブル束は、内視鏡2の

50

挿入部 4 の先端まで延伸され、挿入部 4 の先端部 3 1 に設けられる撮像装置に接続する。

【0021】

コネクタ 7 は、ユニバーサルコード 6 の基端に設けられて、光源装置 9 およびプロセッサ 10 に接続され、ユニバーサルコード 6 と接続する先端部 3 1 の撮像装置が出力する撮像信号に所定の信号処理を施すとともに、撮像信号をアナログデジタル変換 (A/D 変換) して画像信号として出力する。

【0022】

光源装置 9 は、例えば、白色 LED を用いて構成される。光源装置 9 が点灯するパルス状の白色光は、コネクタ 7、ユニバーサルコード 6 を経由して内視鏡 2 の挿入部 4 の先端から被写体へ向けて照射する照明光となる。

10

【0023】

プロセッサ 10 は、コネクタ 7 から出力される画像信号に所定の画像処理を施すとともに、内視鏡装置 1 全体を制御する。表示装置 13 は、プロセッサ 10 が処理を施した画像信号を表示する。

【0024】

内視鏡 2 の挿入部 4 の基端側には、内視鏡機能进行操作する各種ボタン類やノブ類が設けられた操作部 5 が接続される。操作部 5 には、被検体の体腔内に生体鉗子、電気メスおよび検査プローブ等の処置具を挿入する処置具挿入口 17 が設けられる。

【0025】

挿入部 4 は、撮像装置が設けられる先端部 3 1 と、先端部 3 1 の基端側に連設された複数方向に湾曲自在な湾曲部 3 2 と、この湾曲部 3 2 の基端側に連設された可撓管部 3 3 とによって構成される。湾曲部 3 2 内の湾曲管 3 4 は、操作部 5 に設けられた湾曲操作ノブの操作によって湾曲し、挿入部 4 内部に挿通された湾曲ワイヤの牽引弛緩にともない、たとえば上下左右の 4 方向に湾曲自在となっている。

20

【0026】

内視鏡 2 には、光源装置 9 からの照明光を伝送するライトガイド (不図示) が配設され、ライトガイドによる照明光の出射端に照明レンズ (不図示) が配置される。この照明レンズは、挿入部 4 の先端部 3 1 に設けられており、照明光が被検体に向けて照射される。

【0027】

次に、内視鏡 2 の先端部 3 1 の構成について詳細に説明する。図 2 は、内視鏡 2 先端の部分断面図である。図 2 A は、内視鏡 2 の先端部 3 1 に設けられた撮像装置の基板面に対して直交する面であって撮像装置の入射光の光軸方向と平行な面で切断した場合の断面図であり、図 2 B は、内視鏡 2 の先端部 3 1 の前面図である。図 2 A においては、内視鏡 2 の挿入部 4 の先端部 3 1 と、湾曲部 3 2 の一部を図示する。

30

【0028】

図 2 A に示すように、湾曲部 3 2 は、湾曲管 3 4 内部に挿通された湾曲ワイヤの牽引弛緩にともない、上下左右の 4 方向に湾曲自在である。この湾曲部 3 2 の先端側に延設された先端部 3 1 内部の上部に、撮像装置 100 が設けられ、下部には各種処置具を延出させる処置具チャンネル 36 が形成されている。

【0029】

撮像装置 100 は、レンズユニット 40 と、レンズユニット 40 の基端側に配置する撮像ユニット 50 とを有し、接着剤で先端部 3 1 の内側に接着される。先端部 3 1 は、撮像装置 100 を収容する内部空間を形成するための硬質部材で形成される。先端部 3 1 の基端外周部は、図示しない柔軟な被覆管によって被覆されている。先端部 3 1 よりも基端側の部材は、湾曲部 3 2 が湾曲可能なように、柔軟な部材で構成されている。

40

【0030】

レンズユニット 40 は、複数の対物レンズ 40 a - 1 ~ 40 a - 3 と、複数の対物レンズ 40 a - 1 ~ 40 a - 3 の間に配置されるスペーサ 40 b - 1 および 40 b - 2 と、図示しない絞り部材とを有し、この対物レンズ 40 a - 1 およびスペーサ 40 b - 1 の上端が、先端部 3 1 内部の先端固定部 35 に挿嵌固定されることによって、先端部 3 1 に固定

50

される。このとき、撮像素子 5 3 の厚さを薄くすることにより、内視鏡先端の外径を細くすることができるが、撮像素子 5 3 は半導体であり、単結晶シリコン等の脆性材料からなるため、抗折強度が著しく低下する。そこで、本実施の形態では、撮像素子 5 3 が先端固定部 3 5、および処置具チャンネル 3 6 によって支持されており、外部からの応力等によって撮像素子 5 3 が抗折することの無いように補強されている。なお、撮像素子 5 3 の補強は、先端固定部 3 5、処置具チャンネル 3 6 のいずれかによるものでもよく、また、先端部 3 1 の他の構成物によるものでもよい。

【0031】

撮像ユニット 5 0 は、レンズユニット 4 0 の対物レンズ 4 0 a - 1 ~ 4 0 a - 3 から出射された光を反射させるプリズム 5 1、プリズム 5 1 により反射された光を受光して光電変換を行うことにより電気信号を生成する受光部 5 2 を有する撮像素子 5 3 を備える。撮像素子 5 3 は、受光部 5 2 が水平となるように配置される横置き型であり、プリズム 5 1 は受光部 5 2 上に接着されている。撮像素子 5 3 の基端には、信号ケーブル 5 5 が接続されたフレキシブルプリント基板 5 4 が接続されている。フレキシブルプリント基板 5 4 上には、撮像素子 5 3 を駆動する電子部品 5 7 等が実装されている。本発明の実施の形態における撮像素子 5 3 は、C C D (Charge Coupled Device) または C M O S (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 型の半導体撮像素子である。

10

【0032】

信号ケーブル 5 5 の基端は、挿入部 4 の基端方向に延伸する。信号ケーブル 5 5 は、挿入部 4 に挿通配置され、図 1 に示す操作部 5 およびユニバーサルコード 6 を介して、コネクタ 7 まで延設されている。

20

【0033】

先端部 3 1 に入射した光は、対物レンズ 4 0 a - 1 ~ 4 0 a - 3 によって集光され、プリズム 5 1 に入射する。受光部 5 2 は、プリズム 5 1 から照射された光を受光し、受光した光を撮像信号に変換する。撮像信号は、フレキシブルプリント基板 5 4 に接続される信号ケーブル 5 5 およびコネクタ 7 を経由して、プロセッサ 1 0 に出力される。本明細書において、先端部 3 1 の光が入射する側、すなわち対物レンズ 4 0 a - 1 ~ 4 0 a - 3 が配置される側を前端部といい、プリズム 5 1 が配置される側を後端部という。

【0034】

先端固定部 3 5 の内壁面と接する撮像素子 5 3 の側面は、図 2 B に示すように、接着剤で先端固定部 3 5 の内壁面に接着され、撮像素子 5 3 上のプリズム 5 1 の組み付け位置の後端側は、封止樹脂 6 7 により封止されている。

30

【0035】

次に、本実施の形態にかかる撮像装置 1 0 0 について説明する。図 3 A は、図 2 A に示す撮像装置 1 0 0 の斜視図である。図 3 B は、図 3 A の A - A 線断面図である。

【0036】

図 3 A および図 3 B に示すように、本実施の形態にかかる撮像装置 1 0 0 において、対物レンズ 4 0 a - 1 ~ 4 0 a - 3 は、その外周が撮像素子 5 3 表面に直接実装されている。対物レンズ 4 0 a - 1 ~ 4 0 a - 3、およびプリズム 5 1 により撮像光学系が構成され、該撮像光学系により撮像素子 5 3 の受光部 5 2 上に被写体像が結像される。

40

【0037】

撮像素子 5 3 の後端部側には、フレキシブルプリント基板 5 4 を接続する撮像素子電極 5 6 が形成されている。

【0038】

本実施の形態にかかる撮像装置 1 0 0 では、スペーサ 4 0 b - 1 および 4 0 b - 2 により対物レンズ 4 0 a - 1 ~ 4 0 a - 3 間の間隔を調整し、位置を規定するが、スペーサ 4 0 b - 1 および 4 0 b - 2 の光軸方向の厚さは、対物レンズ 4 0 a - 1 ~ 4 0 a - 3 に比べて薄いため、対物レンズ 4 0 a - 1 ~ 4 0 a - 3 のいずれかと一体化されることが好ましい。例えば、対物レンズ 4 0 a - 3 とスペーサ 4 0 b - 2、対物レンズ 4 0 a - 2 とスペーサ 4 0 b - 1 とを一体化し、一体化されたパーツ毎に撮像素子 5 3 の所定位置に搭載

50

することが好ましい。図示しない絞り部材もスペーサ 40b - 1 および 40b - 2 と同様に、対物レンズ 40a - 1 ~ 40a - 3 のいずれかと一体化されることが好ましい。対物レンズとスペーサの一体化は、載置されたスペーサ上に、治具により保持された対物レンズを移動させ、画像処理により位置合わせをした後、接着剤により接着して一体化することができる。あるいは、対物レンズの片面に、スペーサとなる金属皮膜を所望の厚さに形成した後、入射光の光路をエッチング等により形成して、スペーサが一体化された対物レンズとしてもよい。

【0039】

このように撮像光学系は、撮像素子 53 の表面へと画像処理による受動的な位置合わせを行うことができる（いわゆるパッシブアライメント）。さらに、より高精度に撮像素子 53 上にアライメントするためには、対物レンズ 40a - 1 ~ 40a - 3、スペーサ 40b - 1 および 40b - 2 ならびに絞り部材からなるレンズユニット 40 を 1 つの部組として一体化した後、撮像素子 53 の画像出力を確認しながら部組の位置を調整して能動的にアライメントする、いわゆるアクティブアライメントを行うことが好ましい。

【0040】

レンズユニット 40 は、対物レンズ 40a - 1 ~ 40a - 3 またはスペーサ 40b - 1 および 40b - 2 の接続面に予め接着剤を塗布しておき、一体化用の枠部材中に、例えば、対物レンズ 40a - 3、スペーサ 40b - 2、対物レンズ 40a - 2、スペーサ 40b - 1、対物レンズ 40a - 1 等の順番に落とし込み、接着剤を硬化させた後、枠部材からレンズユニット 40 を取り出すことで一体化することができる。

【0041】

一体化されたレンズユニット 40 は、吸着機能を有する治具 58 等に保持され、受光部 52 上にプリズム 51 が予め接続された撮像素子 53 上に載置される。図 4 は、撮像装置 100 の製造工程を説明する図である。まず、図 4 (a) に示すように、一体化されたレンズユニット 40 は、治具 58 により保持された状態で、撮像素子 53 上に載置される。図 4 (b) に示すように、レンズユニット 40 が治具 58 に保持された状態で、テストチャート 59 が撮像され、その画像はレンズユニット 40 を通じて受光部 52 へと入力される。受光部 52 により電気信号に変換された画像データは、プローブ 60 を撮像素子電極 56 に当接することにより、モニタ 61 に出力される。このモニタ 61 に出力された画像にもとづいてレンズユニット 40 の位置を調整することにより、アクティブアライメントを行えばよい。アクティブアライメントは、画像データをモニタ 61 等に出力することなく、ソフトウェア等による解析にもとづいてレンズユニット 40 の位置を調整してもよい。レンズユニット 40 のアライメントは、撮像素子 53 上で行われるため、前後および左右の位置調整のみならず、チルト角の調整も可能で、高精度に位置を規定することができる。

【0042】

上記のようにして、レンズユニット 40 を撮像素子 53 上に直接アライメントした後、あらかじめ対物レンズ 40a - 1 ~ 40a - 3 等の撮像素子 53 との接続部分に塗布しておいた接着剤を硬化することにより、レンズユニット 40 を撮像素子 53 表面上に接続することができる。なお、本明細書において、撮像素子 53 の表面とは、撮像素子 53 本体部を構成するシリコン表面のほか、該シリコン表面に画素やカラーフィルタ等の薄膜表面を含むものとする。

【0043】

本実施の形態にかかる撮像装置 100 は、枠部材を使用することなく対物レンズ 40a - 1 ~ 40a - 3 を撮像素子 53 に直接実装することができるため、撮像装置 100 を小型化することができる。また、レンズユニット 40 の実装位置を、アクティブアライメントにより規定するため、より高精度に撮像光学系の位置を規定することが可能となる。

【0044】

また、対物レンズ 40a - 1 ~ 40a - 3 の撮像素子 53 へのアライメントを容易にするために、撮像素子 53 と接する対物レンズ 40a - 1 ~ 40a - 3 の側面部分に平坦部

10

20

30

40

50

40c-1~40c-3を形成してもよい。図5Aは、本実施の形態の変形例1にかかる撮像装置を説明する図である。平坦部40c-1~40c-3(平坦部40c-2および40c-3は図示せず)は、平面上をなし、対物レンズ40a-1~40a-3の側面部分を切除することにより形成可能である。平坦部40c-1~40c-3を形成することにより、撮像素子53の表面との接触面積が増加するため、簡易、かつ安定的に対物レンズ40a-1~40a-3の位置を規定することができる。なお、平坦部40c-1~40c-3を設けることにより、対物レンズ40a-1~40a-3をスペーサ40b-1、40b-2とともに一体化した場合にも、簡易かつ安定してレンズユニット40の位置を規定することができる。

【0045】

さらに、撮像素子53上に、対物レンズ40a-1~40a-3の位置を規定するレンズ位置規定部材62を設けてもよい。図5Bは、本実施の形態の変形例2にかかる撮像装置を説明する図である。レンズ位置規定部材62は、シリコンブロックからなり、鉛直断面がV字状をなす溝部63を有する。レンズ位置規定部材62は、板状のシリコンブロックを撮像素子53表面に接着し、接着したシリコンブロックをエッチングすることにより、V字状の溝部63を形成することができる。レンズ位置規定部材62は、スペーサ40b-1、40b-2を含んだレンズユニット40の光軸方向の長さと同程度、またはそれ以上の長さのレンズ位置規定部材を形成して、1のレンズ位置規定部材62により、一体化したレンズユニット40の位置を規定してもよい。あるいは、対物レンズ40a-1~40a-3を載置する位置に、対物レンズ40a-1~40a-3に対応したレンズ位置規定部材を複数形成して、対物レンズ40a-1~40a-3毎に位置を規定してもよい。

【0046】

さらにまた、撮像素子53上に形成するレンズ位置規定手段は、アライメントマークであってもよい。図5Cは、本実施の形態の変形例3にかかる撮像装置100Cを説明する斜視図である。アライメントマーク64a-1~64a-3は、フォトリソグラフィ等により撮像素子53C上に形成され、対物レンズ40a-1~40a-3の接続位置に対応するように設けられる。対物レンズ40a-1~40a-3は、個々に治具等により上部側面を吸着された状態で、対応するアライメントマーク64a-1~64a-3に移動され、上部から対物レンズ40a-1~40a-3とレンズ位置規定部材64a-1~64a-3との位置をカメラ等により確認しながら、受動的に位置調整が行われた後に撮像素子53上に固定される。変形例3で用いる対物レンズ40a-1~40a-3は、平坦部40c-1~40c-3が形成されたものであってもよい。

【0047】

また、撮像素子上に形成するレンズ位置規定手段は、撮像素子表面に形成されたカラーフィルタ等の薄膜に形成された凹部であってもよい。図5Dは、本実施の形態の変形例4にかかる撮像装置100Dのレンズ位置規定手段を説明する斜視図である。図5Eは、図5DのB-B線断面図である。

【0048】

凹部65a-1~65a-3は、薄膜66をエッチングすることにより形成される。一般に、撮像素子53D表面に形成されるカラーフィルタ等の薄膜66は、その厚さが10μm程度であるが、対物レンズ40a-1~40a-3の接続位置の薄膜66を、エッチングにより一部除去して凹部65a-1~65a-3を形成する。深さが薄膜66の厚み程度の凹部であっても、図5Eに示すように、凹部65a-1~65a-3に対物レンズ40a-1~40a-3を嵌め合わせることで、その位置を受動的に規定することが可能となる。

【0049】

なお、変形例3および4では、対物レンズ40a-1の前端面は、撮像素子の前端側面より後ろに位置しているが、対物レンズ40a-1は、接続される撮像素子表面が視野角内に入らない位置に実装されることが好ましい。また、その他の例では、対物レンズ40

10

20

30

40

50


a - 1 の前端面を撮像素子の前端側面に合わせているが、対物レンズ 4 0 a - 1 の前端面を、撮像素子の前端側面より前に配置することにより、内視鏡装置等の先端部内に挿入され、先端固定部に挿嵌固定された際、内部の液密の保持が容易となる。

【符号の説明】


【 0 0 5 0 】

1	内視鏡装置	
2	内視鏡	
4	挿入部	
5	操作部	
6	ユニバーサルコード	10
7	コネクタ	
9	光源装置	
1 0	プロセッサ	
1 3	表示装置	
1 7	処置具挿入口	
3 1	先端部	
3 2	湾曲部	
3 3	可撓管部	
3 4	湾曲管	
3 5	先端固定部	20
3 6	処置具チャンネル	
4 0	レンズユニット	
4 0 a - 1 ~ 4 0 a - 3	対物レンズ	
4 0 b - 1、4 0 - b - 2	スペーサ	
4 0 c - 1 ~ 4 0 c - 3	平坦部	
5 0	撮像ユニット	
5 1	プリズム	
5 2	受光部	
5 3、5 3 C、5 3 D	撮像素子	
5 4	フレキシブルプリント基板	30
5 5	信号ケーブル	
5 6	撮像素子電極	
5 7	電子部品	
5 8	治具	
5 9	テストチャート	
6 0	プローブ	
6 1	モニタ	
6 2	レンズ位置規定部材	
6 4 a - 1 ~ 6 4 a - 3	アライメントマーク	
6 5 a - 1 ~ 6 5 a - 3	凹部	40
6 3	溝部	
6 6	薄膜	
6 7	封止樹脂	
1 0 0、1 0 0 C、1 0 0 D	撮像装置	


【図 1】

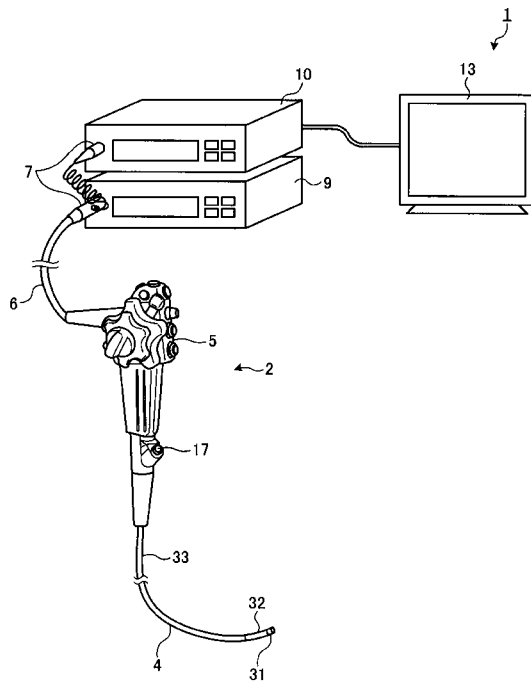


【図 2 A】

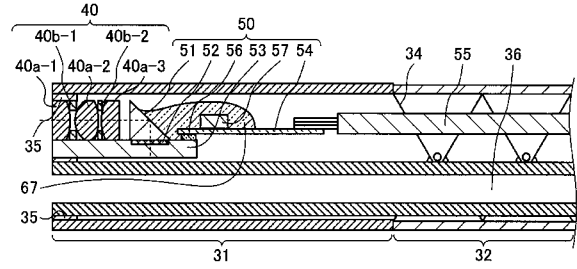


【図 2 B】




【図 3 A】

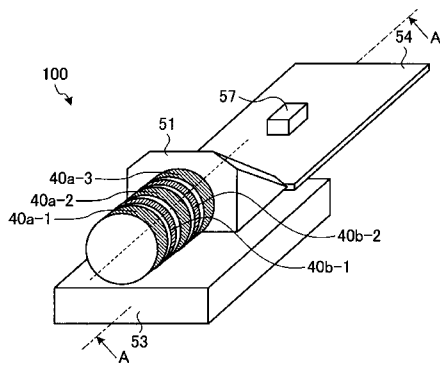


【図 3 B】

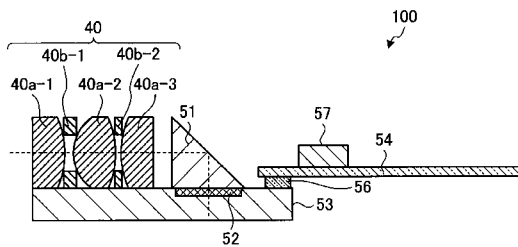


【図 4】

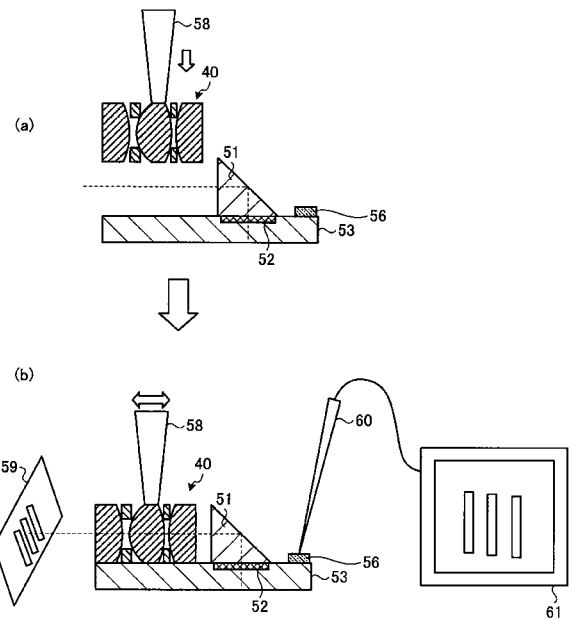


【図 5 A】

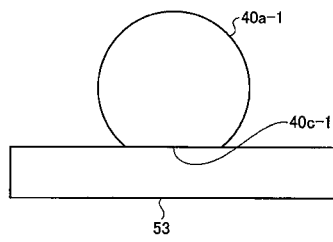


【図 5 B】

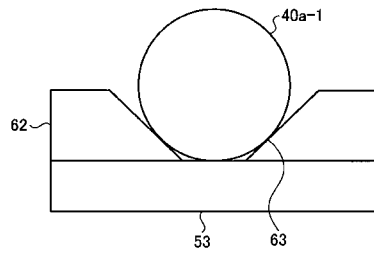


【図 5 E】

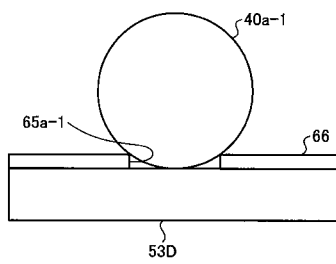

【図 5 C】

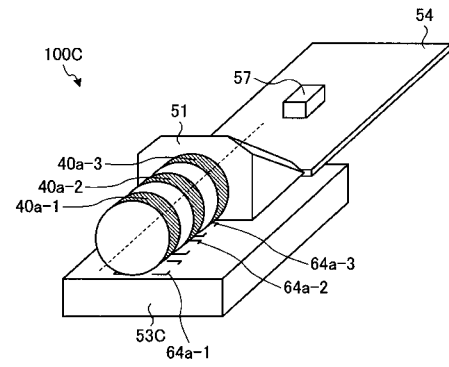

【図 5 D】

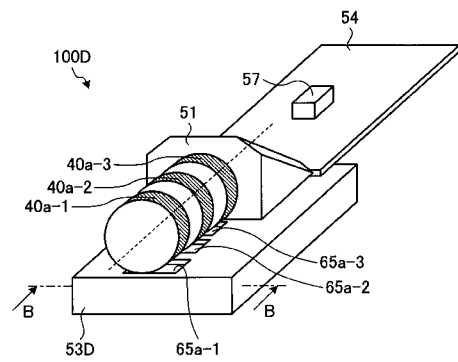

フロントページの続き

(51) Int.Cl.

F I

テーマコード (参考)

G 0 2 B 7/00

J

G 0 2 B 7/00

B

专利名称(译)	成像设备和内窥镜设备		
公开(公告)号	JP2015165847A	公开(公告)日	2015-09-24
申请号	JP2014041041	申请日	2014-03-03
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	藤森紀幸		
发明人	藤森 紀幸		
IPC分类号	A61B1/00 A61B1/04 G02B23/24 G02B23/26 G02B7/00		
CPC分类号	A61B1/00096 A61B1/051 G02B23/02 G02B23/2423 G02B23/243 G02B23/2469 G02B27/62 H04N2005/2255 A61B1/00163 A61B1/05 H04N5/2256		
FI分类号	A61B1/00.300.P A61B1/00.300.Y A61B1/04.372 G02B23/24.B G02B23/26.C G02B7/00.J G02B7/00.B A61B1/00.715 A61B1/00.731 A61B1/04.530 A61B1/05		
F-TERM分类号	2H040/CA23 2H040/CA24 2H040/CA25 2H040/GA03 2H043/AB10 2H043/AB32 4C161/FF35 4C161/JJ06 4C161/PP07		
代理人(译)	酒井宏明		
其他公开文献	JP2015165847A5 JP6329394B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)	(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2014-41041 (P2014-41041) 平成26年3月3日 (2014.3.3)	(71) 出願人 000000376 オリンパス株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号 (74) 代理人 100089118 弁理士 酒井 宏明 (72) 発明者 藤森 紀幸 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号 オ リンパス株式会社内 Fターム(参考) 2H040 CA23 CA24 CA25 GA03 2H043 AB10 AB32 4C161 FF35 JJ06 PP07
-------	-----------------------	--	--