

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-205606

(P2012-205606A)

(43) 公開日 平成24年10月25日(2012.10.25)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 18/12 (2006.01)	A 6 1 B 17/39	4 C 1 6 0
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 J	4 C 1 6 1
	A 6 1 B 1/00 3 3 4 D	

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号	特願2011-71271 (P2011-71271)	(71) 出願人	000229117
(22) 出願日	平成23年3月29日 (2011. 3. 29)		日本ゼオン株式会社
			東京都千代田区丸の内一丁目6番2号
		(71) 出願人	597089576
			有限会社リバー精工
			長野県岡谷市川岸上二丁目29番20号
		(74) 代理人	100112427
			弁理士 藤本 芳洋
		(72) 発明者	南辻 睦
			東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 日
			本ゼオン株式会社内
		(72) 発明者	杉谷 電朗
			東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 日
			本ゼオン株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 内視鏡用高周波処置具

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 内視鏡用高周波処置具の操作性向上。

【解決手段】 絶縁性のアウターシース11内には導電性のインナーシース12が挿通され、インナーシース12内にはその周囲に絶縁性の被覆を有する導電性の駆動ワイヤー13が挿通されている。駆動ワイヤー13の遠位端に取り付けられた絶縁性の電極支持部材33には、互いに略ハの字状に開脚した状態で弾性を有する第1および第2脚部材31, 32が取り付けられており、第1および第2脚部材31, 32はインナーシース12の遠位端の内側に内没されることにより閉脚する。インナーシースはアウターシース内に挿通されているから、円滑にスライド動作および回転動作を行うことができ、スライド量の不足や応答の遅れが少ないので、高い操作性を実現することができる。

【選択図】 図7

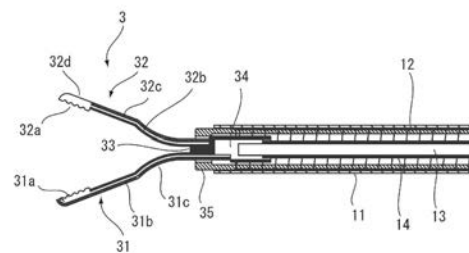

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

絶縁性のアウターシースと、
前記アウターシースに挿通された導電性のインナーシースと、
前記インナーシースに挿通され、その周囲に絶縁性の被覆を有する導電性の駆動ワイヤーと、

前記アウターシースの近位端に接続されたアウター受けと、
前記駆動ワイヤーの近位端が接続され、前記アウター受けにスライド可能および回転可能に保持されたスライダーと、

前記インナーシースの近位端に接続され、前記スライダーにスライド可能に保持されたベースと、

前記駆動ワイヤーの遠位端に取り付けられた絶縁性の電極支持部材と、
互いに略ハの字状に開脚した状態で前記電極支持部材に取り付けられ、前記インナーシースの遠位端の内側に内没されることにより閉脚する、弾性を有する第 1 脚部材および第 2 脚部材とを備え、

前記第 1 脚部材は、その先端部近傍の前記第 2 脚部材に対向する部分に前記駆動ワイヤーに電氣的に導通された第 1 電極部を有するとともに、前記インナーシースの遠位端との相対位置にかかわらず該インナーシースから絶縁されるように絶縁被覆部を有し、

前記第 2 脚部材は、その先端部近傍の前記第 1 脚部材に対向する部分に前記駆動ワイヤーから電氣的に絶縁された第 2 電極部を有するとともに、前記閉脚時に前記インナーシースの遠位端に接触して該第 2 電極部を該インナーシースに電氣的に導通させる導通部を有することを特徴とする内視鏡用高周波処置具。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、内視鏡を利用して高周波電流により止血等の処置を行う内視鏡用高周波処置具に関する。

【背景技術】

【0002】

内視鏡用高周波処置具としての例えばバイポーラ止血鉗子は、内視鏡の処置具案内管に通されるシースの先端に配置された一対の高周波電極の開閉を、シースの後端に設けられた操作部により操作し、該高周波電極で血管等の生体組織を把持した状態で高周波電流を流すことにより、該把持部近傍の組織を焼灼凝固させ、止血を行うために用いられる装置である。電極は目的とする生体組織に対する位置決めのため、シースの軸線周りに回転できる必要があり、また電極に対する高周波電流の供給のため、往復で 2 本の配線が必要である。

【0003】

このようなバイポーラ止血鉗子としては、例えば、特許文献 1 および特許文献 2 に記載のように、それぞれ先端に電極を有する一対の弾性開閉部材を、シースに挿通された筒状可撓軸の先端に略ハの字状に開脚させて配置し、該筒状可撓軸をシース内でスライドさせて、該弾性開閉部材をシース内に引き込むことによって閉脚させ、押し出すことによって開脚させるようにしたものが知られている。また、各電極への通電は、筒状可撓軸内に互いに絶縁された一対の導電線を通し、それぞれの遠位端を対応する電極に電氣的に導通させることにより行っている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】特許 3 9 6 7 5 6 0 号公報

【特許文献 2】特許 4 4 9 5 3 5 4 号公報

【特許文献 3】特開 2 0 0 9 - 1 4 2 5 1 3 号公報

10

20

30

40

50

【特許文献4】特開2010-68981号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、特許文献1および特許文献2に記載の技術では、弾性開閉部材を閉脚させる際には、該弾性開閉部材をシース内に引き込むことにより、行うようにしており、必然的に、弾性開閉部材の位置がその引き込んだ分だけ移動（後退）するので、目的組織を把持する際に、この移動量を考慮して操作する必要があり、操作性が悪い。なお、弾性開閉部材に対してシースを押し出すように操作すれば、弾性開閉部材の位置は移動しないので、そのような問題は生じないが、シースは生体内で適宜に湾曲された状態の内視鏡の処

10

【0006】

ところで、一对の電極のそれぞれをシースの遠位端に回転可能に軸支し、各電極を一对のワイヤーを介して操作部にそれぞれ接続し、一对のワイヤーのスライド操作により、一对の電極の双方を回転させて開閉させるようにした技術として、特許文献3および特許文

20

【0007】

これらの特許文献3および特許文献4に記載の技術は、電極に高周波電流を供給するための一对の電線（ワイヤー）の一方を回転伝達性の高いトルクワイヤーとする技術を用いているため、回転操作性を向上できる可能性がある。

【0008】

しかしながら、特許文献3および4に記載のものでは、比較的に大径のトルクワイヤーに比較的に小径の非トルクワイヤーを巻き付け、あるいは並設した構成であるので、一方のワイヤー（トルクワイヤー）による回転力の伝達を他方のワイヤー（非トルクワイヤー）が阻害し、電極のシース軸線周りの回転操作の応答性（操作部における回転操作に対する電極回転の追従性）が不十分であるとともに、シースの湾曲の状態によってこの応答性が変化するため、やはり操作性が悪いという問題がある。

30

【0009】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、操作性の向上を図ることができる内視鏡用高周波処置具を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明に係る内視鏡用高周波処置具は、絶縁性のアウターシースと、前記アウターシースに挿通された導電性のインナーシースと、前記インナーシースに挿通され、その周囲に絶縁性の被覆を有する導電性の駆動ワイヤーと、前記アウターシースの近位端に接続されたアウター受けと、前記駆動ワイヤーの近位端が接続され、前記アウター受けにスライド可能および回転可能に保持されたスライダと、前記インナーシースの近位端に接続され、前記スライダにスライド可能に保持されたベースと、前記駆動ワイヤーの遠位端に取り付けられた絶縁性の電極支持部材と、互いに略八の字状に開脚した状態で前記電極支持部材に取り付けられ、前記インナーシースの遠位端の内側に内没されることにより閉脚する、弾性を有する第1脚部材および第2脚部材とを備え、前記第1脚部材は、その先端部近傍の前記第2脚部材に対向する部分に前記駆動ワイヤーに電氣的に導通された第1電極

40

50

部を有するとともに、前記インナーシースの遠位端との相対位置にかかわらず該インナーシースから絶縁されるように絶縁被覆部を有し、前記第２脚部材は、その先端部近傍の前記第１脚部材に対向する部分に前記駆動ワイヤーから電氣的に絶縁された第２電極部を有するとともに、前記閉脚時に前記インナーシースの遠位端に接触して該第２電極部を該インナーシースに電氣的に導通させる導通部を有する。

【発明の効果】

【００１１】

本発明の内視鏡用高周波処置具では、駆動ワイヤーに対してインナーシースが押し出されるように、スライダー部に対してベース部をスライドさせることによって、第１脚部材および第２脚部材を閉脚することができ、インナーシースはアウターシース内に挿通されているから、円滑にスライド動作および回転動作を行うことができ、スライド量の不足や応答の遅れが少ないので、高い操作性を実現することができる。また、高周波回路は駆動ワイヤー、第１脚部材の第１電極部、第２脚部材の第２電極部、およびインナーシースによって形成され、従来技術のような専用の電線によって給電する構成のものと比較して、その構成を簡略化することができる。さらに、従来のような電線がないため、駆動ワイヤーはそのような電線から干渉を受けることがなく、インナーシース内で回転でき、駆動ワイヤーによる回転力の伝達がそのような電線によって阻害されることはない。従って、電極の回転操作の応答性（操作部における回転操作に対する電極回転の追従性）を向上することができるとともに、シースの湾曲の状態による応答性の変化も少なくなり、高い操作性を実現することができる。

10

20

【図面の簡単な説明】

【００１２】

【図１】本発明の実施形態の内視鏡用高周波処置具の全体構成を示す平面図である。

【図２】図１のＡ－Ａ線に沿った断面図である。

【図３】本発明の実施形態の内視鏡用高周波処置具の操作部の構成を示す斜視図である。

【図４】本発明の実施形態の内視鏡用高周波処置具の操作部の構成を示す切断斜視図である。

【図５】本発明の実施形態の内視鏡用高周波処置具の遠位端近傍の構成を示しており、第１脚部および第２脚部を開脚した状態を示す平面図である。

【図６】本発明の実施形態の内視鏡用高周波処置具の遠位端近傍の構成を示しており、第１脚部および第２脚部を開脚した状態を示す側面図である。

30

【図７】図６のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。

【図８】本発明の実施形態の内視鏡用高周波処置具の遠位端近傍の構成を示しており、第１脚部および第２脚部を閉脚した状態を示す平面図である。

【図９】本発明の実施形態の内視鏡用高周波処置具の遠位端近傍の構成を示しており、第１脚部および第２脚部を閉脚した状態を示す側面図である。

【図１０】図９のＣ－Ｃ線に沿った断面図である。

【図１１】本発明の実施形態の内視鏡用高周波処置具の遠位端近傍の構成を示しており、アウターシース内に第１脚部および第２脚部を収納した状態を示す平面図である。

【図１２】本発明の実施形態の内視鏡用高周波処置具の操作部の構成を示す断面図であり、第１脚部および第２脚部を開脚する場合を示している。

40

【図１３】本発明の実施形態の内視鏡用高周波処置具の操作部の構成を示す断面図であり、第１脚部および第２脚部をアウターシース内に収納する場合を示している。

【図１４】本発明の実施形態の内視鏡用高周波処置具の操作部の構成を示す断面図であり、第１脚部および第２脚部を閉脚する場合を示している。

【発明を実施するための形態】

【００１３】

以下、本発明の実施形態に係る内視鏡用高周波処置具としてのバイポーラ止血鉗子について、図面を参照して具体的に説明する。但し、本発明はバイポーラ止血鉗子には限定されず、開閉可能な一対の高周波電極を備える切開用バイポーラ挟鉗子等にも適用可能であ

50

る。なお、以下では、便宜的に、後述するアウター受け 2 3、スライダー 2 2、ベース 2 1 が互いに対してスライドする方向をスライド方向ということがある。

【0014】

図 1 に示すように、本実施形態のバイポーラ止血鉗子は、シース部 1、操作部 2 および鉗子部 3 を概略備えて構成されている。シース部 1 の近位端に操作部 2 が設けられ、シース部 1 の遠位端に鉗子部（把持部）3 が設けられている。

【0015】

操作部 2 はベース 2 1 および該ベース 2 1 にスライド可能に取り付けられたスライダー 2 2 を備え、鉗子部 3 は略ハの字状に配置された一对の脚部（第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2）を有し、第 1 脚部 3 1 はその先端部内側に第 1 電極部 3 1 a を、第 2 脚部 3 2 はその先端部内側に第 2 電極部 3 2 a を有している。操作部 2 において、スライダー 2 2 に対してベース 2 1 を引き出す側（図 1 において上側）にスライドさせることにより鉗子部 3（第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2）を開くことができ、逆にスライダー 2 2 に対してベース 2 1 を押し入れる側（図 1 において下側）にスライドさせることにより鉗子部 3 を閉じることができるようになっている。また、操作部 2 は、一对の電線（ケーブル）2 4 a, 2 4 b およびその先端に設けられたプラグ 2 4 を備えており、これらの電線 2 4 a, 2 4 b がプラグ 2 4 を介して、図外の高周波電源装置と電氣的に接続され、高周波電流の供給を受けるようになっている。後に詳述するように、電線 2 4 a は第 1 電極部 3 1 a に電氣的に接続され、電線 2 4 b は第 2 電極部 3 2 a に電氣的に接続される。

【0016】

シース部 1 は、図 2 に示されているように、チューブ状のアウターシース 1 1、同じくチューブ状のインナーシース 1 2、および駆動ワイヤー 1 3 を備えている。アウターシース 1 1 は可撓性を有する中空チューブからなり、本実施形態では絶縁性の樹脂から形成されたチューブを用いている。アウターシース 1 1 を形成する樹脂材料としては、電気絶縁材料が好ましく、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、フッ素樹脂等を用いることができる。

【0017】

インナーシース 1 2 は可撓性を有する中空チューブからなり、本実施形態では導電性のコイルチューブを用いている。コイルチューブとしては、金属（ステンレス）等からなる長尺平板を螺旋状に巻回してなる平線コイルチューブを用いることができる。但し、丸線コイルチューブまたは内面平コイルチューブを用いてもよい。インナーシース 1 2 としては、ワイヤーチューブを用いてもよい。ワイヤーチューブは、例えば金属（ステンレス）等からなる複数本のワイヤー（ケーブル）を中空となるように螺旋状に撚ってなる中空撚り線からなるチューブである。インナーシース 1 2 としては、主としてワイヤーチューブを用い、その先端側の一部のみをコイルチューブとしたものを用いてもよい。

【0018】

駆動ワイヤー 1 3 はインナーシース 1 2 内に挿通され、インナーシース 1 2 はアウターシース 1 1 内に挿通されている。駆動ワイヤー 1 3 はインナーシース 1 2 内でその軸線周りの回転および摺動（軸線方向に沿う方向のスライド移動）が可能となっている。

【0019】

駆動ワイヤー 1 3 は可撓性および導電性を有するワイヤー（トルクワイヤー）からなり、駆動ワイヤー 1 3 としては、ステンレス等の金属からなる単一の線材を用いることができる。但し、駆動ワイヤー 1 3 としては、ワイヤーロープやワイヤーチューブを用いてもよい。ここで、ワイヤーチューブは、インナーシース 1 2 について説明したものと同様のものを用いることができる。また、ワイヤーロープは、ステンレス等の金属からなる複数本のワイヤーを中空となるように螺旋状に撚ってなる中空撚り線からなるチューブである。駆動ワイヤー 1 3 は鉗子部 3 を開閉するためのスライド力を伝達し、および鉗子部 3 をその姿勢調整のためにシース軸線周りに回転させる回転力を伝達する動力伝達部材として機能するものである。また、その詳細は後述するが、駆動ワイヤー 1 3 の近位端は操作部

2の電線24aに電氣的に接続されており、遠位端は第1脚部31の第1電極部31aに電氣的に接続されることにより、高周波回路を形成する導電部材(導電線)として機能するものである。駆動ワイヤー12の周囲には、インナーシース12から電氣的に絶縁するための絶縁性の樹脂からなる絶縁被覆部14が形成されている。

【0020】

インナーシース12は、鉗子部3の開閉のためのスライド力を伝達する動力伝達部材として機能するものである。また、詳細は後述するが、インナーシース12の近位端は操作部2の電線24bに電氣的に接続されており、遠位端は鉗子部3の閉脚時に第2脚部32の第2電極部32aに電氣的に接続されることにより、高周波回路を形成する導電部材(導電線)として機能するものである。

10

【0021】

操作部2の具体的構成は、図3および図4に示されている。ベース21、スライダー22およびアウター受け23は、主として絶縁性の樹脂から形成されている。アウターシース11の近位端はアウター受け23の先端部に接続されている。アウターシース11は、その軸線周りに回転可能となるようにアウター受け23に支持されているとともに、アウター受け23がスライド方向にスライドされた場合には一体的にスライドするようにアウター受け23に支持されている。

【0022】

アウター受け23は、略円筒状の部材からなり、その基端部側には一対のバネ収容部が設けられ、該一対のバネ収容部内に板バネ23aがそれぞれ収容されている。アウター受け23は、互いに略相対する形状を有する半割部材からなり、適宜に配置された複数の嵌合穴およびこれらに嵌合する複数の嵌合突起が互いに嵌合することにより一体化されるようになっている。

20

【0023】

駆動ワイヤー13の近位端は、スライダー22に不図示のスリーブを介して一体的にネジ止め固定されている。したがって、駆動ワイヤー13はスライダー22がその軸線周りに回転された場合には該スライダー22と一体的に回転するとともに、スライダー22がスライド方向にスライドされた場合には一体的にスライドされる。スライダー22の内側には、一対のバネ収容部が形成されており、これらのバネ収容部にそれぞれ板バネ22aが収容されている。スライダー22は、互いに略相対する形状を有する半割部材からなり、適宜に配置された複数の嵌合穴およびこれらに嵌合する複数の嵌合突起が互いに嵌合することにより一体化されるようになっている。また、図示は省略しているが、駆動ワイヤー13の近位端はスライダー22の不図示のスリーブとのネジ止め部において、電線24aに電氣的に接続されている。

30

【0024】

スライダー22にはベース外筒25が取り付けられており、ベース外筒25は略円筒状の部材から構成されている。ベース外筒25がアウター受け23にスライド可能に内挿されることにより、スライダー22がアウター受け23にスライド可能に保持されている。ベース外筒25は、スライダー22に嵌合固定されており、スライダー22がスライド方向にスライドされた場合には一体的にスライドするようになっている。

40

【0025】

アウター受け23は、スライダー22(ベース外筒25)に対して、先端側に移動した位置と基端側に移動した位置との2つの位置の間で位置決め可能にスライドし得るようになっている。すなわち、ベース外筒25には、その基端部近傍に位置決め溝25aaが、先端部近傍に位置決め溝25bが形成されており、アウター受け23のバネ収容部に収容された板バネ23aが、これらの位置決め溝25aまたは25bに弾性的に係合するようになっている。

【0026】

アウター受け23を、スライダー22に対して、ベース外筒25の先端部側にスライドさせた際には、位置決め溝25bに板バネ23aが弾性的に係合して位置決めがなされ、

50

ベース外筒 2 5 の基端部側にスライドさせた際には、位置決め溝 2 5 a に板バネ 2 3 a が弾性的に係合して位置決めがなされるようになっている。

【 0 0 2 7 】

インナーシース 1 2 の近位端は、ベース 2 1 の先端部の略中央に接続されている。インナーシース 1 2 はその軸線周りに回転可能となるようにベース 2 1 の先端部に支持されているとともに、ベース 2 1 がスライド方向にスライドされた場合にはこれと一体的にスライドされるように支持されている。また、図示は省略しているが、インナーシース 1 2 の近位端はベース 2 1 への支持部において、電線 2 4 b に電氣的に接続されている。

【 0 0 2 8 】

ベース 2 1 の基端部側は先端部側に対して回転可能な回転指輪部となっている。ベース 2 1 の先端部近傍はスライド方向にスライド可能となるように、スライダ 2 2 およびベース外筒 2 5 の嵌合穴に内挿保持されている。これにより、例えば、スライダ 2 2 の凹陷した部分を人差し指と中指で挟持した状態で、ベース 2 1 の回転指輪部に親指を挿入し、人差し指および中指に対して親指を近接または離間するように動かすことによって、スライダ 2 2 に対するベース 2 1 のスライド操作を片手で容易に行うことができるようになっている。

【 0 0 2 9 】

ベース 2 1 にはスライド方向に互いに異なる位置に位置決め溝 2 1 a および 2 1 b が形成されている。スライダ 2 2 のバネ収容部に収容された一対の板バネ 2 2 a が、ベース 2 1 のスライド位置に応じて位置決め溝 2 1 a , 2 1 b のいずれか一方に弾性的に係合することにより、ベース 2 1 に対してスライダ 2 2 を、2 つの位置（開脚位置および閉脚位置）で位置決めができるようになっている。

【 0 0 3 0 】

開脚位置は鉗子部 3 の第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2 が開放（開脚）される位置であり、スライダ 2 2 に対してベース 2 1 を引き抜く方向にスライドさせた位置である。閉脚位置は鉗子部 3 の第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2 が閉脚される位置であり、スライダ 2 2 に対してベース 2 1 を押し込む方向にスライドさせた位置である。

【 0 0 3 1 】

鉗子部 3 は、図 5 ~ 図 1 1 に示されているように、一対の高周波電極を構成する第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2 、電極支持部材 3 3 、ツナギ部材 3 4 、および先端円筒部材 3 5 等を備えて構成されている。

【 0 0 3 2 】

第 1 脚部 3 1 は、ステンレス等の金属からなる導電性および弾性を有する電極部材 3 1 b の周囲をその先端部近傍の第 1 電極部 3 1 a となるべき部分（第 2 電極部 3 2 a と対向する内面部分）を除いて適宜に絶縁性の樹脂からなる絶縁材料で被覆して絶縁被覆部 3 1 c を形成して構成されている。なお、第 1 脚部 3 1 の電極部材 3 1 b は、図 7 において、黒太線で表示された絶縁被覆部 3 1 b の内側の白抜きで表示されている部分および第 1 電極部 3 2 a の部分を含んで構成されている。

【 0 0 3 3 】

同様に、第 2 脚部 3 2 は、ステンレス等の金属からなる導電性および弾性を有する電極部材 3 2 b の周囲をその先端部近傍の第 2 電極部 3 2 a となるべき部分（第 1 電極部 3 1 a と対向する内面部分）、これに連続する両側面および外面部分 3 2 d を除いて適宜に絶縁性の樹脂からなる絶縁材料で被覆して絶縁被覆部 3 2 c を形成して構成されている。なお、第 2 脚部 3 2 の電極部材 3 2 b は、図 7 において、黒太線で表示された絶縁被覆部 3 2 b の内側の白抜きで表示されている部分、第 1 電極部 3 2 a およびその周囲の部分（両側面および外面部分 3 2 d ）を含んで構成されている。

【 0 0 3 4 】

これらの第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2 は、外力が作用しない状態において互いに略ハの字状に開脚した状態で、その基端部が絶縁性の樹脂からなる略円柱状の電極支持部材 3 3 の遠位端側に一体的に固定されている。電極支持部材 3 3 の近位端側には凹陷する穴

10

20

30

40

50

が形成されている。駆動ワイヤー 13 の遠位端にはステンレス等の金属からなるツナギ部材 34 が一体的に固定されており、このツナギ部材 34 が電極支持部材 33 の該穴に挿入されて相互に一体的に固定されている。

【0035】

第 1 脚部 31 の電極部材 31b の基端部はツナギ部材 34 にまで至っており、相互に電氣的に導通されている。第 2 脚部 32 の電極部材 32b の基端部はツナギ部材 34 には至っておらず、第 2 脚部 32 の電極部材 32b はツナギ部材 34 から絶縁された状態となっている。先端円筒部材 35 はステンレス等の金属からなる略円筒状の部材からなり、インナーシース 12 の遠位端に電氣的に導通された状態で固定されている。

【0036】

第 1 脚部 31 においては、その電極部材 31b の先端部近傍の第 2 脚部 32 (第 2 電極部 32a) に対向する部分が第 1 電極部 31a となっており、その余の部分は絶縁被覆部 31c によって絶縁被覆されている。すなわち、絶縁被覆部 31c は第 1 電極部 31a の外面側の部分にも形成されており、したがって、インナーシース 12 が駆動ワイヤー 13 に対して押し出されて、第 1 脚部 31 及び第 2 脚部 32 が閉脚される際に、先端円筒部材 35 とは常に電氣的に絶縁された状態を保つようになっている。

【0037】

これに対し、第 2 脚部 32 においては、その電極部材 32b の先端部近傍の第 1 脚部 31 (第 1 電極部 31a) に対向する部分が第 2 電極部 32a となっており、この第 2 電極部 32a を含む電極部材 32b の先端部近傍の全周部分 (両側面および外面部分 32d) を除いたその余の部分が絶縁被覆部 32c によって絶縁被覆されている。すなわち、絶縁被覆部 32c は第 2 電極部 32a の外面側の部分 32d には形成されておらず、したがって、インナーシース 12 が駆動ワイヤー 13 に対して押し出されて、第 1 脚部 31 および第 2 脚部 32 が閉脚される途中においては、先端円筒部材 35 とは電氣的に絶縁された状態となっており、完全に閉脚された際には、先端円筒部材 35 と電氣的に導通された状態となるようになっている。

【0038】

以下、このバイポーラ止血鉗子の動作について、図 12 ~ 図 14 を参照して説明する。まず、図 12 に示されているように、アウター受け 23 をベース外筒 25 がアウター受け 23 内に押し込まれるように (図 12 において上側に) スライドさせて、位置決め溝 25a に板バネ 23a を弾性的に係合させた状態とする。また、ベース 21 をスライダー 22 から引き出すように (図 12 において上側に) スライドさせて、ベース 21 の位置決め溝 21a に板バネ 22a を弾性的に係合させた状態とする。これにより、図 5 ~ 図 7 に示されるように、アウターシース 11 がインナーシース 12 に対して引き込まれて、アウターシース 11 の先端からインナーシース 12 の先端が僅かに突出した状態となるとともに、インナーシース 12 の先端から第 1 脚部 31 および第 2 脚部 32 が突出して自己の弾性により略ハの字状に開脚した状態となる。

【0039】

このバイポーラ止血鉗子を内視鏡の処置具案内管 (不図示) に挿入する際には、図 12 に示された状態から、図 13 に示されるような状態とする。すなわち、アウター受け 23 をベース外筒 25 から抜き出されるように (図 13 において下側に) スライドさせて、位置決め溝 25b に板バネ 23a を弾性的に係合させた状態とする。これにより、図 11 に示されるように、アウターシース 11 の先端が鉗子部 3 に対して押し出されて、鉗子部 3 がアウターシース 11 の先端部内に収納された状態となる。

【0040】

この状態で、当該処置具案内管に適宜に挿入して、鉗子部 3 が止血すべき生体組織の近傍に達したならば、図 12 に示されるように、アウター受け 23 をベース外筒 25 に対してスライドさせて、位置決め溝 25a に板バネ 23a を弾性的に係合させた状態とし、再度図 5 ~ 図 7 に示した状態 (鉗子部 3 が開脚した状態) を得る。

【0041】

10

20

30

40

50

次いで、第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2 のシース軸線周りの回転方向の姿勢を調整する場合には、アウター受け 2 3 に対してスライダ 2 2 を回転させる（スライダ 2 2 を回転させるとベース 2 1 も一体的に回転する）ことにより調整することができる。このとき、インナーシース 1 2 の近位端はベース 2 1 の先端部に回転可能に支持されているため、インナーシース 1 2 から制約を受けることなく、駆動ワイヤー 1 3 を回転させることができる。

【 0 0 4 2 】

第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2 の姿勢調整が済んだならば、図 1 4 に示されているように、スライダ 2 2 の位置をなるべく動かさないようにして、ベース 2 1 をスライダ 2 2 内に押し込むように（図 1 4 において下側に）スライドさせて、位置決め溝 2 1 b に板パネ 2 2 a を弾性的に係合させた状態とする。これにより、図 8 ~ 図 1 0 に示されるように、インナーシース 1 2 が駆動ワイヤー 1 3 に対して押し出され、インナーシース 1 2 の遠位端の先端円筒部材 3 5 によって第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2 が押圧されて閉脚する。この操作により、目的の生体組織を第 1 電極部 3 1 a および第 2 電極部 3 2 a によって把持する。このとき、第 2 脚部 3 2 の電極部材 3 2 b の第 1 電極部 3 2 a の外面部分 3 2 d がインナーシース 1 2 の遠位端の先端円筒部材 3 5 に接触して、電極部材 3 2 b（第 2 電極部 3 2 a）が先端円筒部材 3 5 を介してインナーシース 1 2 に電氣的に導通された状態となる（図 1 0 参照）。

【 0 0 4 3 】

この状態で、高周波電源装置をオンして高周波電流を供給することにより、電線 2 4 a、駆動ワイヤー 1 3、ツナギ部材 3 4、電極部材 3 1 b、第 1 電極部 3 1 a、第 2 電極部 3 2 a、電極部材 3 2 b、外面部分 3 2 d、先端円筒部材 3 5、インナーシース 1 2、および電線 2 4 b を介して高周波電流が流れ、第 1 電極部 3 1 a および第 2 電極部 3 2 a によって把持されている生体組織を焼灼凝固させ、止血することができる。

【 0 0 4 4 】

止血処置が終了したならば、図 1 3 に示されるように、アウター受け 2 3 をベース外筒 2 5 から引き出されるように（図 1 3 において下側に）スライドさせて、位置決め溝 2 5 b に板パネ 2 3 a を弾性的に係合させた状態とする。これにより、図 1 1 に示されるように、アウターシース 1 1 の先端が鉗子部 3 に対して押し出されて、鉗子部 3 がアウターシース 1 1 の先端部内に収納されるので、この状態で、内視鏡の処置具案内管から抜き出して、一連の作業（処置）を終了する。

【 0 0 4 5 】

上述した実施形態によると、駆動ワイヤー 1 3 に対してインナーシース 1 2 が押し出されるように、スライダ 2 2 に対してベース 2 1 をスライドさせることによって、第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2 を閉脚させることができる。また、スライダ 2 2 をアウター受け 2 3 に対して回転させることにより、第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2 をシース軸線周りに回転させることができる。このとき、インナーシース 1 2 はアウターシース 1 1 内に挿通されているから、インナーシース 1 2 は内視鏡の処置具案内管の内壁や他の処置具から直接的に干渉されることがなく、円滑なスライドおよび回転が実現されるので、操作部 2 における操作量（スライド量、回転量）が鉗子部 3 に十分にかつ速やかに反映される。したがって、応答の遅れも少なく、高い操作性を実現することができる。

【 0 0 4 6 】

また、高周波回路は、駆動ワイヤー 1 3、ツナギ部材 3 4、第 1 脚部 3 1 の電極部材 3 1 b（第 1 電極部 3 1 a）、第 2 脚部 3 2 の電極部材 3 2 b（第 2 電極部 3 2 a）、先端円筒部材 3 5、およびインナーシース 1 2 によって形成され、インナーシース 1 2 は動力伝達部材としての機能と、導電部材としての機能を併せ持っているため、従来技術のように、動力伝達部材とは別に専用の電線によって高周波回路を形成する構成のものと比較して、その構成を簡略化することができる。

【 0 0 4 7 】

さらに、従来のような電線がないため、駆動ワイヤー 1 3 はそのような電線から干渉を

10

20

30

40

50

受けることがなく、インナーシース 1 2 内で回転でき、駆動ワイヤー 1 3 によるスライド力や回転力の伝達がそのような電線によって阻害されることはない。従って、第 1 脚部 3 1 および第 2 脚部 3 2 の開閉操作およびシース軸線周りの回転操作の応答性（操作部 2 における操作に対する鉗子部 3 の追従性）を向上することができるとともに、シースの湾曲の状態による応答性の変化も少なくなり、高い操作性を実現することができる。

【 0 0 4 8 】

なお、以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上述した実施形態に開示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である。

10

【 符号の説明 】

【 0 0 4 9 】


- 1 ... シース部、
 - 1 1 ... アウターシース、
 - 1 2 ... インナーシース、
 - 1 3 ... 駆動ワイヤー、
 - 1 4 ... 絶縁被覆部、
- 2 ... 操作部、
 - 2 1 ... ベース、
 - 2 1 a , 2 1 b ... 係合溝、
 - 2 2 ... スライダー、
 - 2 2 a ... 板バネ、
 - 2 3 ... アウター受け、
 - 2 3 a ... 板バネ、
 - 2 4 ... プラグ、
 - 2 4 a , 2 4 b ... 電線、
 - 2 5 ... ベース外筒、
 - 2 5 a , 2 5 b ... 係合溝、
- 3 ... 鉗子部、
 - 3 1 ... 第 1 脚部、
 - 3 1 a ... 第 1 電極部、
 - 3 1 b ... 電極部材、
 - 3 1 c ... 絶縁被覆部、
 - 3 2 ... 第 2 脚部、
 - 3 2 a ... 第 2 電極部、
 - 3 2 b ... 電極部材、
 - 3 2 c ... 絶縁被覆部、
 - 3 3 ... 電極支持部材、
 - 3 4 ... ツナギ部材、
 - 3 5 ... 先端円筒部材。

20


30

40


【図 1】

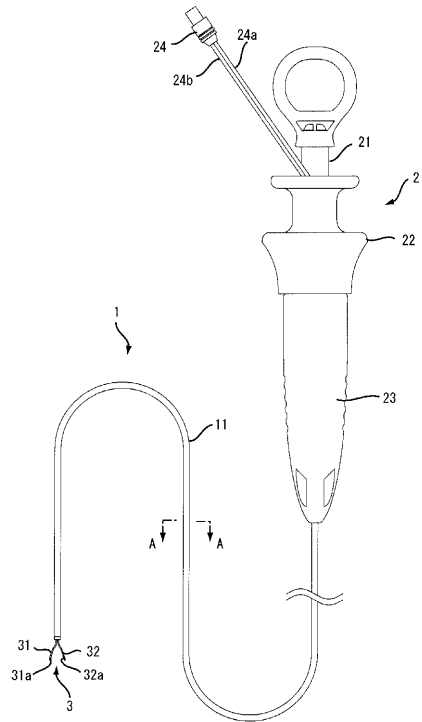


【図 2】









【図 3】

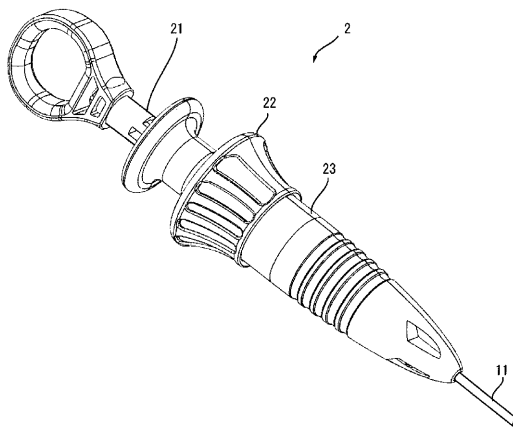


【図 4】

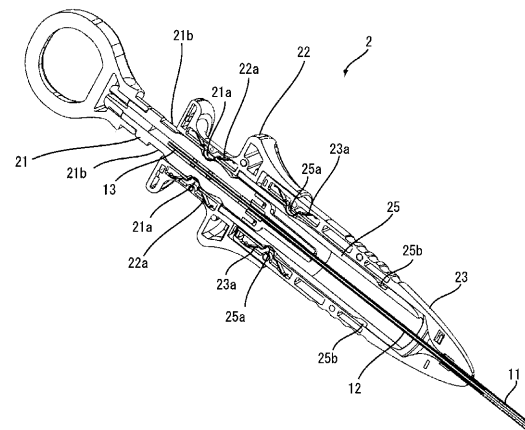


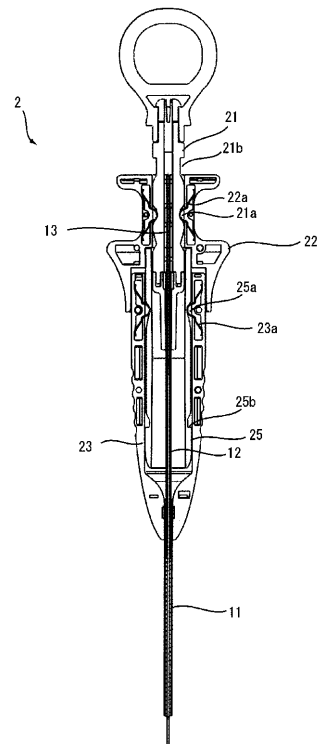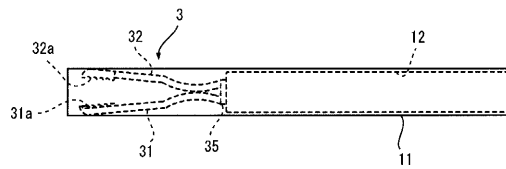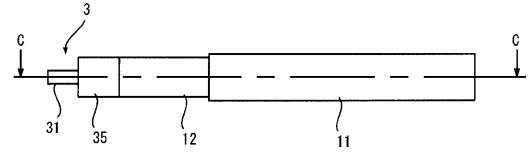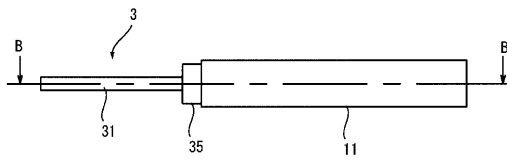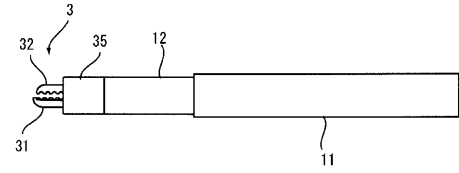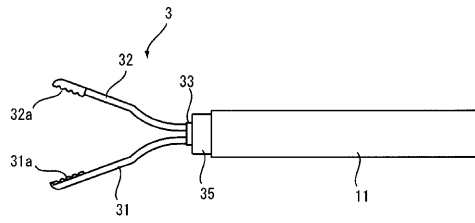


【図 13】

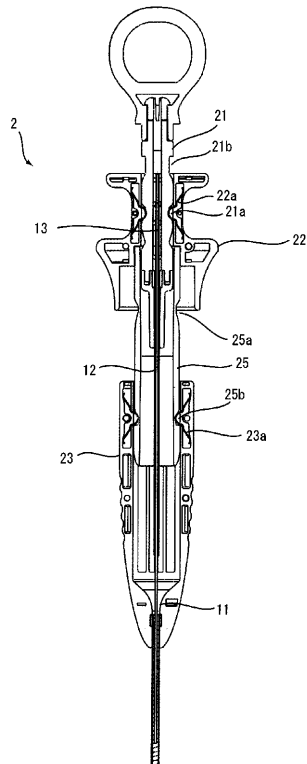


【図 14】

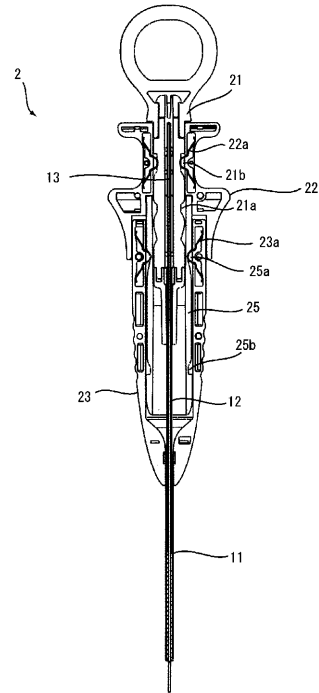

【図 7】

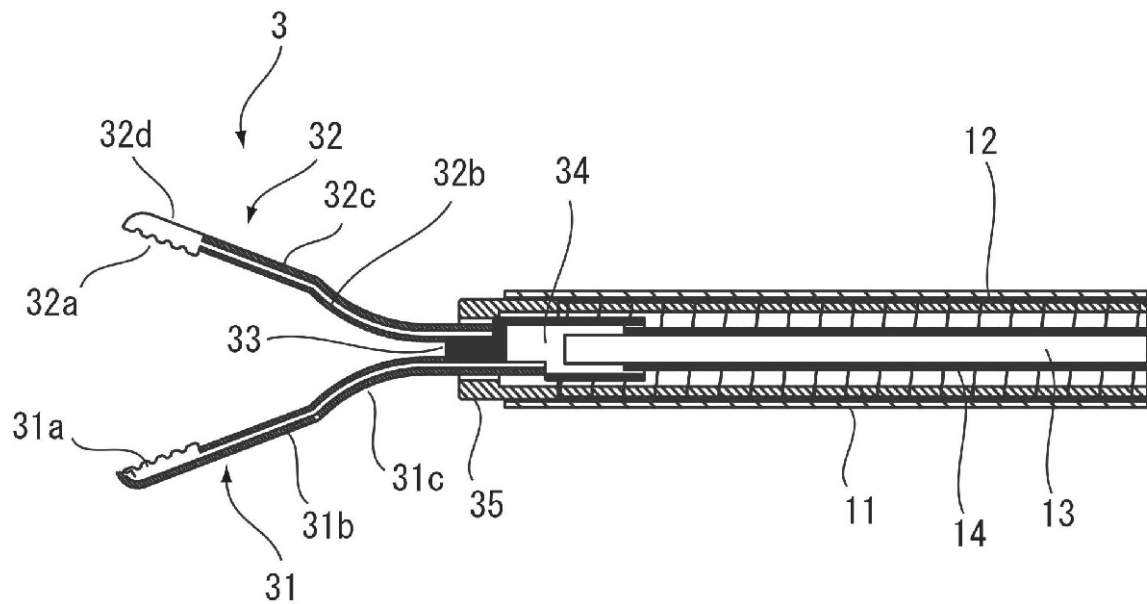

【図 10】

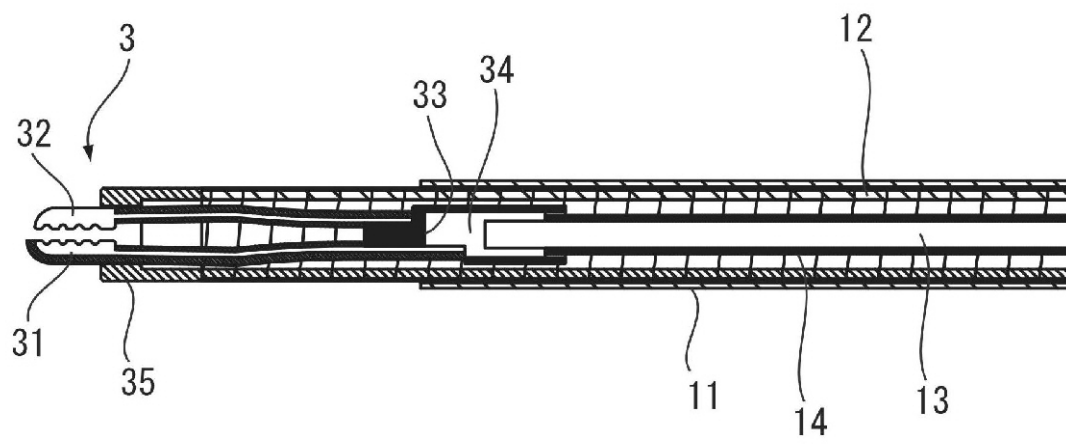

フロントページの続き

(72)発明者 遠藤 新一郎

長野県岡谷市川岸上二丁目 2 9 番 2 0 号 有限会社リバー精工内

Fターム(参考) 4C160 KK06 KK15 KK39 MM32 NN03 NN09 NN10 NN13

4C161 GG15

专利名称(译)	内窥镜高频治疗仪		
公开(公告)号	JP5653814B6	公开(公告)日	2015-01-14
申请号	JP2011071271	申请日	2011-03-29
[标]申请(专利权)人(译)	日本瑞翁株式会社 RIVER SEIKOKK		
申请(专利权)人(译)	日本Zeon有限公司 有限公司河精工		
当前申请(专利权)人(译)	日本Zeon有限公司 有限公司精工河		
[标]发明人	南辻睦 杉谷竜朗 遠藤新一郎		
发明人	南辻 睦 杉谷 竜朗 遠藤 新一郎		
IPC分类号	A61B18/12 A61B1/00		
FI分类号	A61B17/39 A61B1/00.300.J A61B1/00.334.D		
代理人(译)	藤本Yoshiyo		
审查员(译)	毛利 大輔		
其他公开文献	JP5653814B2 JP2012205606A		

摘要(译)

要解决的问题：提高用于内窥镜的高频治疗仪的可操作性。将导电内护套（12）插入绝缘外护套（11）中，并插入围绕内护套（12）具有绝缘涂层的导电驱动线（13）。附接至驱动线13的远端的绝缘电极支撑构件33在腿部以大致V形开口的状态下附接于具有弹性的第一和第二腿部构件31和32。第一腿构件31和第二腿构件32通过沉没在内护套12的远端内而在内部闭合。由于将内护套插入到外护套中，因此可以平滑地进行滑动操作和旋转操作，并且滑动量的缺乏和响应的延迟小，从而可以实现高操作性。[选择图]图7