

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-154185

(P2013-154185A)

(43) 公開日 平成25年8月15日(2013.8.15)

|                                |                      |             |
|--------------------------------|----------------------|-------------|
| (51) Int.Cl.                   | F I                  | テーマコード (参考) |
| <b>A 6 1 B</b> 1/06 (2006.01)  | A 6 1 B 1/06 B       | 2 H 0 4 O   |
| <b>G 0 2 B</b> 23/26 (2006.01) | A 6 1 B 1/06 A       | 4 C 1 6 1   |
| <b>A 6 1 B</b> 1/00 (2006.01)  | G 0 2 B 23/26 B      |             |
|                                | A 6 1 B 1/00 3 O O D |             |

審査請求 有 請求項の数 21 O L (全 16 頁)

|            |                                     |          |                        |
|------------|-------------------------------------|----------|------------------------|
| (21) 出願番号  | 特願2013-55465 (P2013-55465)          | (71) 出願人 | 000000376              |
| (22) 出願日   | 平成25年3月18日 (2013.3.18)              |          | オリンパス株式会社              |
| (62) 分割の表示 | 特願2007-335321 (P2007-335321)<br>の分割 |          | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号      |
| 原出願日       | 平成19年12月26日 (2007.12.26)            | (74) 代理人 | 100108855<br>弁理士 蔵田 昌俊 |
|            |                                     | (74) 代理人 | 100109830<br>弁理士 福原 淑弘 |
|            |                                     | (74) 代理人 | 100088683<br>弁理士 中村 誠  |
|            |                                     | (74) 代理人 | 100103034<br>弁理士 野河 信久 |
|            |                                     | (74) 代理人 | 100095441<br>弁理士 白根 俊郎 |
|            |                                     | (74) 代理人 | 100075672<br>弁理士 峰 隆司  |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光源装置およびそれを備えた内視鏡装置


## (57) 【要約】

【課題】 射出光の色を切り替え可能な小型の光源装置を提供する。

【解決手段】 光源装置10は、第1の半導体レーザー22Aと、第2の半導体レーザー22Bと、蛍光体ユニット62とを有している。第1の半導体レーザー22Aは、波長460nmの青色光を発し、第2半導体レーザー22Bは、波長415nmの青紫色光を発する。蛍光体ユニット62は、第1の半導体レーザー22Aの発する青色光を吸収して波長530nm程度の光を発するが、第2半導体レーザー22Bの発する青紫色光はほとんど透過する。

【選択図】 図1

図1

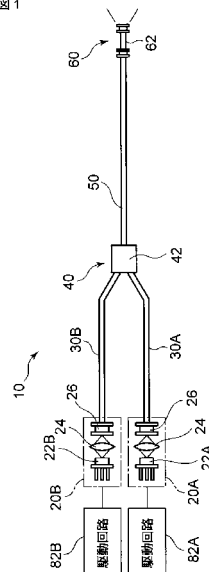

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

第 1 の波長領域の光を発する第 1 の半導体光源と、  
前記第 1 の波長領域と異なる第 2 の波長領域の光を発する第 2 の半導体光源と、  
前記第 1 および前記第 2 の半導体光源とそれぞれ光学的に接続される第 1 および第 2 の入射端と、少なくとも第 1 および第 2 の射出端を有する光カプラーと、  
前記第 1 の射出端と光学的に接続された第 1 の波長変換部材と、  
前記第 2 の射出端と光学的に接続された第 2 の波長変換部材とを有しており、  
前記第 1 および第 2 の波長変換部材は共に、少なくとも前記第 1 の波長領域の光を吸収し、第 1 および第 2 の波長領域のいずれとも異なる第 3 の波長領域の光を発し、  
前記第 1 の波長変換部材と前記第 2 の波長変換部材とはほぼ等しい波長変換特性を有している、光源装置。

10

## 【請求項 2】

前記第 1 の波長変換部材は第 1 の蛍光体であり、前記第 2 の波長変換部材は第 2 の蛍光体であり、  
前記第 1 および第 2 の蛍光体は、それぞれ、第 1 および第 2 の蛍光体ユニットに搭載されており、  
前記第 1 および第 2 の蛍光体ユニットは、互いに略等しい波長変換特性を有している、請求項 1 に記載の光源装置。

20

## 【請求項 3】

前記第 1 の半導体光源を点灯したときに、前記第 1 および第 2 の蛍光体ユニットからは共に第 1 の照明光が射出され、  
前記第 2 の半導体光源を点灯したときに、前記第 1 および第 2 の蛍光体ユニットからは共に第 2 の照明光が射出され、  
前記第 1 の蛍光体ユニットから射出される第 1 の照明光における前記第 1 の波長領域の光と前記第 3 の波長領域の光との強度の比は、前記第 2 の蛍光体ユニットから射出される第 1 の照明光における前記第 1 の波長領域の光と前記第 3 の波長領域の光との強度の比に略等しく、  
前記第 1 の蛍光体ユニットから射出される第 2 の照明光における前記第 2 の波長領域の光と前記第 3 の波長領域の光との強度の比は、前記第 2 の蛍光体ユニットから射出される第 2 の照明光における前記第 2 の波長領域の光と前記第 3 の波長領域の光との強度の比に略等しく、  
前記第 1 の蛍光体ユニットから射出される第 1 の照明光における前記第 1 の波長領域の光と前記第 3 の波長領域の光との強度の比は、前記第 1 の蛍光体ユニットから射出される第 2 の照明光における前記第 2 の波長領域の光と前記第 3 の波長領域の光との強度の比と異なっており、  
前記第 2 の蛍光体ユニットから射出される第 1 の照明光における前記第 1 の波長領域の光と前記第 3 の波長領域の光との強度の比は、前記第 2 の蛍光体ユニットから射出される第 2 の照明光における前記第 2 の波長領域の光と前記第 3 の波長領域の光との強度の比と異なっている、請求項 2 に記載の光源装置。

30

40

## 【請求項 4】

前記光カプラーは、前記第 1 の入射端に入射した光を前記第 1 および第 2 の射出端にほぼ等しい光強度割合で分配し、前記第 2 の入射端に入射した光を前記第 1 および第 2 の射出端にほぼ等しい光強度割合で分配する、2 入力 2 出力の光カプラーである、請求項 3 に記載の光源装置。

## 【請求項 5】

前記第 1 および第 2 の蛍光体は共に、前記第 1 の波長領域の光を吸収する吸収率と、前記第 2 の波長領域の光を吸収する吸収率とが異なるように構成されている、請求項 4 に記載の光源装置。

## 【請求項 6】

50

前記光カプラーの第 1 の射出端と前記第 1 の蛍光体ユニットは第 1 の射出側光ファイバーにより光学的に接続されており、

前記光カプラーの第 2 の射出端と前記第 2 の蛍光体ユニットは第 2 の射出側光ファイバーにより光学的に接続されている、請求項 5 に記載の光源装置。

【請求項 7】

前記第 1 の波長領域の光は、前記光カプラー、前記第 1 および第 2 の光ファイバーにより導光され、前記第 1 および第 2 の蛍光体ユニットに照射され、

前記第 2 の波長領域の光は、前記光カプラー、前記第 1 および第 2 の光ファイバーにより導光され、前記第 1 および第 2 の蛍光体ユニットに照射され、

前記第 1 の蛍光体ユニットから射出される前記第 1 の照明光における前記第 1 の波長領域の光と前記第 2 の波長領域の光が照射される領域はほぼ等しい領域であり、

前記第 2 の蛍光体ユニットから射出される前記第 1 の照明光における前記第 1 の波長領域の光と前記第 2 の波長領域の光が照射される領域はほぼ等しい領域であり、

前記第 1 の蛍光体ユニットから射出される第 1 の照明光の射出位置と前記第 1 の蛍光体ユニットから射出される第 2 の照明光の射出位置は略等しく、

前記第 2 の蛍光体ユニットから射出される第 1 の照明光の射出位置と前記第 2 の蛍光体ユニットから射出される第 2 の照明光の射出位置は略等しい、請求項 6 に記載の光源装置。

【請求項 8】

前記光カプラーは、2 本の光ファイバーを光学的に接続した 2 入力 2 出力タイプの光ファイバー型光カプラーである、請求項 6 に記載の光源装置。

【請求項 9】

前記光カプラーは、さらに第 3 の射出端を有しており、

前記第 3 の射出端は、第 3 の蛍光体ユニットと光学的に接続されており、

前記光カプラーの第 1 および第 2 の入射端に入射した光は、前記第 1、第 2 および第 3 の射出端に、それぞれほぼ等しい割合で分配され、

前記第 1、第 2 および第 3 の蛍光体ユニットは、互いにほぼ等しい波長変換特性を有する、請求項 6 に記載の光源装置。

【請求項 10】

請求項 2 ないし 9 のいずれかひとつに記載の光源装置を備えた内視鏡装置。

【請求項 11】

前記蛍光体ユニットは全て、前記内視鏡の先端部材に搭載されている、請求項 10 に記載の内視鏡装置。

【請求項 12】

前記内視鏡の先端部材は、金属部材である、請求項 11 に記載の内視鏡装置。

【請求項 13】

前記内視鏡の先端部材には撮像装置が設けられており、

前記全ての蛍光体ユニットは、前記内視鏡の撮像装置を挟んで両側に配置されている、請求項 11 に記載の内視鏡装置。

【請求項 14】

前記第 1 および第 2 の蛍光体ユニットと、前記撮像装置との間に、断熱部材が設けられている、請求項 13 に記載の内視鏡装置。

【請求項 15】

前記第 1 の半導体光源の発光・消灯を独立に切り替える第 1 の光源駆動回路と、前記第 2 の半導体光源の発光・消灯を独立に切り替える第 2 の光源駆動回路とを有する、請求項 10 に記載の内視鏡装置。

【請求項 16】

前記第 1 および第 2 の蛍光体ユニットの吸収スペクトルの吸収強度がピーク値の半分以上である波長領域を第 1 の吸収領域と定義したときに、

前記第 1 の波長領域は、前記第 1 の吸収領域に含まれ、

10

20

30

40

50

前記第 2 の波長領域は、前記第 1 の吸収領域には含まれない、請求項 15 に記載の内視鏡装置。

【請求項 17】

前記第 1 の半導体光源が発する第 1 の波長領域の光は、波長 430 nm ~ 480 nm に含まれる青色領域の光であり、

前記第 2 の半導体光源が発する第 2 の波長領域の光は、波長 430 nm 以下の青紫色領域の光であり、

前記第 1 および第 2 の蛍光体ユニットが発する第 3 の波長領域の光は、少なくとも黄色領域を含む、第 1 の波長領域の光と比較してブロードなスペクトルの光である、請求項 16 に記載の内視鏡装置。

【請求項 18】

前記第 1 の蛍光体はセリウム賦活の蛍光体であり、前記第 1 の波長領域は前記セリウム賦活の蛍光体の吸収スペクトルの吸収領域である、請求項 17 に記載の内視鏡装置。

【請求項 19】

前記第 1 および第 2 の蛍光体はガーネット系蛍光体であり、前記第 1 の波長領域は前記ガーネット系蛍光体の吸収スペクトルの吸収領域である、請求項 17 に記載の内視鏡装置。

【請求項 20】

前記第 1 の照明光は、通常観察を行うための照明光であり、

前記第 2 の照明光は、病変部などの視認性を向上させる特殊光観察を行うための照明光であり、

前記第 1 の照明光と前記第 2 の照明光とは、互いに相手の発光・消灯状態に関わらず、独立に発光・消灯を切替可能である、請求項 16 に記載の内視鏡装置。

【請求項 21】

前記第 1 および第 2 の蛍光体ユニットは、前記青色領域の光が照射されたときに、前記青色領域の光と黄色領域の光とが混合された白色光を、第 1 の照明光として射出し、前記青紫色領域の光が照射されたときに、前記青色領域の光の吸収量と比較して、青紫光をほとんど吸収せず、大部分の青紫光を透過して第 2 の照明光として射出する、請求項 20 に記載の内視鏡装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、光源装置に関する。

【背景技術】

【0002】

現在、内視鏡装置では、白色光による通常観察に加えて、特定の波長の光を用いて病変部などの視認性を向上させた観察手法いわゆる特殊光観察が行われている。このような機能を有する内視鏡装置は、具体的には通常観察のための白色光と特殊光観察のための特殊光とを切り替えて内視鏡先端部から射出するように構成されている。

【0003】

特開 2006 - 026128 号公報は、このような内視鏡装置用の光源装置のひとつを開示している。この光源装置では、光偏向素子を含むユニットをスライドさせて、光偏向素子を光路上に適宜配置することによって、観察光と特殊光との切り替え、言い換えれば射出光の色の切り替えを実施している。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】特開 2006 - 026128 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

10

20

30

40

50

## 【 0 0 0 5 】

前述の光源装置では、観察光と特殊光との切り替えをユニットのスライドによって実施するため、ユニットをスライドさせる機械的な機構が必要であり、これが装置の大型化・複雑化を招いている。

## 【 0 0 0 6 】

本発明は、このような実状を考慮してなされたものであり、その目的は、射出光の色を切り替え可能な小型の光源装置を提供することである。

## 【課題を解決するための手段】

## 【 0 0 0 7 】

本発明による光源装置は、第1の波長領域の光を発する第1の半導体光源と、前記第1の波長領域と異なる第2の波長領域の光を発する第2の半導体光源と、前記第1および前記第2の半導体光源とそれぞれ光学的に接続される第1および第2の入射端と、少なくとも第1および第2の射出端を有する光カプラーと、前記第1の射出端と光学的に接続された第1の波長変換部材と、前記第2の射出端と光学的に接続された第2の波長変換部材とを有しており、前記第1および第2の波長変換部材は共に、少なくとも前記第1の波長領域の光を吸収し、第1および第2の波長領域のいずれとも異なる第3の波長領域の光を発し、前記第1の波長変換部材と前記第2の波長変換部材とはほぼ等しい波長変換特性を有している。

10

## 【発明の効果】

## 【 0 0 0 8 】

本発明によれば、射出光の色を切り替え可能な小型の光源装置が提供される。

20

## 【図面の簡単な説明】

## 【 0 0 0 9 】

【図1】本発明の第1実施形態による光源装置を示している。

【図2】YAG:Ceのスペクトル特性を示している。

【図3】Ce賦活のCa<sub>3</sub>Sc<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub>のスペクトル特性を示している。

【図4】本発明の第2実施形態による光源装置を示している。

【図5】図4に示したマルチ蛍光体ユニットを示している。

【図6】図5に示したマルチ蛍光体ユニットに代替可能な別のタイプのマルチ蛍光体ユニットを示している。

30

【図7】Eu賦活のLa<sub>2</sub>O<sub>2</sub>Sの発光スペクトルを示している。

【図8】Eu, Mn共賦活のBaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>の発光スペクトルを示している。

【図9】Eu賦活のBaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>の発光スペクトルを示している。

【図10】本発明の第3実施形態による光源装置を示している。

【図11】SrAlO:Euのスペクトル特性を示している。

【図12】本発明の第4実施形態による光源装置の蛍光体ユニットから射出される光のスペクトルを示している。

【図13】一般的な内視鏡装置を概略的に示している。

【図14】図13に示した内視鏡先端部の構成を示している。

## 【発明を実施するための形態】

40

## 【 0 0 1 0 】

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。

## 【 0 0 1 1 】

## &lt; 第1実施形態 &gt;

図1は本発明の第1実施形態による光源装置を示している。図1に示すように、光源装置10は、第1の光源部20Aと、第2の光源部20Bと、第1の光源部20Aから射出される光を導波する光ファイバー30Aと、第2の光源部20Bから射出される光を導波する光ファイバー30Bと、光ファイバー30Aおよび光ファイバー30Bと接続された光カプラー40と、光カプラー40から出力される光を導波する光ファイバー50と、光ファイバー50により導波された光に応じた照明光を発する波長変換部60とを有してい

50

る。

【0012】

第1の光源部20Aは、第1の半導体レーザー22Aと、第1の半導体レーザー22Aから発せられる発散性の光を収束させるレンズ24と、レンズ24により収束された光を光ファイバー30Aに光学的に結合する結合素子26とを有している。同様に、第2の光源部20Bは、第2の半導体レーザー22Bと、第2の半導体レーザー22Bから発せられる発散性の光を収束させるレンズ24と、レンズ24により収束された光を光ファイバー30Aに光学的に結合する結合素子26とを有している。

【0013】

光源装置10は、第1の半導体レーザー22Aの発光・消灯すなわちオン・オフを独立に切り替える駆動回路82Aと、第2の半導体レーザー22Bの発光・消灯すなわちオン・オフを独立に切り替える駆動回路82Bとをさらに有している。

【0014】

光カプラー40は、2つの入射端と1つの射出端とを有する2入力1出力タイプの光ファイバーカプラー42で構成されている。光ファイバーカプラー42の一方の入射端は光ファイバー30Aを介して第1の光源部20Aと光学的に結合されている。光ファイバーカプラー42のもう一方の入射端は光ファイバー30Bを介して第2の光源部20Bと光学的に結合されている。光ファイバーカプラー42の射出端は光ファイバー50を介して波長変換部60と光学的に結合されている。

【0015】

なお、ここで言う光カプラーとは、複数の入射端からの光を、少なくとも一つの射出端へ光学的に接続するものであり、機械的な接続形態について何ら限定するものではない。例えば、2本以上の光ファイバーの被覆の一部を各々除去し、これらを接触させた状態で加熱、押圧することにより、光ファイバーのコア部を結合したものでもよいし、平行に配置した複数の光ファイバーの端部に、対向して配置した別の光ファイバーの端部を接触させ、加熱により結合したものでもよい。これら二つの例では、結合部を光カプラーの一部と言うこともできるし、結合部そのものを光カプラーと言うこともできる。いずれの場合も、入射光を結合部に導光する入射側の光ファイバーを、光カプラーの入射端に接続された入射側光ファイバーと呼び、また、結合部から出射する光を出射端に導光する出射側の光ファイバーを、光カプラーの出射端に接続する射出側光ファイバーと呼ぶことができる。

【0016】

第1の半導体レーザー22Aは、波長460nmの青色のレーザー光を発し、第2半導体レーザー22Bは、波長415nmの青紫色のレーザー光を発する。波長変換部60は、Ce（セリウム）賦活のYAG（イットリウム・アルミニウム・ガーネット）（以下、YAG：Ceと記す）の蛍光体を含む蛍光体ユニット62で構成されている。YAG：Ceのスペクトル特性を図2に示す。図2において、破線はYAG：Ceの吸収スペクトルを示し、実線は発光スペクトルを示している。図2に示す通り、YAG：Ceの吸収スペクトルは、460nm付近にピークを有している。ここで、吸収スペクトルの吸収領域は、蛍光体の吸収スペクトルの吸収強度が、ピーク値の半分以上である波長領域であると定義する。YAG：Ceの吸収スペクトルの吸収領域は、およそ430nm～480nmである。蛍光体ユニット62は、第1の半導体レーザー22Aが発する波長460nmの青色光を吸収して波長530nm程度の光を発するが、第2半導体レーザー22Bが発する波長415nmの青紫色光はほとんど透過する。

【0017】

次に、本実施形態による光源装置の動作について説明する。

【0018】

始めに第1の半導体レーザー22Aをオンにしたときの動作について説明する。第1の半導体レーザー22Aをオンにすると、第1の半導体レーザー22Aは波長460nmの青色のレーザー光を発する。第1の半導体レーザー22Aから発せられたレーザー光はレ

10

20

30

40

50

レンズ 24 によって収束されて光ファイバー 30A に入射する。光ファイバー 30A に入射したレーザー光は、光ファイバー 30A を導波し、光ファイバーカプラー 42 を経由し、光ファイバー 50 を導波して蛍光体ユニット 62 に入射する。図 2 から分かるように、波長 460nm の青色レーザー光は YAG:Ce の吸収領域の光であるので、蛍光体ユニット 62 に入射した青色レーザー光の一部は、蛍光体ユニット 62 内の YAG:Ce によって、波長 530nm 付近にピークを有するブロードなスペクトルの黄色光に波長変換され、波長変換された黄色光が蛍光体ユニット 62 の射出端から射出される。また蛍光体ユニット 62 に入射した青色レーザー光の残りの一部は、波長変換されることなく蛍光体ユニット 62 を通過し、蛍光体ユニット 62 の射出端から射出される。この結果、蛍光体ユニット 62 の射出端からは、蛍光体ユニット 62 によって波長変換された黄色光と、半導体レーザー 22A から発せられた青色光とが射出される。本実施形態では、これら黄色光と青色光とが混合されたときに白色光となるように調整されている。その結果、蛍光体ユニット 62 の射出端からは白色光が射出される。すなわち、第 1 の半導体レーザー 22A をオンにしたとき、蛍光体ユニット 62 の射出端からは、通常観察用の観察光である白色光が射出される。

10

#### 【0019】

次に、第 2 の半導体レーザー 22B をオンにしたときの動作について説明する。第 2 の半導体レーザー 22B をオンにすると、第 2 の半導体レーザー 22B は波長 415nm の青紫色のレーザー光を発する。第 2 の半導体レーザー 22B から発せられたレーザー光はレンズ 24 によって収束されて光ファイバー 30B に入射する。光ファイバー 30B に入射したレーザー光は、光ファイバー 30B を導波し、光ファイバーカプラー 42 を経由し、光ファイバー 50 を導波して蛍光体ユニット 62 に入射する。図 2 から分かるように、波長 415nm の青紫色レーザー光は YAG:Ce の吸収領域に含まれないため、蛍光体ユニット 62 の YAG:Ce にはほとんど吸収されないため、蛍光体ユニット 62 に入射した青紫色レーザー光は、ほとんどが蛍光体ユニット 62 を通過し、蛍光体ユニット 62 の射出端から射出される。すなわち、第 2 の半導体レーザー 22B をオンにしたとき、蛍光体ユニット 62 の射出端からは、特殊光観察用の特殊光である波長 415nm の青紫光が射出される。

20

#### 【0020】

このように、第 1 の半導体レーザー 22A だけがオンにされているときに蛍光体ユニット 62 から射出される光と、第 2 の半導体レーザー 22B だけがオンにされているときに蛍光体ユニット 62 から射出される光は、色が互いに異なる。

30

#### 【0021】

本実施形態の光源装置 10 では、第 1 の半導体レーザー 22A と第 2 の半導体レーザー 22B との一方を選択的にオンにすることによって、観察光である白色光と特殊光である波長 415nm の青紫光とがスライドユニットなどの機械的な可動機構を使用することなく切り替えられて蛍光体ユニット 62 の同一の射出端から射出される。

#### 【0022】

このような 2 つの半導体レーザー 22A, 22B と光カプラー 40 と波長変換部 60 との組み合わせにより、白色光と青紫光を容易に切替可能な光源装置が得られる。また、この光源装置は、機械的な可動機構を持たないシンプルな構造のため、小型化にも適している。

40

#### 【0023】

なお、波長 415nm の青紫光は、血液中のヘモグロビンによる吸収が大きく、血管を観察しやすくする効果があるため、本実施形態ではこの波長の光を選択したが、この波長の光に限らず、観察目的に応じた波長の光を選択してよい。すなわち、YAG:Ce に対しては、430nm 以下の波長の光や 480nm 以上の波長の光を使用してよい。

#### 【0024】

また、蛍光体は YAG:Ce に限定されるものではなく、ほかの適当な蛍光体、例えば Ce 賦活の  $\text{Ca}_3\text{Sc}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$  などの蛍光体を使用してもよい。図 3 に Ce 賦活の

50

$\text{Ca}_3\text{Sc}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$  のスペクトル特性を示す。図中、破線が吸収スペクトルで示し、実線が発光スペクトルを示している。図 3 に示す通り、この Ce 賦活の  $\text{Ca}_3\text{Sc}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$  の吸収領域はおおよそ  $460\text{ nm} \sim 530\text{ nm}$  となっている。従って、この蛍光体を用いるときは、これに応じて、第 1 の半導体レーザー 22 A の励起光の波長を例えば  $500\text{ nm}$  程度にすることによって、より効率的に励起光が波長変換されて明るい照明光が得られる。

#### 【0025】

##### < 第 2 実施形態 >

次に、第 2 実施形態による光源装置について図 4 ないし図 9 を参照して説明する。第 2 実施形態では、第 1 実施形態と共通の部分については説明を省略し、主に異なる部分について説明する。

10

#### 【0026】

図 4 は、第 2 実施形態による光源装置を示している。図 4 に示すように、本実施形態による光源装置 10 A は、第 1 実施形態による光源装置 10 との比較において、第 1 の光源部 20 A の代わりに第 3 の光源部 20 C を有し、光ファイバー 30 A の代わりに光ファイバー 30 C を有し、蛍光体ユニット 62 の代わりに蛍光体ユニット 62 A を有している。第 3 の光源部 20 C は、第 3 の半導体レーザー 22 C と、第 3 の半導体レーザー 22 C から発せられる発散性の光を収束させるレンズ 24 と、レンズ 24 により収束された光を光ファイバー 30 C に光学的に結合する結合素子 26 とを有している。光源装置 10 A はまた、駆動回路 82 A の代わりに、第 3 の半導体レーザー 22 C の発光・消灯すなわちオン・オフを独立に切り替える駆動回路 82 C を有している。それ以外の構成は、第 1 実施形態と同様である。

20

#### 【0027】

第 3 の半導体レーザー 22 C は、波長  $375\text{ nm}$  の近紫外光を発する。蛍光体ユニット 62 A は、組成の異なる複数種類の蛍光体を含むマルチ蛍光体ユニットで構成されている。図 5 は、図 4 に示した蛍光体ユニット 62 A を示している。図 5 に示すように、蛍光体ユニット 62 A は、赤色光を発する R 蛍光体 64 A を含む領域 66 A と、緑色光を発する G 蛍光体 64 B を含む領域 66 B と、青色光を発する B 蛍光体 64 C を含む領域 66 C とを入射端側から射出端側に順に積層して構成されたマルチ蛍光体ユニットで構成されている。これらの蛍光体 64 A, 64 B, 64 C は、いずれも近紫外光である  $375\text{ nm}$  の光により励起されて、それぞれ赤色光と緑色光と青色光を発するものが選択されている。このような蛍光体 64 A, 64 B, 64 C は、たとえば、それぞれ、Eu 賦活の  $\text{La}_2\text{O}_2\text{S}$  (赤色)、Eu, Mn 共賦活の  $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}$  (緑色)、Eu 賦活の  $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}$  (青色) であってよい。Eu 賦活の  $\text{La}_2\text{O}_2\text{S}$  (赤色) の発光スペクトルを図 7 に、Eu, Mn 共賦活の  $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}$  (緑色) の発光スペクトルを図 8 に、Eu 賦活の  $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}$  (青色) の発光スペクトルを図 9 に示す。図 7 ないし図 9 に示す通り、これらの蛍光体の吸収領域は、それぞれ、 $270\text{ nm} \sim 400\text{ nm}$ 、 $230\text{ nm} \sim 400\text{ nm}$ 、 $270\text{ nm} \sim 410\text{ nm}$  である。これらの蛍光体を含むマルチ蛍光体ユニットの吸収領域は、すべての蛍光体の吸収領域の重なり領域とみなせ、 $270\text{ nm} \sim 400\text{ nm}$  である。

30

40

#### 【0028】

次に、第 2 実施形態による光源装置の動作について説明する。

#### 【0029】

第 3 の半導体レーザー 22 C をオンにすると、第 3 の半導体レーザー 22 C は波長  $375\text{ nm}$  の近紫外のレーザー光を発する。第 3 の半導体レーザー 22 C から発せられた近紫外レーザー光はレンズ 24 によって収束されて光ファイバー 30 C に入射する。光ファイバー 30 C に入射したレーザー光は光ファイバー 30 C を導波し、光ファイバーカプラー 42 を経由し、光ファイバー 50 を導波して蛍光体ユニット 62 A に入射する。蛍光体ユニット 62 A は、図 5 に示すように、光ファイバー 50 と接続されている入射端側から順に、赤色光を発する R 蛍光体 64 A を含む領域 66 A と、緑色光を発する G 蛍光体 64 B

50

を含む領域 6 6 B と、青色光を発する B 蛍光体 6 4 C を含む領域 6 6 C とが配列されている。また、第 3 の半導体レーザー 2 2 C の発する波長 3 7 5 n m の光は、蛍光体ユニット 6 2 A を構成するマルチ蛍光体ユニットの吸収領域の光である。このため、領域 6 6 A に入射した近紫外光の一部は R 蛍光体 6 4 A によって赤色光に波長変換されて領域 6 6 B に入射し、領域 6 6 A に入射した近紫外光の残りの一部はそのまま領域 6 6 A を通過して領域 6 6 B に入射する。領域 6 6 B に入射した近紫外光の一部は G 蛍光体 6 4 B によって緑色光に波長変換されて領域 6 6 C に入射する。また、G 蛍光体 6 4 B は赤色光を吸収しないので、領域 6 6 B に入射した赤色光はそのまま領域 6 6 B を通過する。従って、赤色光と緑色光と近紫外光とが B 蛍光体 6 4 C を含む領域 6 6 C に入射する。領域 6 6 C に入射した近紫外光のほとんどは B 蛍光体 6 4 C によって青色光に波長変換される。また、B 蛍光体 6 4 C は赤色光と緑色光を吸収しないので、領域 6 6 C に入射した赤色光と緑色光はそのまま領域 6 6 C を通過する。その結果、蛍光体ユニット 6 2 A の射出端からは赤色光と緑色光と青色光とが混合された白色光が射出される。

10

20

30

40

50

#### 【0030】

また、第 2 の半導体レーザー 2 2 B をオンにすると、半導体レーザー 2 2 B は波長 4 1 5 n m の青紫色のレーザー光を発する。第 2 の半導体レーザー 2 2 B から発せられたレーザー光は、第 1 実施形態で説明したように、レンズ 2 4 によって収束されて光ファイバー 3 0 B に入射し、光ファイバー 3 0 B を導波し、光ファイバーカプラー 4 2 を経由し、光ファイバー 5 0 を導波して蛍光体ユニット 6 2 に入射する。波長 4 1 5 n m の青紫色光はマルチ蛍光体ユニットの吸収領域の光ではないので、蛍光体ユニット 6 2 A に入射した青紫色光は、R 蛍光体 6 4 A と G 蛍光体 6 4 B と B 蛍光体 6 4 C のいずれにもほとんど吸収されず、蛍光体ユニット 6 2 A をそのまま通過して射出端から射出される。

#### 【0031】

この結果、光源装置 1 0 A は、第 3 の半導体レーザー 2 2 C が選択的にオンにされたときは白色光を射出し、第 2 の半導体レーザー 2 2 B がオンにされたときは波長 4 1 5 n m の青紫光を射出する。光源装置 1 0 A から射出される白色光は、赤色光と緑色光と青色光の成分を有するため、第 1 実施形態と比較して演色性の高い照明光となる。すなわち、本実施形態によれば、第 1 実施形態と同じ利点を有し、さらに演色性が向上した光源装置が得られる。

#### 【0032】

なお、本実施形態では、蛍光体ユニット 6 2 A は、図 5 に示すように、R 蛍光体 6 4 A を含む領域 6 6 A と G 蛍光体 6 4 B を含む領域 6 6 B と B 蛍光体 6 4 C を含む領域 6 6 C とが積層されたマルチ蛍光体ユニットで構成されているが、図 6 に示すように、それらの蛍光体 6 4 A , 6 4 B , 6 4 C のすべてが混合された別のタイプのマルチ蛍光体ユニットで構成されてもよい。これにより、蛍光体ユニット 6 2 A がシンプルに構成される。

#### 【0033】

##### < 第 3 実施形態 >

次に、第 3 実施形態による光源装置について図 1 0 を参照して説明する。第 3 実施形態では、第 1 実施形態と共通の部分については説明を省略し、主に異なる部分について説明する。

#### 【0034】

図 1 0 は、第 3 実施形態による光源装置を示している。図 1 0 に示すように、本実施形態による光源装置 1 0 B は、光カプラー 4 0 が 2 つの入射端と 2 つの射出端を有する 2 入力 2 出力タイプの光ファイバーカプラー 4 2 A で構成されており、光ファイバーカプラー 4 2 A の 2 つの射出端にそれぞれ 2 本の光ファイバー 5 0 と 2 つの蛍光体ユニット 6 2 とが接続されている点が第 1 実施形態と異なっている。

#### 【0035】

光ファイバーカプラー 4 2 A は、2 つの入射端と、2 つの射出端とを有し、一方の入射端に入射した光を 2 つの射出端にほぼ等しい光強度割合で分配し、もう一方の入射端に入射した光を 2 つの射出端にほぼ等しい光強度割合で分配する。波長変換部 6 0 は、2 つの

蛍光体ユニット 62 を有している。2つの蛍光体ユニット 62 は、それぞれ、2本の光ファイバー 50 を介して光ファイバーケーブル 42A の2つの射出端と光学的に接続されている。2つの蛍光体ユニット 62 はほぼ等しい波長変換特性を有している。

#### 【0036】

第1の半導体レーザー 22A が発する波長 460 nm の青色光は光ファイバー 30A を導波して光ファイバーケーブル 42A に入射する。光ファイバーケーブル 42A に入射した青色光は、光ファイバーケーブル 42A によってほぼ等しい強度で2本の光ファイバー 50 に分配される。2本の光ファイバー 50 に分配された青色光は、それぞれ、2本の光ファイバー 50 を導波して2つの蛍光体ユニットに入射する。各蛍光体ユニットに入射した青色光は、第1実施形態で説明したように、青色光と波長変換された黄色光とが混合された白色光となり、各蛍光体ユニットから射出される。

10

#### 【0037】

また、第2の半導体レーザー 22B が発する波長 415 nm の青紫色光は光ファイバー 30B を導波して光ファイバーケーブル 42A に入射する。光ファイバーケーブル 42A に入射した青紫色光は、光ファイバーケーブル 42A によってほぼ等しい強度で2本の光ファイバー 50 に分配される。2本の光ファイバー 50 に分配された青紫色光は、それぞれ、2本の光ファイバー 50 を導波して2つの蛍光体ユニットに入射する。各蛍光体ユニットに入射した青紫色光は、第1実施形態で説明したように、そのまま各蛍光体ユニットから射出される。

20

#### 【0038】

本実施形態によれば、第1実施形態の利点を有し、さらに観察対象を2方向から照明可能な光源装置が得られる。たとえば、内視鏡装置のように、観察対象から光源までが非常に近接しているとき、一方向だけからの照明は、影を生じさせるなど、観察対象物を見づらくすることがあるが、観察対象を2方向から照明するように2つの蛍光体ユニットの射出端を配置することによって、影を生じさせ難くすることが可能となる。この結果、大型化を伴うことなく、観察により適した光源装置が得られる。

#### 【0039】

本実施形態では、波長変換部 60 の各蛍光体ユニットが、第1実施形態で説明した蛍光体ユニット 62 で構成されているが、第2実施形態で説明したマルチ蛍光体ユニット 62A で構成されてもよい。さらに、光ケーブル 40 を、3以上の出力端を有する光ファイバーケーブルに変更するとともに、光ファイバーケーブルの3以上の出力端に、それぞれ、光ファイバーケーブルの出力端と同数の光ファイバーと複数の蛍光体ユニットとを接続した構成としてもよい。

30

#### 【0040】

##### < 第4実施形態 >

次に、第4実施形態による光源装置について説明する。本実施形態による光源装置は、基本的に第1実施形態と同様の構成を有しているが、波長変換部 60 が、励起波長特性の異なる2種類の蛍光体を含む蛍光体ユニットで構成されている点が第1実施形態と異なっている。

40

#### 【0041】

本実施形態における蛍光体ユニット 62 は、第1の半導体レーザー 22A から発せられる青色レーザー光は波長変換するが、第2の半導体レーザー 22B から発せられる青紫色レーザー光はほとんど波長変換しない第1の蛍光体と、第1の半導体レーザーから発せられる青色レーザー光は波長変換しないが、第2の半導体レーザー 22B から発せられる青紫色レーザー光は波長変換する第2の蛍光体とを含む蛍光体ユニットで構成されている。

#### 【0042】

本実施形態においては、たとえば、第1の蛍光体は YAG : Ce で構成され、第2の蛍光体は、Eu 賦活の SrAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (以下、SrAlO : Eu と記す) で構成されている。図2は YAG : Ce のスペクトル特性を示し、図11は SrAlO : Eu のスペクトル特性を示している。第1の蛍光体である YAG : Ce の吸収領域は 430 nm ~ 480 nm

50

mであり、第2の蛍光体であるSrAlO:Euの吸収領域は270nm~430nmである。

【0043】

この第4実施形態の動作について説明する。

【0044】

始めに第1の半導体レーザー22Aをオンにしたときの動作について説明する。第1の半導体レーザー22Aは、第1実施形態で説明したように、460nmの波長の青色レーザー光を発する。第1の半導体レーザー22Aから発せられたレーザー光は、光ファイバー30Aを導波し、光ファイバーカプラー42を経由し、光ファイバー50を導波して蛍光体ユニット62に入射する。蛍光体ユニット62は、図2に示した特性を有するYAG:Ceと、図11に示した特性を有するSrAlO:Euとを含んでおり、また、波長460nmの青色光は、YAG:Ceの吸収領域内にあり、かつ、SrAlO:Euの吸収領域外にある光であるため、蛍光体ユニット62に入射した青色光は、YAG:Ceによって効率的に波長530nm程度の黄色光に波長変換されるが、SrAlO:Euによってはほとんど波長変換されない。その結果、蛍光体ユニット62の射出端からは、青色光とYAG:Ceにより波長変換された黄色光とが混合された白色光が射出される。

【0045】

次に、第2の半導体レーザー22Bをオンにしたときの動作について説明する。第2の半導体レーザー22Bは、第1実施形態で説明したように、波長415nmの青紫色レーザー光を発する。第2の半導体レーザー22Bから発せられたレーザー光は、光ファイバー30Bを導波し、光ファイバーカプラー42を経由し、光ファイバー50を導波して蛍光体ユニット62に入射する。波長415nmの青紫色光は、SrAlO:Euの吸収領域内にあり、かつ、YAG:Ceの吸収領域外にある光であるため、蛍光体ユニット62に入射した青紫色光は、YAG:Ceによってはほとんど波長変換されないが、SrAlO:Euによって波長540nm程度の緑色光に効率的に波長変換される。その結果、蛍光体ユニット62の射出端からは、図12に示すように、波長415nmの青紫色光と波長540nmの緑色光とが混合された光が射出される。この2つの波長の光は、ヘモグロビンの吸収波長とほぼ一致しており、血管をよりコントラスト良く観察することに好適である。

【0046】

本実施形態によれば、第1実施形態の利点を有し、さらに血管などをよりコントラスト良く観察することに適した光源装置が得られる。この光源装置は、蛍光体ユニット62に含まれる蛍光体の種類が増えるだけであり、他に大きな変更を必要としないため、装置の大型化を伴わない。

【0047】

<付記>

上述したすべての実施形態では、光源が半導体レーザーで構成されているが、光源は、これに限定されるものではなく、発光ダイオードなどの他の半導体光源で構成されてもよい。発光ダイオードを使用すると、半導体レーザーを使用したときと比較して、より安価な光源装置が得られる。

【0048】

また、上述した実施形態の光源装置は特に内視鏡装置への搭載に適している。

【0049】

一般的な内視鏡装置を図13に概略的に示す。図13に示すように、内視鏡装置100は、操作部110と、操作部110から延びている挿入部120と、挿入部120の先端に位置する内視鏡先端部130とを有している。このような内視鏡装置100を用いた観察では、観察対象が内視鏡先端部130に近接するため、通常観察光と特殊光の射出位置がずれていると、色分離を起こすなどの不具合が生じる。これに対して上述した実施形態の光源装置では、通常観察光と特殊光の射出位置が一致しているので、色分離を起こすことがなく、特に内視鏡装置への搭載に適している。

## 【 0 0 5 0 】

また、一般的な内視鏡先端部 1 3 0 の構成を図 1 4 に示す。図 1 4 に示すように、内視鏡先端部 1 3 0 は、3 つの先端金属部材 1 3 2 A , 1 3 2 B , 1 3 2 C と、それらを覆うカバー 1 4 4 とを有している。2 つの先端金属部材 1 3 2 A , 1 3 2 C は断熱材 1 3 4 A を介して結合され、2 つの先端金属部材 1 3 2 B , 1 3 2 C は断熱材 1 3 4 B を介して結合されている。先端金属部材 1 3 2 C には個体撮像装置 1 3 6 と送気送水ノズル 1 3 8 と吸引チャンネル 1 4 0 とが設けられている。また先端金属部材 1 3 2 A , 1 3 2 B には照明用のライトガイドユニット 1 4 2 が 1 つずつ設けられている。

## 【 0 0 5 1 】

このように内視鏡装置は一般に 2 つのライトガイドユニット 1 4 2 を有している。このため、上述した実施形態の光源装置を内視鏡装置に搭載する際は、図 1 や図 4 に示したように 1 つの光射出部を有する光源装置を 2 つ内視鏡装置に組み込んでもよく、また図 1 0 に示したように 2 つの光射出部を有する光源装置を 1 つだけ内視鏡装置に組み込んでもよい。

10

## 【 0 0 5 2 】

さらに、上述した実施形態の光源装置を内視鏡装置に搭載する際、内視鏡先端部 1 3 0 の近傍に波長変換部 6 0 を配置してもよく、また、波長変換部 6 0 から射出される光を再び別の光ファイバーを介して内視鏡先端部 1 3 0 まで導いてもよい。前者の構成は、高い輝度の照明光を得るのに都合が良い。また後者の構成は、発熱する蛍光体ユニットが内視鏡先端部から離して配置されるため、内視鏡先端部の近傍の発熱を抑制するのに都合が良い。

20

## 【 0 0 5 3 】

これまで、図面を参照しながら本発明の実施形態を述べたが、本発明は、これらの実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において様々な変形や変更が施されてもよい。

## 【 符号の説明 】


## 【 0 0 5 4 】

1 0 , 1 0 A , 1 0 B ... 光源装置、2 0 A , 2 0 B , 2 0 C ... 光源部、2 2 A , 2 2 B , 2 2 C ... 半導体レーザー、2 4 ... レンズ、2 6 ... 結合素子、3 0 A , 3 0 B , 3 0 C ... 光ファイバー、4 0 ... 光ファイバーカプラー、4 2 , 4 2 A ... 光ファイバーカプラー、5 0 ... 光ファイバー、6 0 ... 波長変換部、6 2 , 6 2 A ... 蛍光体ユニット、6 4 A ... R 蛍光体、6 4 B ... G 蛍光体、6 4 C ... B 蛍光体、6 6 A , 6 6 B , 6 6 C ... 領域、8 2 A , 8 2 B , 8 2 C ... 駆動回路、1 0 0 ... 内視鏡装置、1 1 0 ... 操作部、1 2 0 ... 挿入部、1 3 0 ... 内視鏡先端部、1 3 2 A , 1 3 2 B , 1 3 2 C ... 先端金属部材、1 3 4 A , 1 3 4 B ... 断熱材、1 3 6 ... 個体撮像装置、1 3 8 ... 送気送水ノズル、1 4 0 ... 吸引チャンネル、1 4 2 ... ライトガイドユニット、1 4 4 ... カバー。

30


【図 1】

図 1

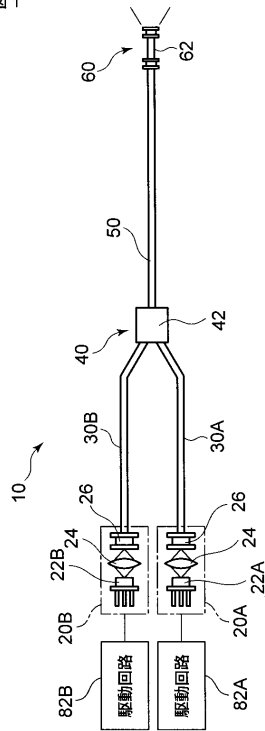


【図 4】

図 4

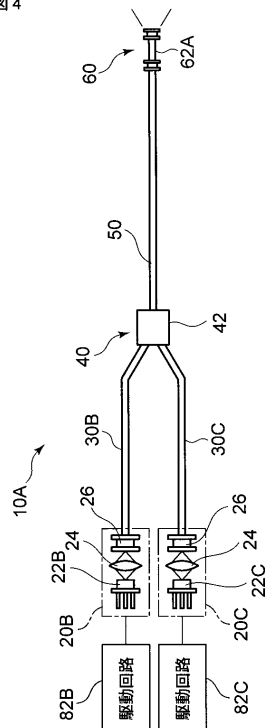


【図 2】

図 2

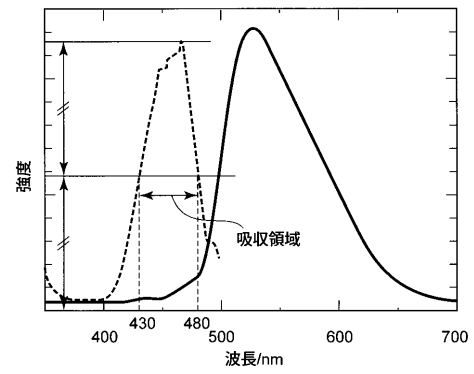


【図 3】

図 3

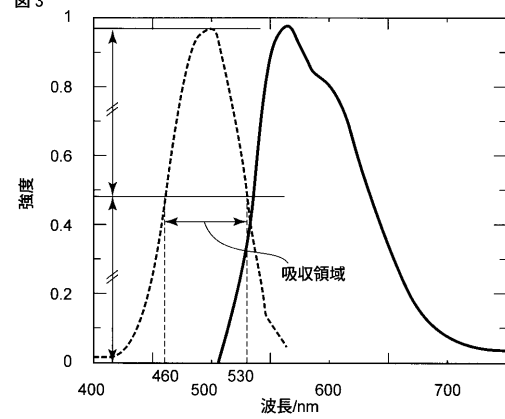


【図 5】

図 5




【図 6】

図 6




【図 7】

図 7

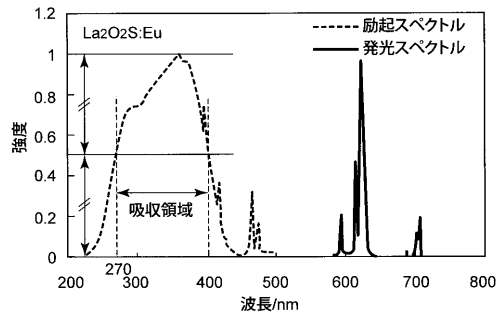


【図 9】

図 9

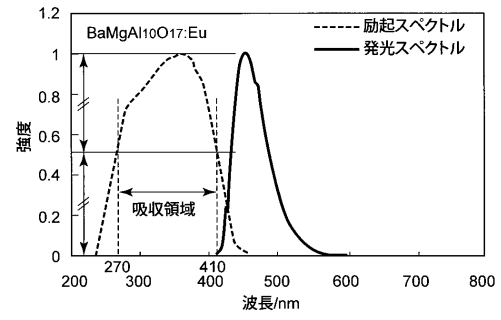


【図 8】

図 8

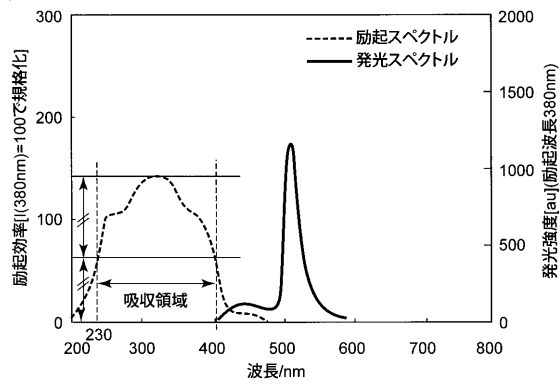


【図 10】

図 10

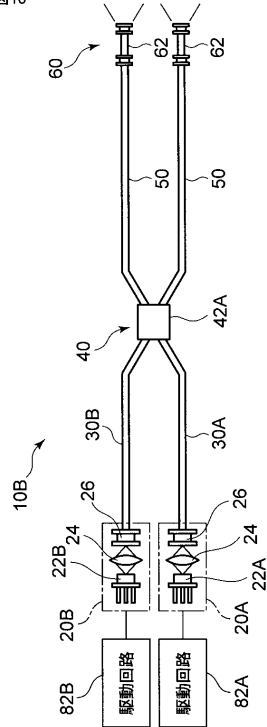


【図 11】

図 11

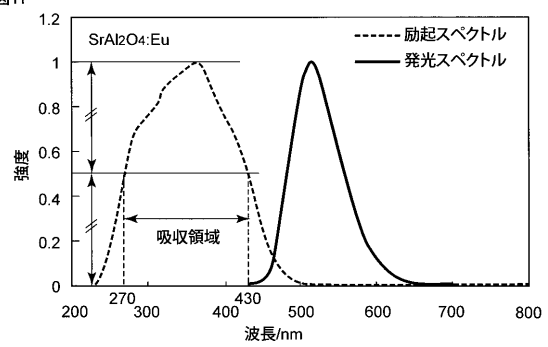


【図 12】

図 12

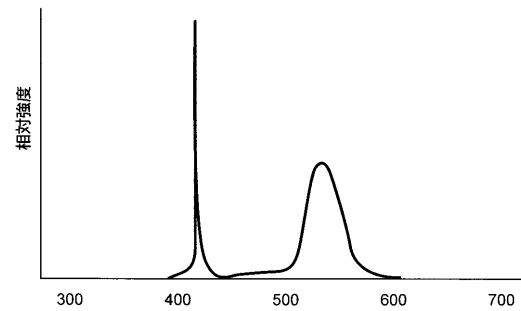


## 【 図 1 3 】

図13

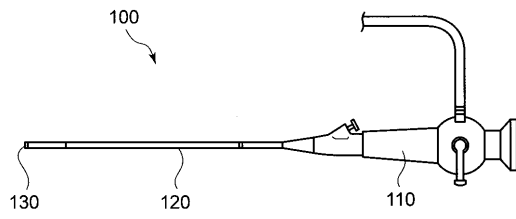

## 【 図 1 4 】

図14

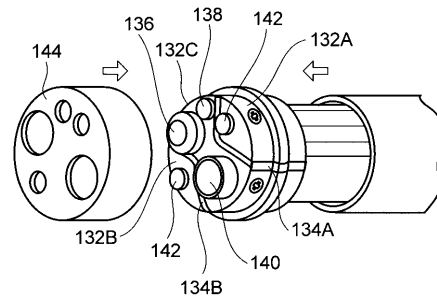

---

フロントページの続き

(74)代理人 100119976  
弁理士 幸長 保次郎

(74)代理人 100153051  
弁理士 河野 直樹

(74)代理人 100140176  
弁理士 砂川 克

(74)代理人 100158805  
弁理士 井関 守三

(74)代理人 100124394  
弁理士 佐藤 立志

(74)代理人 100112807  
弁理士 岡田 貴志

(74)代理人 100111073  
弁理士 堀内 美保子

(74)代理人 100134290  
弁理士 竹内 将訓

(72)発明者 伊藤 毅  
東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 3 番 2 号 オリンパス株式会社内

F ターム(参考) 2H040 CA03 CA06 CA07 CA13

4C161 BB02 CC06 GG01 LL02 NN01 QQ02 QQ04 QQ07 QQ09 RR03  
RR04

|                |                                                                                                                                                                      |         |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 光源装置和具有该光源装置的内窥镜装置                                                                                                                                                   |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP2013154185A</a>                                                                                                                                        | 公开(公告)日 | 2013-08-15 |
| 申请号            | JP2013055465                                                                                                                                                         | 申请日     | 2013-03-18 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 奥林巴斯株式会社                                                                                                                                                             |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 奥林巴斯公司                                                                                                                                                               |         |            |
| [标]发明人         | 伊藤 毅                                                                                                                                                                 |         |            |
| 发明人            | 伊藤 毅                                                                                                                                                                 |         |            |
| IPC分类号         | A61B1/06 G02B23/26 A61B1/00                                                                                                                                          |         |            |
| FI分类号          | A61B1/06.B A61B1/06.A G02B23/26.B A61B1/00.300.D A61B1/00.550 A61B1/05 A61B1/06.510 A61B1/07.730 A61B1/07.732 A61B1/07.736                                           |         |            |
| F-TERM分类号      | 2H040/CA03 2H040/CA06 2H040/CA07 2H040/CA13 4C161/BB02 4C161/CC06 4C161/GG01 4C161/LL02 4C161/NN01 4C161/QQ02 4C161/QQ04 4C161/QQ07 4C161/QQ09 4C161/RR03 4C161/RR04 |         |            |
| 代理人(译)         | 中村诚<br>河野直树<br>冈田隆                                                                                                                                                   |         |            |
| 其他公开文献         | JP5698780B2                                                                                                                                                          |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                            |         |            |

#### 摘要(译)

**摘要：**要解决的问题：提供一种能够切换发光颜色的小型光源装置。解决方案：光源装置10包括第一半导体激光器22A，第二半导体激光器22B和荧光体单元62。第一半导体单元22A发射波长为460nm的蓝光，第二半导体激光器22B发射蓝紫色波长为415纳米的光。荧光体单元62吸收由第一半导体激光器22A发射的蓝光并发射波长为约530nm的光，但透射由第二半导体激光器22B发射的大部分蓝紫色光。

图 1

