

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-217331

(P2019-217331A)

(43) 公開日 令和1年12月26日 (2019. 12. 26)

(51) Int.Cl.
A 6 1 B 17/115 (2006.01)F I
A 6 1 B 17/115テーマコード (参考)
4 C 1 6 0

審査請求 有 請求項の数 12 O L (全 71 頁)

(21) 出願番号 特願2019-156824 (P2019-156824)
(22) 出願日 令和1年8月29日 (2019. 8. 29)
(62) 分割の表示 特願2017-229809 (P2017-229809)
の分割
原出願日 平成20年2月21日 (2008. 2. 21)
(31) 優先権主張番号 60/902, 534
(32) 優先日 平成19年2月21日 (2007. 2. 21)
(33) 優先権主張国・地域又は機関
米国 (US)
(31) 優先権主張番号 60/977, 489
(32) 優先日 平成19年10月4日 (2007. 10. 4)
(33) 優先権主張国・地域又は機関
米国 (US)

(71) 出願人 508024083
エシコン エンドーサージェリー, インク
.
アメリカ合衆国 オハイオ州 4 5 2 4 2
, シンシナティ, クリークロード 4 5 4
5
(74) 代理人 110001302
特許業務法人北青山インターナショナル
(72) 発明者 スミス, ケビン
アメリカ合衆国 フロリダ州 3 3 1 5 6
, コーラルゲーブルス, アルビダパークウ
エイ 5 7 0

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 手術器具

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 自己電力を用いる電気自己駆動式の手術用装置を提供する。

【解決手段】 手術器具は、可換部品を取り外し可能に受ける受け部を有する手術用エンドエフェクタを具える。受け部は通信接続を有する。エンドエフェクタに接続されるハンドルは、エンドエフェクタを作動させる。ハンドルはエンドエフェクタに設けられる場合、可換部品を認証するため通信接続に電氣的に接続されるコントローラを有する。可換部品は受け部に取り外し可能に接続され、受け部に設けられる場合、通信接続に電氣的に取り外し可能に接続される暗号化装置を有する。この暗号化装置は、電気コントローラから問い合わせを受けると可換部品を認証する。

【選択図】 図 3 0

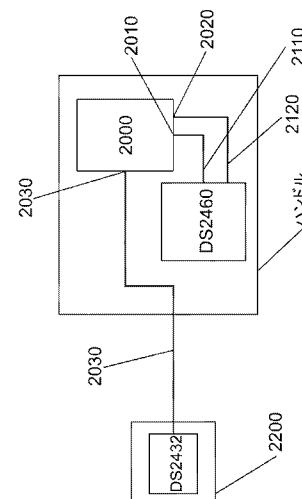

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電動手術器具であって、
手術用エンドエフェクタと、
前記手術用エンドエフェクタの近位端に接続されたハンドルと、
前記ハンドルの内部に配置された電動モータと、
前記電動モータと前記手術用エンドエフェクタに機械的に接続され、前記電動モータの動きを前記手術用エンドエフェクタの動作部の近位方向と遠位方向の動きに変換するトランスミッションであって、前記動作部が、第 1 の位置と第 2 の位置の間の任意の位置に移動するよう作動可能な、トランスミッションと、

10

前記トランスミッションに結合された手動解放部であって、動作するときに、前記トランスミッションを機械的に遮断し、遮断の間に、遮断時の前記動作部の現在位置に関係なく、前記第 1 の位置に向けて前記動作部を移動させるよう作動可能な手動解放部と、
を具えることを特徴とする手術器具。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の手術器具において、
前記手術用エンドエフェクタが、内視鏡的線形ステープラ及びカッターであり、
移動パーツが、少なくともステープル動作及び組織切除スライドを具えることを特徴とする手術器具。

20

【請求項 3】

請求項 1 に記載の手術器具において、
さらに、前記ハンドルの内部に全体に配置され、前記電動モータに電力を供給する電源を具えることを特徴とする手術器具。

【請求項 4】

請求項 3 に記載の手術器具において、
前記電源、前記トランスミッション、および前記電動モータが、前記手術用エンドエフェクタのステープル切断機能を動作させるように作動可能であることを特徴とする手術器具。

【請求項 5】

請求項 3 に記載の手術器具において、
前記電源が、少なくとも 1 つのバッテリーセルを含む取り外し可能なバッテリーパックであることを特徴とする手術器具。

30

【請求項 6】

請求項 1 に記載の手術器具において、
前記トランスミッションが、モータ駆動サイド及び動作駆動サイドを有しており、
前記手動解放部が、前記モータ駆動サイドと前記動作駆動サイドの間で前記トランスミッションに連結されていることを特徴とする手術器具。

【請求項 7】

請求項 6 に記載の手術器具において、
前記モータ駆動サイドが、最後のギアを含む一連の回転減速ギアを有しており、
前記動作駆動サイドが、
少なくとも 1 つのギアと、
前記少なくとも 1 つのギアに結合され、前記移動パーツの少なくとも一部に直接接続されたラックアンドピニオンアセンブリと、
を有しており、

40

前記手動解放部が、前記少なくとも 1 つのギアと前記最後のギアの間で前記トランスミッションに連結されていることを特徴とする手術器具。

【請求項 8】

請求項 7 に記載の手術器具において、
前記モータが出力ギアを有しており、

50

前記一連のギアが、前記出力ギアに結合された第 1 段を有することを特徴とする手術器具。

【請求項 9】

請求項 8 に記載の手術器具において、

前記一連のギアが、第 1 段、第 2 段、および第 3 段と、前記モータ駆動サイドから前記動作駆動サイドに横切るクロスオーバーシャフトを備えたクロスオーバーギアと、を含んでおり、

前記クロスオーバーギアが前記第 3 段に結合されていることを特徴とする手術器具。

【請求項 10】

請求項 8 に記載の手術器具において、

前記一連のギアが、前記モータ駆動サイドから前記動作駆動サイドに横切るクロスオーバーシャフトを備えたクロスオーバーギアを有しており、

前記クロスオーバーギアが前記一連のギアに結合されており、

キャッスルギアが、前記クロスオーバーシャフトの周りに回転可能に固定結合され、前記クロスオーバーシャフトの上で長手方向に往復移動可能であり、前記キャッスルギアが、前記動作駆動サイドに向かって延びる胸壁を有しており、

前記動作駆動サイドの少なくとも 1 つのギアが、前記胸壁と係合するように成形された胸壁スロットを有する第 1 のピニオンを含んでおり、

前記クロスオーバーギアと前記キャッスルギアとの間に配置された付勢装置が、前記動作駆動サイドに向けて前記キャッスルギアに付勢を与えて、前記キャッスルギアと前記第 1 のピニオンとの選択的係合を可能にする。

前記第 1 のピニオンが、そのように係合すると、前記クロスオーバーシャフトの回転とともに回転するよう作動可能であり、

前記手動解放部の解放部分が、キャッスルギアのバイアスを克服するために反対の力を提供するよう作動可能であり、

前記手動解放部が、少なくとも部分的に動作すると、前記第 1 のピニオンから前記キャッスルギアを離すよう作動可能であることを特徴とする手術器具。

【請求項 11】

請求項 10 に記載の手術器具において、

前記手動解放部が、

静止状態と、

第 1 の部分動作状態と、

第 2 の部分動作状態と、

を有しており、

前記手動解放部がその静止状態にあるときに、反対の力の大きさが前記キャッスルギアへの付勢よりも小さく、

前記手動解放部が前記第 1 の部分動作状態にあるときに、前記反対の力の大きさが前記キャッスルギアへの付勢よりも大きく、これにより、前記胸壁スロットの外に前記胸壁を移動させ、

前記手動解放部が前記第 2 の部分動作状態にあるときに、前記第 1 のピニオンが回転して、後退方向に長手方向に前記ラックアンドピニオンアセンブリのラックを移動させることを特徴とする手術器具。

【請求項 12】

請求項 10 に記載の手術器具において、

前記動作駆動サイドの少なくとも 1 つのギアが、少なくとも 1 つの解放ギアを含んでおり、

前記第 1 のピニオンが、前記少なくとも 1 つの解放ギアに直接接続されて、回転すると前記少なくとも 1 つの解放ギアを回転させ、

前記手動解放部が手動解放レバーを含んでおり、前記手動解放レバーが、

前記ハンドルに回転可能に接続され、

一方向ラチェットアセンブリを有しており、

前記少なくとも1つの解放ギアが、前記ラチェットアセンブリに直接接続された軸を有しており、前記手動解放レバーが少なくとも部分的に動作するときに、前記手動解放レバーと対応する方法で回転するよう作動可能であり、前記手動解放レバーが動作しないときに、前記手動解放レバーとは独立して回転するよう作動可能であることを特徴とする手術器具。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は手術器具の分野に関し、特に、限定しないが、ステープル装置に関する。本願に記載するステープル装置は、手持ち式で、完全に電気自己駆動式の、手動解放機能付の、制御された手術用ステープラである。

【0002】

従来も医療用ステープル装置は存在する。Ethicon Endo-Surgery, Inc. (ジョンソン & ジョンソンの会社：以下「エチコン」と称す。)が、このようなステープル装置を製造販売している。エチコンが製造する円形ステープル装置は、取引名がPROXIMATE (登録商標) PPH, CDH, ILSとして参照され、エチコンが製造する線形ステープラは取引名CONTOURおよびPROXIMATEで参照される。これらの手術用ステープラの例ではいずれも、ステープルが出る際に組織がステープルカートリッジとアンビルとの間で圧迫され、圧迫された組織が切れてしまうこともある。施術者により結合された特定の組織によっては、組織の圧迫が少なすぎたり (組織内で血液の色が見えるくらい)、組織の圧迫が強すぎたり (組織が破壊されるくらい)、あるいは正しく圧迫される (組織から液体が除去され、乾燥または漂白状態として参照される)。

【0003】

供給されるステープルは、与えられた長さであり、カートリッジとアンビルが許容されるステープル射出距離内にある必要があり、これによってステープルが射出されると正しく閉じる。このため、これらのステープラは、2つの面の間の相対距離と、この距離がステープルの長さの射出範囲内か否かを示す装置を具える。このようなインジケータは機械的であり、ウィンドウの後ろのスライドバーの形をなし、そこには安全なステープル射出範囲が示されている。これらのステープラはすべて手動であり、換言すれば、アンビルとステープラカートリッジを組織の周りに位置させ、留めおよび／または切って、アンビルとステープラカートリッジを互いに閉じ、および、ステープルを組織に射出し固定する (および／または組織を切る) ために、利用者／施術者による物理的な操作が必要である。ステープルを射出させるのに必要な長さ方向の力はステープルカートリッジで通常250ポンドのオーダーであるため、従来技術のステープラでは、電気駆動でこれらの操作の各々を実現するものはなかった。さらに、このようなステープラは、留められる組織に作用する力を最適化するための如何なる種類の圧迫作用インジケータもなく、組織の分解 (degradation) が生じない。

【0004】

片手駆動の、管内の (intraluminal) 吻合円形ステープラが、例えばMainらからエチコンに譲渡された米国特許第5, 104, 025号に記載されている。Mainらは参照により全体としてここに組み込まれている。図7の分解図に最も明確に示すように、Mainらでは、トロカールシャフト22が遠位のギザギザ21と、アンビル内で前記トロカールシャフト22を鋸歯29に整列させるいくつかの凹部28とを具え、これによりアンビル34内でステープルが整列する。トロカールのチップ26は、圧力を加えると組織を穿刺することができる。Mainらの図3乃至6には、円形ステープラがどのように機能して2つの組織を結合させるかが示されている。アンビル30がヘッド20の近くに移動すると、特に図5、6で示されるように、間に挟まれた組織がその間で圧迫される。この組織が過度に圧迫されると、外科的ステープル処置は成功しない。このため、組織の許容最大圧縮力を超えないことが望まれる。間に挟まれる組織は、施術の際に許容しうる範

10

20

30

40

50

囲の圧縮力にさらすことができる。この範囲は、最適組織圧縮 (optimal tissue compression) または O T C として知られ、ステープルされる組織の種類による。Mainらのステープラは、利用者にアンビルとステープルカートリッジ間の安全なステープル射出距離を示すバーインジケータを有さないため、ステープルの前に利用者にどのようなレベルの圧縮力がかかっているかを示すことができない。このような表示を提供し、組織の過度の圧迫を防止することが望まれている。

【発明の概要】

【0005】

本発明は、医療処置を及ぼすのに自己電力を用いる電気自己駆動式の手術用装置を提供することにより、上記および他の従来技術の困難性を解消するものである。例えば、線形
10 エンドカッタにおいて、電気内蔵電力により、ステープルおよび／または切開される組織の周りでアンビルとステープラカートリッジを互いに位置決め可能であり、アンビルおよびステープラカートリッジを互いに閉じた後、ステープルを前記組織に射出し固定する（および／または前記組織を切除する）。さらに、電気自己駆動式の手術用装置は、利用者にステープルを射出する前に利用者が予め設定した組織に加わる圧縮力のレベルを示すことができる。本発明はまた、最適組織圧縮 (O T C) が存在する場合に電気式手術用ステープル装置を操作してステープルする方法を提供する。さらに、ステープルカートリッジのような使い捨て部品の暗号認証が提供される。さらに、部分作動やジャムから復旧可能な手動解放装置を提供する。

【0006】

2つのアンビルとステープル射出サブアセンブリのオフセット軸の構成は、利用者の手に快適にフィットするよう寸法調整されうる装置を作成する。それはまた、以前は必要だったネストされた（同軸）中空軸を除去することにより、製造の困難性を低減させる。ステープル射出サブアセンブリからオフセットされたアンビルサブアセンブリの軸により、アンビルを伸長および後退させるためのねじ切りされたロッドの長さを約2インチ縮小することができ、これにより製造コストを削減し、縦の寸法を短くする。

【0007】

電気ステープラを用いる例示的な方法は、テスト目的の手動モードへ入ることができる電源オン特性を含む。外科的処置において、ステープラは一方向の装置である。テストモードでは、しかしながら、利用者は思い通りにトロカールを前後させることができる。このテストモードは解除可能であり、ステープラはパッケージや輸送のためユーザモードにリセットされる。パッケージのため、アンビルはステープルカートリッジから離しておくことが望ましい（必須ではない）。このため、ホーミングシーケンスをプログラミングして、パッケージや輸送のため電力を切る前に、アンビルをステープルカートリッジから（例えば）1 c m 離して配置するようにする。使用前に、トロカールは伸長され、アンビルは取り外される。例えばステープラが結腸を切開するのに用いられる場合、トロカールはハンドルに引き戻され、ハンドルが肛門経路で結腸内に、切開部の下流側へと挿入され、一方でアンビルは腹腔鏡用切開部から切開部の上流側へ挿入される。アンビルがトロカールに取り付けられ、ステープルが準備できるまで、これら2つのパーツがハンドルの方へ引き戻される。ステープル射出シーケンスが開始されるが、それは中断可能であり、切開
40 をステープル留めすると同時に切開の中央で組織を切除し、ステープルの円形リングの真ん中の開口を切除する。圧迫が所望の圧力範囲、つまり最適組織圧縮 (O T C) 範囲である場合にのみステープルが射出されるように、ステープル射出シーケンスはO T C測定およびフィードバック制御機構を具える。この範囲または値は、アンビルおよびステープルカートリッジ間で圧迫される組織の周知の性質に基づき、既に周知である。

【0008】

電気ステープラが利用できる処置のいくつかの例は、結腸の切開や胃バイパス手術を含む。この電気ステープラは、様々な異なる技術分野で多くの他の使用例がある。

【0009】

本発明により、前述および他の目的の範囲内で、可換部品を取り外し可能に受けるため

10

20

30

40

50

の受け部を有する手術用エンドエフェクタを具える手術器具であって、前記受け部が通信接続を有する手術器具が提供される。ハンドルは、前記エンドエフェクタを作動させるために当該エンドエフェクタに接続され、前記ハンドルは、前記可換部品を認証するための前記通信接続に電氣的に接続されるコントローラを有する。可換部品は前記受け部に取り外し可能に接続され、前記受け部にある場合に前記通信接続に電氣的に取り外し可能に接続される暗号化装置を有し、この暗号化装置は、前記可換部品が前記受け部にある場合に当該部品を認証するようプログラムされる。

【0010】

本発明の目的の範囲内で、さらに手術器具が提供され、作動時に外科的処置を及ぼす少なくとも1の作動アセンブリを有する手術用エンドエフェクタと、可換部品を取り外し可能に受けるための受け部とを具え、前記受け部は通信接続を有する。ハンドルは、前記作動アセンブリを作動させるエンドエフェクタに接続され、前記ハンドルは前記可換部品を認証するために前記通信接続に電氣的に接続されるコントローラを有する。可換部品は前記受け部に取り外し可能に接続され、前記受け部にある場合に前記通信接続に電氣的に取り外し可能に接続される1ワイヤ暗号化装置(1-wire encryption device)を有する。この暗号化装置は、前記可換部品が前記受け部にある場合に、当該部品を暗号認証する。

【0011】

本発明の目的の範囲内で、さらに手術器具が提供され、作動時に外科的処置を及ぼす少なくとも1の作動アセンブリを有する手術用エンドエフェクタと、そこで可換部品を取り外し可能に受けるための受け部とを具え、前記受け部は通信接続を有する。ハンドルは、前記作動アセンブリを作動させるべく前記エンドエフェクタに接続され、前記ハンドルは1本の配線(a 1 wire)を通して前記可換部品を認証する前記通信接続に電氣的に接続される第1のマイクロプロセッサを有するコントローラと、少なくとも前記コントローラに電力を供給すべく前記コントローラに電氣的に接続される電源とを具える。可換部品は前記受け部内での着座位置と、前記受け部に対して非着座位置とを有し、前記受け部に取り外し可能に接続可能であり、前記可換部品が着座位置にある場合、前記通信接続に電氣的に取り外し可能に接続される1ワイヤ暗号化装置を具える。前記暗号化装置は前記可換部品が前記着座位置にある場合、前記第1のマイクロプロセッサで前記可換部品を暗号認証するようプログラムされる第2のマイクロプロセッサを有し、前記1本の配線を通して前記電源により電源を供給する。前記暗号化装置と前記コントローラは共通のアース端子を共有する。

【0012】

本発明の別の構成では、在庫を構成する複数の可換部品が提供され、各部品は在庫内の一意の識別子を有し、前記部品の1つを少なくとも部分的に使用したら、暗号化装置は使用状況を前記部品の識別子と関連づける。

【0013】

本発明のさらなる構成では、1の部品に使用状況があったら、エンドエフェクタで当該1の部品のその後の使用が回避される。

【0014】

本発明の付随的な構成では、暗号化装置は50mm²未満のプリント基板のフットプリントを有する。

【0015】

本発明の特徴として考えられる別の構成が、添付のクレームに記載されている。

【0016】

以下に本発明を可換部品の暗号認証を用いた電気自己駆動式手術器具として図示し説明するが、これに拘わらず、図示された詳細に限定されるべきではなく、本発明の範囲およびクレームの均等の目的や範囲を逸脱することなく、様々な変形および構造的な変更を施すことが可能である。

【0017】

本発明の構造および動作方法は、しかしながら、その付加的な目的およびその利点とと

10

20

30

40

50

もに、添付の図面を参照した場合に、以下の実施例の説明により最もよく理解されるであろう。

【図面の簡単な説明】

【0018】

本発明の実施例の利点が、添付の図面を参照しながら、好適な実施例についての以下の詳細な説明から明らかとなる。

【図1】図1は、本発明にかかる電気ステープラの例示的实施例の側部からみた斜視図である。

【図2】図2は、図1のステープラの側部断面図であり、ハンドル本体の右半分と近位の基幹プレートが除去された状態を示す。

【図3】図3は、図1のステープラのアンビル制御アセンブリの分解斜視図である。

【図4】図4は、図3のアンビル制御アセンブリの拡大分解断面斜視図である。

【図5】図5は、図1のステープラのステープル射出制御アセンブリをその後側から見た部分斜視図である。

【図6】図6は、図1のステープラのステープル射出制御アセンブリの分解斜視図である。

【図7】図7は、図6のステープル射出制御アセンブリの拡大分解部分斜視図である。

【図8】図8は、図1のステープラのハンドル本体部の下から見たアンビル制御アセンブリの部分水平断面図である。

【図9】図9は、図8のアンビル制御アセンブリの近位部から見た部分拡大水平断面図である。

【図10】図10は、図8のアンビル制御アセンブリの中間部の下から見た部分拡大水平断面図である。

【図11】図11は、図8のアンビル制御アセンブリの遠位部の下から見た部分拡大水平断面図である。

【図12】図12は、図1のステープラのハンドル本体部の右側から見た部分垂直断面図である。

【図13】図13は、図12のステープラの近位ハンドル本体部の右側から見た部分拡大垂直断面図である。

【図14】図14は、図12のステープラの中間ハンドル本体部の右側から見た部分拡大垂直断面図である。

【図15】図15は、図14のステープラの中間ハンドル本体部の右側から見たさらに拡大した部分垂直断面図である。

【図16】図16は、図12におステープラの遠位ハンドル本体部の右側から見た部分拡大垂直断面図である。

【図17】図17は、図1のステープラのアンビルの一部の斜視図である。

【図18】図18は、図1のステープラの、アンビルと、ステープルカートリッジと、フォーススイッチと、着脱式カートリッジ取付アセンブリとを具える着脱型ステープラアセンブリの部分断面図である。

【図19】図19は、図1のステープラのハンドル本体部の上から見たアンビル制御アセンブリの部分水平断面図であり、アンビルロッドが1cmのアンビル閉じ位置にある状態を示す。

【図20】図20は、図1のステープラのハンドル本体部の、ハンドル本体部の左側から見た側面図であり、左ハンドル本体と回路ボードを取りのぞかれアンビルロッドが完全に伸ばした位置にある状態を示す。

【図21】図21は、図20のステープラのハンドル本体部の側面図であり、アンビルロッドが1cmのアンビル閉じ位置にある状態を示す。

【図22】図22は、図1のステープラのハンドル本体部の上から見たアンビル制御アセンブリの部分水平断面図であり、アンビルロッドが安全ステープル射出位置にある状態を示す。

10

20

30

40

50

【図 2 3】図 2 3 は、図 1 のステーブラのハンドル部の上から見たアンビル制御アセンブリの部分水平断面図であり、アンビルロッドを完全に伸ばした位置にある状態を示す。

【図 2 4】図 2 4 は、図 1 のステーブラのハンドル本体部の上から見た射出制御アセンブリの部分水平断面図である。

【図 2 5】図 2 5 は、図 2 4 の射出制御アセンブリの近位部の上から見た部分拡大水平断面図である。

【図 2 6】図 2 6 は、図 2 4 の射出制御アセンブリの中間部の上から見た部分拡大水平断面図である。

【図 2 7】図 2 7 は、図 2 4 の射出制御アセンブリの遠位部の上から見た部分拡大水平断面図である。

【図 2 8】図 2 8 は、図 1 のステーブラのステーブルカートリッジ取り外しアセンブリの、陰影付の一部透過した部分拡大図である。

【図 2 9】図 2 9 は、図 1 のステーブラのステーブルカートリッジ取り外しアセンブリの、陰影付の一部透過した部分拡大図である。

【図 3 0】図 3 0 は、本発明にかかる医療器具の可換部品用の暗号化回路の一例の概略回路図である。

【図 3 1】図 3 1 は、多様な負荷において図 3 2 のピニオンがラックを動かす速度を示すバーグラフである。

【図 3 2】図 3 2 は、ギアボックスとラックの間の本発明にかかるギアトレインの簡略化した例示部分の部分斜視図である。

【図 3 3】図 3 3 は、エンドエフェクタの例示的实施例の間接部の遠位端部の部分垂直長手断面図であり、内側チューブ、プッシュロッドブレードサポート、アンビル、閉鎖リング、およびステーブルスレッドの約半分を取り除いた状態を示す。

【図 3 4】図 3 4 は、本発明にかかる電源用のスイッチングアセンブリの一例の概略回路図を示す。

【図 3 5】図 3 5 は、本発明にかかるモータの前進および後退制御用のスイッチングアセンブリの一例の概略回路図を示す。

【図 3 6】図 3 6 は、本発明にかかる、電源とモータの前進および後退制御用のスイッチングアセンブリの別の例の概略回路図である。

【図 3 7】図 3 7 は、本発明にかかる装置の左側面図であり、外側シェルが除去された状態を示す。

【図 3 8】図 3 8 は、図 3 7 の装置の一部の拡大左側面図であり、左側フレームが除去された状態を示す。

【図 3 9】図 3 9 は、図 3 7 の装置の右側面図である

【図 4 0】図 4 0 は、図 3 8 の装置の一部の拡大右側面図であり、右側フレームが除去された状態を示す。

【図 4 1】図 4 1 は、図 4 0 の装置の一部の右後方から見た斜視図である。

【図 4 2】図 4 2 は、図 4 0 の装置の一部の背面図である。

【図 4 3】図 4 3 は、図 4 0 の装置の一部の左後方から見た斜視図であり、第 1 乃至第 3 のステージカバーが除去された状態を示す。

【図 4 4】図 4 4 は、図 4 0 の装置の一部の右側上方から見た斜視図であり、電源が除去された状態を示す。

【図 4 5】図 4 5 は、図 4 4 の装置の一部の斜視図であり、第 1 の中間部分での手動解放レバーと分離位置でのキャスルギアを示す。

【図 4 6】図 4 6 は、図 4 5 の装置の一部の斜視図であり、第 2 の中間部分での手動解放レバーを示す。

【図 4 7】図 4 7 は、図 4 6 の装置の一部の上面図であり、第 3 の中間部分での手動解放レバーを示す。

【図 4 8】図 4 8 は、図 4 6 の装置の一部の手動解放アセンブリの右側から見た拡大斜視図であり、第 2 のステージ解放ギア、2 つのカムプレート、および上方の歯止めされない

10

20

30

40

50

位置で爪が外された爪ばねを示す。

【図 4 9】図 4 9 は、正面右側の下から見た手動解放レバーの斜視図である。

【図 5 0】図 5 0 は、右後方側の下から見た手動解放レバーの斜視図である。

【図 5 1】図 5 1 は、左後方側の下から見た手動開放レバーの斜視図である。

【図 5 2】図 5 2 は、左側から見たカムプレートの斜視図である。

【図 5 3】図 5 3 は、右側から見たキャスルギアの斜視図である。

【図 5 4】図 5 4 は、左側から見た 4 段ピニオンの斜視図である。

【図 5 5】図 5 5 は、図 4 4 の装置の一部の正面右側上方から見た斜視図であり、爪カムに対する爪を示す。

【図 5 6】図 5 6 は、図 5 5 の装置の一部の斜視図であり、爪カムから外され、ラチェットギアに対向させた爪と、分離位置でのキャスルギアとを示す。

【図 5 7】図 5 7 は、図 4 4 の装置の一部の正面左側上方から見た斜視図であり、中間位置での手動解放を示す。

【図 5 8】図 5 8 は、図 5 7 の装置の一部の斜視図であり、別の中間位置での手動解放を示す。

【図 5 9】図 5 9 は、図 4 0 の装置の一部の拡大右側正面図であり、非作動位置でのエンドエフェクタ制御装置を示す。

【図 6 0】図 6 0 は、図 5 9 の装置の一部の拡大右側正面図であり、部分的に作動された位置でのエンドエフェクタ制御ハンドルを示す。

【図 6 1】図 6 1 は、図 3 7 の装置の一部の軸接続部分の正面右側上方から見た拡大斜視図であり、フレームに固定される取り外し可能なエンドエフェクタを示す。

【図 6 2】図 6 2 は、図 6 1 の軸接続部分の拡大斜視図であり、フレームからエンドエフェクタシャフトを取り外せるよう取り外された軸固定装置を示す。

【図 6 3】図 6 3 は、本発明にかかる装置の外側シェルを示す。

【図 6 4】図 6 4 は、本発明にかかる装置の外側シェルを示す。

【図 6 5】図 6 5 は、本発明にかかる装置の外側シェルを示す。

【図 6 6】図 6 6 は、本発明にかかる装置の外側シェルを示す。

【発明を実施するための形態】

【0019】

本発明の複数の態様が、本発明の特定の実施例にかかる以下の説明および関連する図面に開示される。本発明の目的または範囲を逸脱することなく、代替的な実施例を考案することもできる、さらに、本発明の実施例における公知の要素は、本発明の重要な詳細部がぼやけないよう詳細に説明しないかすることとする。

【0020】

本発明を開示し説明する前に、ここに使用される用語は、特定の実施例を説明するためだけであって、限定するものではないことを理解されたい、本明細書および添付のクレームにおいて、単数形「1 の (a) (an)」および「前記 (the)」は、文脈が違う意味を明確に示していない限り複数形も含むものとする。

【0021】

本明細書では、クレームとともに本発明の新規と思われる特徴を規定していくが、これは添付の図面に関する以下の説明とともに考慮した場合により理解されるものであり、ここでは同じ参照番号が持ち越されるものとする。図面における図は、縮尺通り描かれていない。さらに、これらの図は、コンピュータ援用デザインのコンピュータプログラムを用いて作成されている。このプログラムは、影付または着色された図からワイヤフレーム図へと、何度も特定の構造線および／または面を除去する。したがって、図面は概略として扱われるべきであって、本発明の特徴の説明のために用いられる。

【0022】

図面を詳細に参照すると、最初に、特に図 1、2 において、電気式手術用円形ステープラ 1 の実施例が示されている。本出願では、理解の容易のために、電気駆動式のハンドルを円形手術用ステープルヘッドに付けている。本発明は円形ステープラに限定するもので

10

20

30

40

50

はなく、例えば線形ステープル装置など、様々な手術用ステープルヘッドに適用することができる。このような例示的な実施例は、特に、図37以降に記載されている。

【0023】

電気ステープラ1は、3つのスイッチを有するハンドル本体10を具えている：アンビル開スイッチ20と、アンビル閉スイッチ21と、ステープル射出スイッチ22とである。これらの各スイッチは、ステープラ1のステープル機能を実現するよう回路設計された回路ボード500（図12参照）に電氣的に接続されている。この回路ボード500は、ハンドル本体10に内蔵された電源600に電氣的に接続されている。一実施例では、電源600として2-6個のリチウムCR123またはCR2電池を用いる。例えば充電式バッテリーや、送電線に接続された電力コンバータなど、他の電源の実施例も可能である（後者の実施例では、ステープラは自家動力または自己独立式ではない）。ここで用いられる用語「自家動力」または「自己独立式」は、電源（600）について用いられる場合は交換可能であり、この電源が完全かつ独立したユニットであってそれ自体が外部電源を用いることなく自力で動作可能であることを意味する。

【0024】

図に示す回路ボード500の導電ワイヤまたは導電配線は、例えばオン／オフスイッチ12、組織圧迫インジケータ14、アンビルおよび射出スイッチ20、21、22、回路ボード500、および電源600など、ステープラ1のすべての電子パーツを接続する。しかしながら、これらのワイヤおよび導電体は、理解と明確化のため図示しない。

【0025】

ハンドル本体10の遠位端部は、剛性アンビルネック30の近位端部に連結されている。この連結の反対側、アンビルネック30の遠位端部には、ステープルカートリッジ50とアンビル60をここに着脱可能に取り付ける連結具40がある。代替的に、ステープルカートリッジ50は、ステープラ1の使い捨て構造として着脱可能でなくてもよい。これらの連結について、以下により詳細に説明する。

【0026】

図2は、ハンドル本体10の右半分と回路ボード500を除去したハンドル本体10を示す。以下に説明するように、近位の基幹プレート70も図2で除去されており、右側から見たハンドル本体10の内部要素が見えるようになっている。図2で見えるものは、ハンドル本体10内に2つの内部要素の軸があることである。第1の軸は、図2において比較的水平方向のステープル制御軸80である。このステープル制御軸80は、ステープルの動作を制御する要素が位置する中心線である。第2の軸はアンビル制御軸90であり、前記ステープル制御軸80に所定の角度で配置される。このアンビル制御軸90は、アンビルの動作を制御する要素の中心軸である。これらの軸80、90を分けることにより、電気ステープラ1が、手術者の手におさまるのに十分に小さく、必要なすべての方向や向きの移動から手術者の制限となるような多くのスペースを占めるものではないハンドル本体10を用いて駆動可能である。

【0027】

ハンドル本体10の内部には、すべての電機部品の電力（例えばバッテリー電力）を制御するオン／オフスイッチ12（例えば、グレネードピン）と、組織圧迫インジケータ14とが示されている。この組織圧迫インジケータ14は、以下により詳細に示すように、施術者にアンビル60とステープルカートリッジ50の間の組織の圧迫が予め設定された圧迫力を超えたか否かを示す。このインジケータ14は、2006年5月19日に出願され継続中の米国暫定特許出願第60/801,989号、名称「フォーススイッチ」（その全体が参照として本書に組み込まれている）に開示されたフォーススイッチ400に付随している。

【0028】

アンビル制御軸90に沿った要素は、アンビル制御アセンブリ100を構成する。アンビル制御フレーム110がアンビル制御軸90に整列しており、アンビル制御アセンブリ100の様々な部品をそこに収容および／または固定している。このアンビル制御フレー

10

20

30

40

50

ム 1 1 0 は、近位のマウント 1 1 2 と、中間マウント 1 1 4 と、遠位のマウント 1 1 6 とを具える。これらのマウント 1 1 2、1 1 4、1 1 6 はそれぞれ、制御フレーム 1 1 0 に取付可能または一体構成である。例示的实施例では、製造の容易性のために、近位のマウント 1 1 2 は 2 つの半分からなりフレーム 1 1 0 と別であり、中間マウント 1 1 4 はフレーム 1 1 0 とは別である。

【0029】

アンビル制御アセンブリ 1 0 0 の近位端部には、アンビルモータ 1 2 0 がある。このアンビルモータ 1 2 0 は、駆動モータと、本来のモータ回転速度を所望の出力駆動軸速度に変換するのに必要なギアボックスとを具える。この例では、駆動モータは本来の速度が約 1 0, 0 0 0 r p m であり、ギアボックスはこの速度を、アンビルモータ 1 2 0 の遠位端部から延びる駆動軸 1 2 2 において約 5 0 乃至 7 0 r p m に下げる。このアンビルモータ 1 2 0 は、近位のマウント 1 1 2 の内部で長さ方向および回転方向ともに固定されている。

10

【0030】

モータシャフトカブラ 1 3 0 が、駆動軸 1 2 2 を回転可能に固定しており、駆動軸 1 2 2 の回転がモータカブラ 1 3 0 の対応する回転へと変換される。

【0031】

カブラ 1 3 0 の遠位には、回転ナットアセンブリ 1 4 0 が位置している。このナットアセンブリ 1 4 0 は、本実施例では、近位の半ナット 1 4 1 と、この近位の半ナット 1 4 1 に超軸方向に固定される回転可能な遠位の半ナット 1 4 2 の 2 つの部品でなる。これらの半ナット 1 4 1、1 4 2 は、望む場合は一体であってもよい。ここで、製造の容易さのために 2 つの半分として図示している。このナットアセンブリ 1 4 0 の近位端部は、カブラ 1 3 0 の遠位端部に回転可能に固定されている。これら 2 つの連結部品を長さ方向に通る長さ方向に回転するサポートが、中間マウント 1 1 4 および遠位のマウント 1 1 6 に支持されている。

20

【0032】

近位のナットブシュ 1 5 0 (図 3 参照) が中間マウント 1 1 4 と近位の半ナット 1 4 1 の間に配置され、遠位のナットブシュ 1 6 0 が遠位のマウント 1 1 6 と遠位の半ナット 1 4 2 の間に配置され、これらの部位に効果的にスピンしハンドル本体 1 0 とアンビル制御フレーム 1 1 0 内で摩擦がないようにしている。これらのブシュ 1 5 0、1 6 0 は、様々なベアリング材料であってもよく、例えば、青銅などの金属やナイロンなどの重合体であってもよい。回転するナットアセンブリ 1 4 0 とカブラ 1 3 0 の長手方向の摩擦をさらに低減すべく、近位のブシュ 1 5 0 と近位の半ナット 1 4 1 の間にスラストワッシャ 1 7 0 が配置されている。

30

【0033】

カブラ 1 3 0 とナットアセンブリ 1 4 0 の回転は、ネジロッド 1 8 0 の前進および収縮に用いられ、これがアンビル 6 0 を伸ばしたり縮めたりする。このネジロッド 1 8 0 は、図 3、4 にさらに詳細に分解図で示され、以下により詳細に説明される。ロッドサポート 1 9 0 がアンビル制御フレーム 1 1 0 の遠位端部に取り付けられており、これがナットアセンブリ 1 4 0 の支持面を伸ばしてアンビル制御軸 9 0 に整列しているロッド 1 8 0 が保持される。ロッドサポート 1 9 0 は、これを通るロッド 1 8 0 の部分の外面形状に対応する平滑な内面形状を有する。このように形状を合わせると、ロッド 1 8 0 がサポート 1 9 0 を通ってほぼ摩擦なく近位側や遠位側へ移動可能となる。ロッド 1 8 0 がサポート 1 8 9 を摩擦なく通るのを改善すべく、例示的实施例では、円筒形のロッドブシュ 1 9 2 がサポート 1 9 0 とロッド 1 8 0 の間に配置される。このロッドブシュ 1 9 2 は、サポート 1 9 0 の内部に収まっているため図 2 では見えない。しかしながら、このロッドブシュ 1 9 2 は、図 3、4 の分解図では見える。ロッドブシュ 1 9 2 が正しい位置にあると、サポート 1 9 0 の内面形状がロッドブシュ 1 9 2 の外面形状に対応し、ロッドブシュ 1 9 2 の内面形状がこれを通るロッド 1 8 0 の部分の外面形状に対応する。このロッドブシュ 1 9 2 は、例えば、青銅などの金属や、ナイロンなどの重合体とすることができる。

40

50

【0034】

ステープル制御軸80に沿った要素は、ステープル制御アセンブリ200を構成する。ステープル制御アセンブリ200は、図5に近位側斜め上から見た斜視図を示す。このステープル制御アセンブリ200の近位端部は、ステープルモータ210を具える。このステープルモータ210は、駆動モータと、本来のモータ回転速度を所望の回転速度に変換するのに必要なギアボックスとを具える。この例では、駆動モータは本来の速度が約20,000rpmであり、ギアボックスはこの速度を、ギアボックスの遠位端部の出力駆動軸において約200rpmに下げる。この駆動軸212は図5には現れていないが、図6、7の分解図に示されている。

【0035】

ステープルモータ210は、長手方向と回転方向ともにモータマウント220に固定されている。モータマウント220の遠位端部は、中間連結マウント230となっている。この連結マウント230は、例えば図6に示す遠位プレート232を具える。遠位プレート232は、連結マウント232から移動可能であり、回転スクリュ250がこれらの間に保持されている。この回転スクリュ250がステープルカートリッジ50からステープルを射出する駆動力として作用する。駆動軸212の回転運動を回転スクリュ250に変換する効率は、ステープラ1が必要とする250ポンド以上の縦のステープル射出力を供給するための能力を実質的に低減する要素となる。したがって、スクリュ250の実施例は、アクメ形状ネジを有する。

【0036】

ここで、駆動軸212からスクリュ250の回転を効率的に結合するのに2つの例示的な方法がある。第1は、ステープルモータ210が「ゆるく」ハンドル本体10に規定されるチャンバ内に収容されており、回転しないが半径方向に動くことができ、したがって長手方向に安定しているが自由に動くことができる。この構成では、ステープルモータ210は、「自力で中心を探し」て駆動軸212の軸をスクリュ250の軸に整列させ、本実施例ではこれもまたステープル制御軸80である。

【0037】

駆動軸212とスクリュ250を整列させる第2の実施例が、例えば図1乃至図5に示されている。本実施例では、フレキシブル結合部240の近位の端部が、（長手方向および回転方向ともに）駆動軸212に固定されている。この連結は、駆動軸212の遠位端部をフレキシブル結合部240の近位ボア241内にはめ込むことで達成される。図12を参照されたい。次に駆動軸212は、近位の止めネジ213でそこに固定される。このスクリュ250は、フレキシブル結合部240の遠位ボア242内に適合し遠位の止めネジ252でそこに固定される近位の伸長部251を具える。これらの図面は、フレキシブル結合部240がその中間部に凸部を設けて示すことに留意されたい。連結部240の一実施例では、この部品はアルミニウムまたは成型プラスチックであり、その中央部分の周囲に螺旋形またはヘリックス形の切り欠きを有する。この構成において、連結部240の一端部は他端に対していかなる放射方向（360度）に動かすことができ（ジンバル内のように）、これにより駆動軸212とスクリュ250の中心軸を効果的に整列させるべく望み通り曲げることができる。

【0038】

スクリュ250の近位の伸長部251は、中間の連結マウント230内にあり、これを通るボア231の直径より実質的に小さい径を有する。このボア231は、その遠位側に直径が2段階大きくなっている。最初の直径が大きくなる段階は、近位の半径スクリュブシュ260に適合するサイズであり、中間連結マウント230より軟質な材料で形成される。この近位の半径スクリュブシュ260は、スクリュ250を軸的に整列させるのみであり、長手方向の推力を吸収したり伝達したりするものではない。第2の直径が大きくなる段階は、スクリュ250用の近位のスラストベアリング270に適合するサイズである。このスラストベアリング270の一実施例では、近位と遠位のプレートで、ベアリングボール保持プレートとベアリングボールを挟んでいる。このスラストベアリング270は

10

20

30

40

50

、ステープルカートリッジ50内のステープルを射出するときに長手方向に250ポンドまでの力がかかる際に、駆動軸212の方にかかる長手方向の推力のすべてを吸収する。スクリュ250の近位の伸長部251は、スクリュブシュ260とスラストベアリング270の各内面ごとに直径サイズが異なる。モータマウント220と連結マウント230は、したがって、フレキシブル連結部240を間に保持する2つの装置を形成する。

【0039】

回転スクリュ250は、近位の半径スクリュブシュ260と似た遠位の半径スクリュブシュとともに、遠位プレート232内に保持されている。このため、スクリュ250は遠位プレート232内で回転自在である。スクリュ250の回転を線形の遠位動作へと変換すべく、スクリュ250は移動ナット290にねじ込まれる。このナット290の動きは、ステープルの動作完了に必要な移動量に制限されており、換言すれば、ナット290はステープルカートリッジ50とアンビル60との間で閉じたステープルを形成するとともに、もしあれば、ステープルカートリッジ50内で切断ブレードを伸長させ、さらにこれを引っ込めるのに十分な距離だけ移動する必要がある。ナット290が最も近位の位置にあるとき（例えば図12参照）、ステープルは射出できる状態で静止している。ナット290が最も遠位の位置にあるとき、ステープルは、ステープルカートリッジ50とアンビルの間に挟まれた組織を通してこれを留め、もしあればナイフが、切断すべき組織を完全に通過する。ナット290の最も遠位の位置は、遠位プレート232の位置により制限される。したがって、スクリュ250のネジの長手方向の長さと、遠位プレート232の位置が、ナット290の遠位の動きを制限する。

【0040】

スクリュ250とナット290の摩擦を低減すると、カートリッジブランジャ320を介してステープルカートリッジ50へ伝達される力の合計ポンドが有意に低減するのに寄与する。このため、スクリュ250およびナット290の材料と、スクリュ250のピッチとを最適のように選択することが望ましい。ナット290の製造に低摩擦ポリマを使用すると、カートリッジブランジャ320の遠位端部に、ステープルを有効に出すのに必要な力の量である、約250ポンドの長手方向の力を伝達するのに十分な摩擦が低減される。この所望の特性を示す2つの特定の材料の例は、この技術分野でDEL R I N（登録商標）A F混合A c e t a l（T E F L O N（登録商標）繊維をDEL R I N（登録商標）アセタール樹脂に均一に分散させたものを組み合わせた熱塑性材料）と、R U L O N（登録商標）（T F Eフルオロカーボンから合成される）または他の同様の低摩擦ポリマである。

【0041】

ナット結合ブラケット300が、長さ方向にナット290に固定されており、これはナット290と一緒に移動する。このナット結合ブラケット300は、比較的ソフトで、つるつるしたナット材料に支持を提供する。図示する実施例では、このブラケット300は、ナット290の外形に対応する形状の内部空洞を有する。したがって、ナット290は結合ブラケット300にぴったりと嵌り、ナット290の動きはナット結合ブラケット300の対応する動きへと伝達される。ナット結合ブラケット300の形状は、本実施例では、これを取り囲む要素や、伝達すべき長手方向の力によって決定する。例えば、ナット290の遠位には、内部に遠位プレート232を受ける形状の内部空洞302がある。このナット結合ブラケット300はまた、強化ロッド310を内部に受ける遠位のハウジング304を具える。この強化ロッド310は、長手方向の指示を増大し、ナット290とカートリッジブランジャ320（図5参照）の連結の一部を構成し、これはハンドル本体10とステープルカートリッジ50の間の最後の可動リンクである。ナット結合ブラケット300の遠位端部と強化ロッド310の間に配置された射出ブラケット330が、ナット結合ブラケット300とロッド310の連結を強化している。

【0042】

ステープラ1の多様な要素が互いに連結されて、主軸または脊椎部を構成する。この主軸は、多方面への安定性を提供するフレームであって、（近位から遠位まで）4つの主た

る部品からなる：アンビル制御フレーム 110 と、近位の主軸プレート 70 と（図 3、4、6、7 に示す）、遠位の主軸プレート 340 と、アンビルネック 30 とである。これら 4 つの部品はそれぞれ、長さ方向と回転方向ともに互いに固定されており、この順番でハンドル要素の残りが取り付けられる骨格を構成する。これらの要素の縦の支持はハンドル本体 10 の内面輪郭により達成され、一実施例においてこれは左半分 11 と右半分 13 の 2 つの半分で構成される。代替的に、支持は、打ち抜かれるかハンドル半分 11、13 と組み合わせさせた単一のフレームであってもよい。

【0043】

アンビル制御アセンブリ 100 の機能が、図 17 乃至 27 に関連して開示されている。ステープラ 1 でステープル処置を行うには、アンビル 60 全体をステープラ 1 から取り外す。アンビル開スイッチ 20 を押すと、ステープルカートリッジ内に収容されスクリュ 250 に長さ方向に固定的に連結されたトロカールチップ 410 の遠位端部が伸びる。すると、トロカールチップ 410 の頂部が、留められる組織を貫通あるいは穿刺する。この時点で利用者は、アンビル 60 を組織の反対側からトロカールチップ 410 に付け替えて、そこにアンビル 60 を固定することができる（図 18 参照）。アンビル閉スイッチ 22 は、アンビル 60 をステープルカートリッジ 50 に対して閉じるのを開始し、その間のアンビルカートリッジギャップ 62 に組織を挟むように作動する。

【0044】

アンビル 60 のトロカールチップ制御動作が行われるかを説明するために、図 8 乃至 10、14、15、18 を参照されたい。図 15 の点線で示すように、ロッドガイドピン 143 が遠位の半ナット 142 の中央ボア 144 内に位置づけられる。ネジロッド 180 が回転ナット 140、141、142、に螺入するにつれ、ピン 143 はネジ 182 の近位端部を捕らえて内部にピン 143 を取り囲む。これにより、ナット 140 がネジ 182 内のピン 143 とともに回転すると、ナットの回転方向により、ロッド 180 が近位側または遠位側に移動する。ネジ 182 は図 14、15 に示すように可変ピッチを有し、アンビル 60 を異なる長手方向の速度で進ませる。ピン 143 が長い（低い）ピッチのネジ部 183 内にあるとき、アンビル 60 は長さ方向に早く移動する。これと対象に、ピン 143 が短い（高い）ピッチのネジ部 184 内にあるとき、アンビル 60 は長さ方向にゆっくり進む。ピン 143 は、長いピッチのネジ部 183 内でネジ 182 が接触する唯一の部分であることに留意されたい。このように、ピン 143 は、この時点ではロッド 180 に作用する長手方向の力全体にさらされる。このピン 143 は、このような力に耐えるのに十分な強度があるが、アンビル 60 が間の組織の周りで閉じる際に生じるすべての長さ方向の力に耐えるほどではない。

【0045】

図 14 に示すように、ピッチが短いネジ部 184 に、近位の半ナット 141 の中央ボア 144 の近位端部の対応する内側ネジ 145 と係合するよう、ロッド 180 が設けられている。ピッチが短いネジ部 184 が内側ネジ 145 に係合すると、ネジ部 184 の側面全体が内側ネジ 145 に接触する。この接触面は、ピン 143 とネジ 182 のいかなる部分との接触よりも大きく、このため、アンビル 60 が閉じる際、特にアンビル 60 が組織の周りでステープル射出状態にあるときに発生する長さ方向の力のすべてに耐えることができる。例えば、本実施例では、ピン 143 は約 30 乃至 50 ポンドの長さ方向の力を受ける。これは、400 ポンドまでの長さ方向の力に耐えうるネジと比較すると、約 10 対 1 の差がある。

【0046】

アンビル制御アセンブリ 100 の代替的な実施例では、ロッド 180 の複合的なネジ全体が取り除かれる。このような場合、ロッド 180 は単一のネジピッチであり、アンビルモータ 120 が単一ネジロッド 180 の長さ方向の位置によって、（回路ボード 500 の関連するプログラミングを通じて）異なる速度で駆動される。

【0047】

モータ 120、210 を駆動する様々な実施例で、制御プログラムは様々な形態をとり

10

20

30

40

50

うる。一実施例では、バッテリー駆動回路ボード500のマイクロコントローラがパルス変調（例えばパルス幅、パルス周波数）をかけて、いずれかまたは双方のモータを駆動してもよい。さらに、ステープラ1はデューティサイクルが低い装置であり、または使い捨て装置であるため、構成要素を許容の製造スペックを超えて駆動することができる。例えば、ギアボックスはその指定速度より上のトルクをかけることができる。また、例えば6ボルトモータなどの駆動モータを、例えば12ボルトで駆動してもよい。

【0048】

アンビル60が伸びた位置から組織を圧迫しないか僅かに圧迫する位置への閉動作は、挟まれた組織にダメージを与えることなく迅速に行われる。このため、ピッチの長いネジ部分183により、利用者はアンビル60を組織へと、組織圧迫前状態に素早く閉じることができる。その後、好ましくは組織をゆっくりと圧迫し、これにより利用者が組織を過度に圧迫してしまうのを回避することができる。このようにして、この後者の動作範囲において短いピッチのネジ部184を利用して、利用者が大きな度合いで制御することができる。この圧迫中、図18に示し継続中の米国暫定出願番号60/801,989で説明されているフォーススイッチ400を用いて、組織圧迫インジケータ14を介して利用者に組織がフォーススイッチ400内のスプリング420の予荷重より大きな力で圧迫されているかを示すことができる。図18は、米国暫定出願番号60/801,989の第1実施例に記載された通常は開いた状態のフォーススイッチ400の実施例を示すことに注意されたい。組織の圧迫を測定するのにひずみゲージを用いてもよい。

【0049】

図19乃至23は、アンビル伸長位置（図19乃至20参照）から1cm閉鎖距離位置（図21参照）、ステープル射出可能位置（図22参照）、および最終的にアンビル完全閉鎖位置（図23参照）へのロッド180の動作を示す。ロッド180の移動は、ロッド180のカム面アクチュエータ185の一部と、ハンドル本体10内に位置された一連のマイクロスイッチの動作レバーまたはボタンとの間の接触により、（回路ボード500を介して）電氣的に制御されている。

【0050】

ロッド180（およびそれ故アンビル60）が完全に伸びた位置にあるとき、ロッド完全伸長スイッチ610の動作レバーをアクチュエータ185が押すように、ロッド完全伸長スイッチ610（図19参照）がハンドル本体10の遠位部に配置されている。1cmスイッチ612がハンドル本体10の中間位置に配置され（図20、21参照）、ロッド180（およびそれ故アンビル60）が完全閉鎖位置の1cm以内にある場合に、ロッド180の1cmカム面部分186が1cmスイッチ612の動作ボタンを押さないようにしている。図22に示すように、1cm閉鎖距離を経た後、カム面アクチュエータ185はステープル射出可能スイッチ614に接触する。アクチュエータ185の下端部は、図22乃至23に示すように、ステープル射出可能スイッチ614のボタンに対して前後両方の側に傾斜しており、このボタンを動作させる2つの傾斜の部分の間の距離（あるいは、その平坦な部分のみ）は、ステープルカートリッジ50内におけるステープルの許容するステープル形成範囲（すなわち安全射出長さ）に対応する。したがって、ステープル射出可能スイッチ614のボタンが最初に押されるとき、アンビル60とステープルカートリッジ50の間の距離は、ステープルを成功裏に射出して閉じる最大範囲である。このボタンが押されると、アンビル60の分離距離（図18参照）は、安全ステープル射出範囲内に留まる。しかしながら、アクチュエータ185がボタンの近くに位置してステープル射出可能スイッチ614のボタンが最早押されなくなった場合、ステープル治療には距離が短すぎるため、ステープルは射出されない。図23は、ロッド180が最も近位の位置にある状態であり、アクチュエータ185の上端部がロッド完全引き戻しスイッチ616のレバーを閉じることにより示されている。このスイッチ616が作動すると、回路ボード500のプログラムが、モータ120がロッド引き戻し方向に切り替わるのを防ぎ、換言すると、これはロッド180が近位の方向に引き戻される場合の止めスイッチとなる。

。

10

20

30

40

50

【0051】

図2、3、11、12、16は、遠位端部が他の装置に接続されていないロッド180の遠位端部を示す（このためフォーススイッチ400の近位端部に接触する）。連結バンドまたは、ロッド180の遠位端部とフォーススイッチ400の近位端部の間のバンドは、明確化のためにのみ図示しない。一実施例では、このプルバンドは平坦で、アンビルネック30を通りフォーススイッチ400の近位端部までカートリッジプランジャ320の湾曲した下側を横切るべく柔軟である。もちろん、フォーススイッチ400がない場合、このバンドはアンビル60の近位端部に着脱可能に接続するトロカールチップ410の近位端部に連結される。

【0052】

ステープル制御アセンブリ200の機能が、図12乃至16、図24乃至27、特に図24を参照して説明される。ステープルモータ210が、モータベアリング222とモータシャフトカバー224との間に保持される。ステープルモータ210の駆動軸が回転可能にフレキシブル結合部240の近位端部に連結され、このフレキシブル結合部240の遠位端部が回転可能にスクリュ250の近位端部に連結され、これがベアリング260、270上で回転する。長手方向に移動するナット290が、結合マウント230と遠位プレート232との間のスクリュ250に螺合している。これにより、駆動軸212の回転が、スクリュ250の対応する回転へと伝達される。

【0053】

ナット結合ブラケット300は、ナット290、強化ロッド310、および射出ブラケット330に長さ方向に固定されている。この射出ブラケット330は、（図示しないステープルドライバを通り）ステープルカートリッジ50（またはステープル）まで延在するカートリッジ320に長さ方向に固定されている。この連結により、ナット290の長さ方向の動きが、カートリッジプランジャ320の対応する長さ方向の移動に変換される。したがって、ステープル射出スイッチ22が作動すると、ステープルモータ210が十分な回数だけ回転され、ステープルがステープルカートリッジ50から完全に射出される（そして、もしあれば切断ブレードが伸長されアンビル60とステープルカートリッジ50の間の組織を完全に切断する）。後述するように、回路のプログラムは、カートリッジプランジャ320を射出後に引き戻し、アンビルとカートリッジ間の隙間62からステープル射出部品および／またはステープルカートリッジ50のブレードのすべての部分を取り除く。

【0054】

このステープル動作の制御は、再び、回路ボード500にワイヤなどの電機接続を介して連結されたマイクロスイッチを通じて行われる。これらの制御スイッチの最初は、近位のステープルスイッチ618であり、ステープル制御アセンブリ200の引き戻しを制御してこのアセンブリ200の最も近位の位置を規定する。このスイッチを作動させるには、ナット結合ブラケット300の側部に隣接するように、動作プレート306を取り付ける。例えば図6、24を参照されたい。このようにして、ナット290が近位に移動してナット結合ブラケット300上のプレート306が近位のステープルスイッチ618を作動させると、ステープルモータ210への電力が取り除かれてステープル制御アセンブリ200の近位方向へのさらなる移動が阻止される。

【0055】

ステープル制御アセンブリ200の動きを制御する第2のスイッチは、強化ロッド310の遠位の側面の反対側に配置されている。図27を参照されたい。この面において、遠位のステープルスイッチ620と接触する長さ方向に調整可能なカム部材312が設けられている。一実施例では、このカム部材312は、強化ロッド310の遠位のボアに螺合するスクリュである。したがって、ナット290が遠位方向に動いてロッド310のカム部材312が遠位のステープルスイッチ620を作動させると、ステープルモータ210への電力が取り除かれてステープル制御アセンブリ200の遠位方向へのさらなる移動が阻止される。

10

20

30

40

50

【0056】

図28、29は、アンビル30の遠位端部の異なるステープルカートリッジ60の取り替えが可能な取り外し可能な連結アセンブリを示す。

【0057】

ハンドル本体10の最も近位のチャンバは、内部に電源600を保持するための空洞を規定している。この電源600は、回路ボード500を介してモータ120、210、およびステープラ1の他の電機部品へと接続されている。

【0058】

ステープラ1の電機部品は、回路ボード500を介した制御に関して説明した。電気ステープラ1は、上述したように、一実施例では、バッテリー駆動されプッシュボタン20、11、22で制御される2つの駆動モータ120、210を具える。各モータ120、210の移動範囲は、移動の端部と移動に沿った中間位置612、614でリミットスイッチ6120、616、618、620により制限される。モータ120、210の制御ロジックは、いくつかの方法で実現することができる。例えば、リレーまたはラダーロジックを用いて、モータ120、210とスイッチ610、612、614、616、618、620の制御アルゴリズムを規定することができる。このような構成は単純だが、制限された制御方法である。より柔軟な方法は、マイクロプロセッサ式制御システムを用いてスイッチ入力を検知し、スイッチをロックし、インジケータライトを作動させ、データを記録し、可聴フィードバックを提供し、視覚ディスプレイを駆動し、同定装置（例えば周波数識別装置（RFID）または暗号識別装置）に問い合わせ、力を感じし、外部装置と

10

20

【0059】

このようなプロセッサへ制御命令を出すソフトウェアが必要である。全体を開発したら、プログラムをプロセッサに書き込み永久的に書き込む。このようなシステムは、制御アルゴリズムの変更が比較的少ない：アップロードされるソフトウェアへの変更は、記述や装置の機械レイアウトを変更することなく、制御とユーザインタフェースを調整する。

【0060】

使い捨て可能な装置では、電源オンの事象は一度きり発生する。このケースにおいて電源オンは、永久的に装置から取り除かれるタブまたは解除具を引っ張ることにより実現する。この取り外しによりバッテリーが接触し、装置の電源が入る。

30

【0061】

装置のいかなる実施例でも、装置の電源が入ると、制御プログラムが実行を開始し、装置を使用可能とする前に、射出サブアセンブリの伸長／収縮および射出の実際の位置の検知を確実にするルーチンに移行し、これはホームイングルーチンと呼ばれる。このホームイングルーチンは、製造者が利用者に輸送する前に実行されてもよい。この場合、ホームイングルーチンが実行され、アセンブリの位置がセットされ、装置が使用可能な状態で利用者に配送される。電源投入時、装置はその位置を確認し、使用可能となる。

40

【0062】

視覚インジケータ（例えばLED）を用いて、利用者にフィードバックを提供する。プッシュボタンスイッチ20、21、22の場合、作動時に点灯（またはバックライト）され、非作動時に消灯するようにしてもよい。このインジケータは、さらなる情報を利用者に伝達すべく点滅してもよい。ボタン押下後の遅延応答の場合、例えば応答差し迫っている場合に、設定された光の点滅速度を段々早くしてもよい。

【0063】

ステープラ1において、プロセッサに位置情報を提供するリミットスイッチを作動させるためのカムが様々な箇所用いられている。多様な長さの線形カムを用いると、位置の範囲を設定することができる。代替的に、リミットスイッチの代わりにエンコーダを用い

50

てもよい（絶対的かつ増分のポジショニング）。リミットスイッチは、オフとオンの2値であってもよい。位置情報の2値入力代わりに、（光エンコーダなどの）エンコーダを用いて、位置情報を提供してもよい。位置フィードバックを提供する他の方法は、サブアセンブリを駆動するモータの端部にパルス発生器を搭載することである。パルスをカウントし、モータの回転から線形移動への変換率を知ることにより、絶対的な位置を得ることができる。

【0064】

プロセッサを用いると、保存データの有用性が生まれる。例えば、装置製造番号やソフトウェアの改訂などの重要な、プレロードされた情報を保存することができる。メモリはまた、ステープラ1の使用におけるデータを記録するのに用いてもよい。すべてのボタン押下、すべてのリミットスイッチの遷移、すべての無駄打ち、すべての完了打ちなどを、後に回収して分析するために保存してもよい。データは、プログラミングポートまたはワイヤレスで取得することができる。一実施例では、一連のボタン押下によって装置を診断モードにすることができる。この診断モードでは、技術者がステープラ1の特定のデータを問い合わせたり、特定のデータを伝送／出力させることができる。このような問い合わせへのステープラ1の応答は、LEDの点滅や、ディスプレイ付きの装置の場合は視覚的な文字データ、あるいは電子データの形態とすることができる。上述したように、ひずみゲージを用いてアナログ出力したり利用可能な歪みバンドを設けてもよい。代替的に、付加的な第2のスプリングと支持部材によりこのバンドを機械的に設定してもよい。

【0065】

シングル射出ステープラ1の制御アルゴリズムの例は、以下のステップを含む：

- ・電源オン
- ・ホームポジションを確認し、必要／所望の場合にホームポジションへ移動
- ・伸長／収縮ボタンをエネイブル（点灯）にし、ステープル射出ボタンをディセーブル（消灯）にする
- ・ステープル射出ボタンを完全に伸ばした（アンビルが取り去られた）後にのみエネイブルにし、伸長／収縮ボタンをエネイブルにしたままその後収縮させる。
- ・ステープル射出ボタンの作動時、フォーススイッチが作動するまでアンビルを引き戻す。
- ・ボタンLEDの点滅により秒読みを開始し、射出サイクルが切迫するごとに点滅速度を速くする。継続的にフォーススイッチを監視し、アンビルを引き戻してフォーススイッチが作動したままとする。
- ・ステープル射出サイクルの間は、どのボタン押下もステープル射出ルーチンを打ち切る。
- ・ステープル射出モータの作動前に打ち切りが生じたら、射出サイクルは停止し、アンビルがホームポジションに伸ばされ、ステープル射出ボタンはアクティブのまま再発射可能となる。
- ・あるいは、射出モータの作動時に打ち切りが生じたら、射出サイクルは停止し、射出モータは引き戻され、アンビルがホームポジションに戻り、射出ボタンは非アクティブとなる。したがって、ステープラ（またはステープルカートリッジ）は使用不可となる。
- ・射出の秒読みが終了したら、ステープル範囲制限スイッチの位置が確認される。ステープル範囲制限スイッチが作動したら、それはアンビルが良好なステープル射出範囲にあることを意味し、ステープル射出モータが作動して射出サイクルが進められる。ステープル範囲制限スイッチが作動しない場合、射出サイクルは打ち切られ、アンビルはホームポジションに戻り、ステープル射出ボタンはアクティブのまま再発射可能となる。
- ・ステープル射出が完了したら、アンビルは閉じ位置に維持され、伸長ボタンのみがアクティブのままとなる。アンビルが少なくともホームポジションまで伸びたら、伸長ボタンと収縮ボタンの双方をアクティブにする。ステープル射出ボタンは、ステープル射出が完了したら非アクティブに維持される。

【0066】

上記サイクル例を通して、ボタン押下、スイッチ位置、打ち切り、および／または射出を記録してもよい。

【0067】

外科的処置において、ステープラは1方向デバイスである。しかしながらテストモードでは、テストユーザがトロカール410とアンビル60を望むまま前後させられることが必要となる。電源オン構造により、利用者がテスト目的のマニュアルモードにできるようになる。このテストモードは解除可能であり、ステープラは使用モードにリセットされてパッケージングや輸送される。

【0068】

パッケージングでは、アンビル60をステープルカートリッジ50から離して位置させることが望ましい（不可欠ではない）。このため、パッケージや輸送のために電源を落とす前に、アンビル60をステープルカートリッジ50から（例えば）1cm離すホームイングシーケンスを設定してもよい。

【0069】

この電気ステープラが荷解きされ手術に利用可能となった場合、利用者はステープラの電源をオンにする（スイッチ12）。ステープル射出位置となり所望の組織圧迫状態となる前にステープルは射出されない。したがって、アンビル／トロカールの伸長／収縮機能は唯一使える機能である。この場合、伸長ボタン20と収縮ボタン21が点灯し、射出スイッチ22は点灯しない（すなわちディセーブルである）。

【0070】

患者に使用する前に、トロカール410を伸ばしてアンビル60が取り外される。ステープラが結腸の吻合に使用される場合、例えば、トロカール410がアンビルネック30に引き戻され、ステープルカートリッジ50とアンビルネック30が肛門経由で結腸内へと、切開部の下流側へと挿入される。アンビル60は、反対に、上流側の腹腔鏡用切開部から挿入され、切開部の上流側に配置される。アンビル60はトロカール410に取り付けられ、2つの部品はステープル可能状態となるまでステープルカートリッジ50の方へ引き戻される。上述のように、アンビルは実質的に間の組織を圧迫せず、特に、乾燥（desiccate）させない距離まで移動する。この地点で、望んだときにステープル射出が生じる。

【0071】

ステープル射出シーケンスは、ステープル射出スイッチ22を作動させることで開始する。ステープル射出は、射出シーケンス中はいつでも打ち切ることができ、これは動作前（漂白サイクル中）や動作中（ステープル形成の有無に拘わらず）であってもである。ステープル射出が行われる前に組織を圧迫して乾燥させる必要があることが判明しているため、ソフトウェアは、ステープル射出の秒読みシーケンスを開始するようプログラムされている。このため、ステープル射出スイッチ22の作動後、アンビル60が間の組織の上に閉じ、この組織の圧迫を開始する。このステープル射出シーケンスは、最適組織圧迫（OTC）測定とフィードバック制御を有し、OTC範囲として参照される所望の圧力範囲に圧迫された場合であって、十分な時間が経って圧迫された組織から水分が除去された場合にのみステープルが射出されるようにする。OTCの範囲は、アンビル60とステープルカートリッジ50の間で圧迫される組織を公知の特性に基づいて予め分かっている（フォーススイッチは、異なる組織OTC範囲用に調整することができる）。フォーススイッチ400は、OTCの測定値を提供し、マイクロプロセッサに特定の組織用のOC Tに達したことを示す情報を供給する。OC Tの状況は、利用者に例えばLEDで示される。

【0072】

射出シーケンスが開始すると、ステープル射出スイッチ22は設定速度で点滅し、その後例えば射出が行われるまで段々早く点滅する。この待ち時間の間に打ち切りが生じなければ、OTC状態が設定された乾燥期間だけ維持され、秒読みの完了後にステープル射出が行われる。円形ステープラで結腸を吻合する例では、切開部のステープル留めは、切開部中央の切開と同時に進行される。この切開はステープルの円形リングの中央の空いた開口

10

20

30

40

50

が、手術完了後に通常の結腸の動作となるよう開口を設けるのに十分となることを保証する。

【0073】

挟まれた組織から水分が除去されたら、組織の圧迫力は自然に低減する。少しの間、この低減はO T C状態が設定範囲外となりうる。このため、プログラムは、フォーススイッチ400から提供される連続的な測定値に依存する閉ループアンビル圧迫制御を有する。このフィードバックにより、圧迫された組織が処置の間と乾燥してからも暫くO T C範囲内に維持される。

【0074】

ステープル射出サイクルの間、利用者による制御スイッチのいかなる操作もステープル射出ルーチンの打ち切りとなるようプログラムされてもよい。ステープル射出モータ210の作動前に打ち切りが生じたら、射出サイクルは停止し、アンビル60はホームポジションへと伸長され、ステープル射出スイッチ22はアクティブに維持され必要に応じて再発射可能である。あるいは、ステープル射出モータ210の動作中に打ち切りが生じたら、射出サイクルは停止しステープル射出モータ210がアンビル60をそのホームポジションまで伸ばす。この時点で、ステープル射出スイッチ22は非アクティブとされる。したがって、ステープラ（または特にステープルカートリッジ）は最早（ステープルカートリッジを交換するまで）使用されない。

【0075】

ステープル射出が実行される前に、ステープル範囲制限スイッチでステープルカートリッジ50とアンビル60の相対位置が確認される。ステープル範囲制限スイッチが作動したら、それはアンビル60が良好なステープル射出範囲にあることを意味し、ステープル射出モータ210が作動して射出サイクルが進められる。ステープル範囲制限スイッチが作動しない場合、射出サイクルは打ち切られ、アンビル60はホームポジションに戻り、ステープル射出スイッチ22はアクティブのまままで再発射可能となる。

【0076】

モータの駆動（または、作動、駆動、制御、動作として参照される）および／または、エンドエフェクタ（例えばアンビルまたはステープラ／カッター）の様々な部分のドライブレインを説明する。このような駆動は利用者による作動ボタンの単一押下や、電源によるモータの単一励起に限るモータ駆動に限る必要はない。装置内の様々なモータの制御は、利用者が作動ボタンを何回も押す必要があり、例えば、1回目はエンドエフェクタの一部の最初の3つの動作を作動させ、2回目は次の3つの動作、3回目は最後の3回の動作である。手術用ステープラの具体例では、第1の作動例でステープルスレッドまたはブレードがロックアウト解除され、第2の作動例で部品が組織の上に移動し、第3の作動例でスレッドがすべてのステープルを超えてステープルカートリッジの端部まで移動する。同様に、モータ駆動は一定である必要はなく、例えば、ブレードがその動作点の端部に到達するまでの移動を開始する時間から一定に駆動される。代わりに、モータはパルスモードで駆動されてもよく、第1の例はエンドエフェクタ機能の作動時に電源からモータに供給される電力の間欠オンオフスイッチングを含む。より具体的にステープラでは、ステープル／カッターがその近位／スタート位置から最も遠位の位置に移動するまで、モータは10回／秒間パルス制御される。このパルス制御は、マイクロプロセッサにより直接制御または制御され、これらのいずれもパルスレートは調整可能である。代替的に、あるいは付加的に、モータはパルス変調駆動され（パルス幅またはパルス周期）、ここではパルスが非常に短い期間で生じる（例えば、一秒に数十、数百、数千、あるいは数百万）。したがって、本書に記載の電源、モータ、および／またはドライブレインが駆動されると、これらの、および他の可能な動作モードが想定され包含される。

【0077】

ステープル射出が完了したら、アンビル60は閉じ位置に維持され、伸長スイッチ20のみがアクティブのままとなる（他のスイッチはすべて非アクティブ）。アンビル60が少なくともホームポジションまで伸びたら、伸長スイッチ20と収縮スイッチ21の双方

がアクティブにされるが、収縮スイッチ 21 はアンビル 60 がホームポジションを越えて閉じるのを防止する。ステーブル射出スイッチ 22 は、ステーブル射出が完了したら非アクティブに維持される。

【0078】

上述したように、アンビルネック 30 は、トロカール 410 に連結された線形フォーススイッチ 400 を収容する。このスイッチ 400 は、所定の引っ張り負荷がかけられると応答 (calibrate) する。この所定の負荷は、ステーブルが行われる前に特定の組織にかけられる所望の圧力に対応するよう設定される。このスイッチ 400 とプロセッサのインタフェースは、確実に OTC 範囲内でのみステーブル射出が行われるようにする。

【0079】

以下のテキストは、上述した本発明にかかる方法を実現するプログラムリストの一実施例である。以下のテキストは例示であり、当業者であれば本発明にかかる方法のプログラミングが、多くの異なる形式で同じ機能を実現しうることを理解するであろう。

【0080】

rev 3c ボード (cb280 チップセット) V8.03 (CS-3c-080306 .CUL) を用いた円形ステープラ用プログラム

'8-3-06

'Modified program to abort with only fire button, added pbcount variable

'Added PWM ramping

'7-28-06

'final tweaks - stan is now an integer etc.

'7-17-06 This version written for the 3c board.

'7-14 DEBUGGING VERSION

'Program written for 3c board using the Cubloc 280 chipset

'Note: this program is a modified version of the ones noted below. All changes not related to the addition of the E/R limit switches

'apply. The programs below were written to deal with the "gray logic" of the 1 cm switch. This version uses

'a limit switch at either end of the extend/retract stage.

'V6.20 Final Version of Gray Logic program as used in prototype 0, serial number 100

'V6.05

'modified the extend to cm 1 and retract to cm 1 routines to make sure that when they are called that they move the motor until the cm

'switch is closed; ie: When the anvil is all the way out and the retract button is pressed, retract the anvil until the cm limit switch

'is closed regardless of whether the retract button is released before the cm switch is closed. Same change for when the anvil is 'extended from the 1 cm position,

'made changes to comments in the extend/retract routines

'V6.02

'added loop requiring the release of both buttons to exit jog routine, and a 1 second delay at the end of jog subroutine before

'going back to main routine

'reformatted datadump labels

'added variables for high and low speed pwm values

'added extend only capability at end of completed fire to prevent crushing stapled tissue

'NOT WORKING- REMOVED added checks To ensure 1 cm switch is made when extending

10

20

30

40

50

Or retracting from the 1 cm And fully extended positions respectively

'V6.01

'All prior versions were made for testing the program on the Cubloc development board. All outputs were pulled LOW. The actual device

'requires all the outputs to be pulled high (+5V). This version is set-up to run on the actual device.

'limited the values of the EEPROM data to 255 max

'added delays before changes in motor direction, made program run smoother

'removed pwmoff commands. They were not allowing the motors to stay on when changing subroutines (for some reason)

'V5.27 'added the recording of jog routine button presses

'added the recording of datadump requests

'V5.26

'added the recording of Extend/Retract button presses

'added serial number field in eeprom

'the datadump routine now keeps running total of data as it is read from eeprom

'V5.25 (circular-stapler-5-25.cul)

'added code to allow storage of data each power on cycle in eeprom

'V5.24 works well, no known bugs (circular-stapler-5-24.cul)

'KMS Medical LLC (c) 2006

'MAP

'P10 Extend Button

'P11 Retract Button

'P12 Fire Button

'P13 Extend Limit

'P14 Retract Limit

'P15 Fire Forward Limit

'P16 Fire Back Limit

'P17 1 cm Limit Switch

'P18 Staple Range Limit Switch

'P19 Force Switch

'P20 Extend Button LED

'P21 Retract Button LED

'P22 Fire Button LED

'P23 Force LED (blue)

'P24 Not USED

'P25 Not USED

'P26 Not USED

'P27 Not USED T28 Not USED

'P29 Staple Range LED (green)

Const Device=cb280 'Comfile Tech. Cubloc CB280 chipset

Dim ver As String*7

ver="3C-8.03" 'set software version here

Dim extendbutton As Byte

Dim retractbutton As Byte

Dim firebutton As Byte

Dim firstout As Byte

Dim firstback As Byte Dim cmstatus As Byte 'lcm limit switch status

```

Dim srstatus As Byte 'staplerange limit switch status
Dim x As Integer
Dim powerons As Byte 'store in eeprom address 2
Dim cycnumf?res As Byte 'store in eeprom (powerons* 5)
Dim cycabortfires As Byte 'store in eeprom (powerons*5)+1
Dim cycers As Byte 'store in eeprom, number of cycle extend/retract presses
Dim cycjogs As Byte
Dim arm As Byte
Dim completefire As Byte Dim staplerangestatus As Byte
Dim bail As Byte
Dim ds As Integer 'eeprom data start location for individual cycle data writing
Dim fast As Integer
Dim slow As Integer Dim extendonly As Byte
Dim extlimit As Byte
Dim retlimit As Byte
Dim speed As Integer
Dim dracula As Byte

'italize outputs
Out 20,0 'extend button LED
Out 21,0 'retract button led
Out 22,0 'fire button led
Out 23,0 'force led
Out 29,0 'staple range led
'initialize variables
firstout=0
firstback=0
completefire=0
arm=0
bail=0
cycnumfires=0
cycabortfires=0
cycers=0
cycjogs=0
extendonly=0

'CHANGE PWM VALUES HERE
fast=60000 'highspeed pwm value
slow=60000 'lowspeed pwm value
speed=0

Output 5 'turns on pwm output for PINCH
Output 6 'turns on pwm output for FIRE

'read totals from eeprom
powerons=Eeread(2, 1 )

Incr powerons 'increment total power on number
If powerons>=255 Then powerons=255 limit number of recorded powerons to an integ
er of one byte max

```

```
Eewrite 2,powerons,1 'write total power on number to eeprom
ds=powerons*5
```

```
'JOG and DATADUMP Check
```

```
'push any button within 2 (or so) seconds to go to jog routine
```

```
'hold all three buttons on at startup to dump the data
```

```
For x=1 To 50
```

```
If Keyin(10,20)=0 And Keyin(1 1,20)=0 And Keyin(12,20)=0 Then datadump 'write al
l stored data to the debug screen
```

```
Exit For
```

```
Elseif Keyin(10,20)=0 Or Keyin(1 1,20)=0 Or Keyin(12,20)=0 Then 'either e/r butt
on or the fire button pressed
```

```
jog
```

```
Exit For
```

```
End If
```

```
Delay 20
```

```
Next
```

```
'ホーミングシーケンス
```

```
cmstatus=Keyin(17,20) 'read the status of the lcm limit switch
```

```
If cmstatus=0 Then
```

```
homeretract
```

```
Elseif cm status=1 Then
```

```
homeextend
```

```
End If
```

```
'Return fire motor to back position
```

```
homefire 'this returns the fire motor to the full retracted condition (P6 limit
switch)
```

```
*****
```

```
'メインループ
```

```
*****
```

```
Do
```

```
'Debug "Main Loop",Cr
```

```
'Delay 1000
```

```
cmstatus=Keyin( 17,20) 'read the 1 cm switch
```

```
'staplerangestatus=Keyin(5,20) 'read the staplerange limit switch
```

```
extendbutton=Keyin( 10,20)
```

```
retractbutton=Keyin(1 1 ,20)
```

```
firebutton=Keyin(12,20)
```

```
If cmstatus=0 And Keyin(13,20)<>0 Then
```

```
Out 20,1 'turn extend led on
```

```
Out 21,1 'turn retract led on
```

```
Elseif cmstatus=0 And Keyin(1 3,20)=0 Then
```

```
Out 20,0 'turn off extend led because extend limit met
```



```

Out 21,1 'turn on retract limit
Elseif cmstatus=1 Then
Out 20,1
Out 21,0
End If

```

```

'check firebutton led status
If firstout=1 And firstback=1 And arm=1 And completef?re<>1 And cmstatus<>0 Then
Out 22,1 'turn on fire button led
Else
Out 22,0 'turn off fire led
End If

```

10

```

'check for extend retract button press
If extendbutton=0 And cmstatus=0 Then
extend
Elseif cmstatus=1 And extendbutton=0 Then
extend
End If

```

20

```

If retractbutton=0 And cmstatus=0 Then 'And extendonly=0
retract
End If

```

```

'check for firebutton press
If firebutton=0 And firstout=1 And firstback=1 And arm=1 And completefire<>1 And
cmstatus<>0 Then initialfire

```

```

Loop 'keep looping til powerdown
End 'End of program

```

30

```

*****
サブルーチン
*****

```

```

'ホーム：c mスイッチまで引き戻す＝押下なし

```

```

Sub homeretract() 'retract until 1 cm switch is open
'Debug "Homeretract",Cr
'Delay 1000
Pwm 0,slow,60000
Do Until Keyin(17,20)=1 'retract until 1 cm switch is open
Out 31,1 'ER motor reverse
Loop
Out 31,0 'er motor off
Out 21 ,0 'turn retract led Off
Out 20,1 'turn extend led On
Pwmoff 0 'turn pwm off
End Sub
'

```

40

50

'ホーム：c mスイッチまで伸長＝押下あり

Sub homeextend() 'extend until 1 cm switch is closed

'Debug 'Homextend",Cr

'Delay 1000

Pwm 0,slow,60000

If Keyin(17,20)=1 Then

Do Until Keyin(17,20)=0 'now the 1 cm switch is pressed

Out 30, 1 'ER motor forward DDD

Loop

End If

Out 30,0 1DDD

Pwmoff 0 Delay 300

homeretract 'once the switch is made, call homeretract

End Sub

'射出モータホーミングルーチン

Sub homefire()

'Debug "Homefire",Cr

'Delay 1000

Pwm 1,slow,60000

Do Until Keyin(16,20)=0 'retract firing stage until back switch is closed

Out 33,1

Loop

Out 33,0 Pwmoff 1

End Sub

'JOG ルーチン '

Sub jog()

Out 20,1

Out 21,1

Do

Delay 25

If Keyin(10,20)=0 And Keyin(11,20)=0 Then Exit Do 'if both buttons pressed, exit jog routine and start homing routine after 1 second delay

If Keyin(10,20)=0 And Keyin(11,20)<>0 And Keyin(12,20)<>0 Then

Pwm 0,slow,60000

Out 30,1 'extend motor forward

Do Until Keyin(10,20)<>0 Or Keyin(13,20)=0

Out 30,1 'extend motor on forward DDD

Loop

Out 30,0 'extend motor off forward DDD

Pwmoff 0

Incr cycjogs

If cycjogs>=255 Then cycjogs=255

```
Eewrite ds+3,cycjogs,l
End If
```

```
If Keyin(l 1,20)=0 And Keyin(10,20)<>0 And Keyin(12,20)<>0 Then
Pwm 0,slow,60000
Do Until Keyin(l 1,20)<>0 Or Keyin(14,20)=0
Out 31,1 'extend motor reverse
Loop
Out 31,0 'extend motor off reverse
Pwmoff0
Incr cycjogs
If cycjogs>=255 Then cycjogs=255 Eewrite ds+3,cycjogs,l
End If
```

10

```
If Keyin(12,20)=0 And Keyin(10,20)=0 Then 'jog the fire motor forward
Pwm 1,slow,60000
Do Until Keyin(l 0,20)<>0 Or Keyin(12,20)<>0 Or Keyin(15,20)=0
Out 32,1 'fire motor forward
Loop
Out 32,0 'fire motor off forward
Pwmoff 1
Incr cycjogs
If cycjogs>=255 Then cycjogs=255
Eewrite ds+3,cycjogs,l
End If
```

20

```
If Keyin(12,20)=0 And Keyin(l 1,20)=0 Then 'jog the fire motor reverse
Pwm 1,slow,60000
Do Until Keyin(l 1,20)<>0 Or Keyin(12,20)<>0 Or Keyin(16,20)=0
Out 33,1 'fire motor reverse Loop
Out 33,0 'fire motor off reverse
Pwmoff 1
Incr cycjogs
If cycjogs>=255 Then cycjogs=255
Eewrite ds+3,cycjogs,l
End If
```

30

```
Loop
```

```
Do Until Keyin(l 0,20)=I And Keyin(l 1 ,20)=I 'let off both buttons before exiting jog routine
Delay 10
Loop
Out 20,0 'turn on e/r button leds
Out 21,0
Delay 1000
End Sub
```

40

'伸長制限を満たすまで伸長する

50

```

Sub extend()
Out 22,0 'turn off fire button led while extending
Out 21,0 'turn off retract button led while extending

Pwm 0,fast,60000
Do Until Keyin(10,20)=1 Or Keyin(13,20)=0 'extend until either the extend limit
is closed or the extend button is released
Out 30,1 'ER motor forward DDD
Loop
Out 30,0 'DDD
10

If firstout=0 Then 'this will keep the extend motor going on the first extension
until the anvil is all the way out
Do Until Keyin(13,20)=0
Out 30,1 'DDD
Loop
End If
Out 30,0 'DDD
Pwmoff 0
Incr cycers
20
If cycers>=255 Then cycers=255
Eewrite ds+2, cycers, 1
If Keyin(13,20)=0 Then firstout=1 'set the firstout flag to enable fire button
Out 20,0 'turn off extend led
End If
End Sub

' c mスイッチが開になるまで収縮

Sub retract()
30
Out 22,0 'turn off fire button led while retracting
Out 20,0 'turn off extend button led while retracting

Pwm 0,fast,60000
Do Until Keyin(11,20)=1 Or Keyin(17,20)=1 'retract until either the lcm switch g
oes open or the extend button is released
Out 31,1 'ER motor reverse
Loop
Out 31,0
40
Pwmoff 0
Incr cycers
If cycers>=255 Then cycers=255
Eewrite ds+2, cycers, 1
If Keyin(17,20)=1 Then
firstback=1
Out 21,0 'turn retract led off
End If
If firstout=1 And firstback=1 Then arm=1 'set the arm flag to arm the fire butto
n
End Sub
50

```

'DATADUMP ルーチン

```

Sub datadump()
Dim chef As Byte
Dim tf As Byte 'total fires
Dim ta As Byte 'total aborts
Dim ers As Integer
Dim tj As Byte
Dim tdd As Byte
Dim stan As Integer
Dim kyle As Byte
Dim token As Byte
Dim ike As Byte
Dim kenny As Byte
Dim sn As Byte

tf=0
ta=0
ers=0
tj=0
tdd=0

Eewrite ds+4,1,1 'write 1 to the ds+4 eeprom register denoting that datadump was
    accessed
Delay 1000 sn=Eeread(0,1)
Debug "Circular Stapler Stored Data",Cr
Debug "Version ",ver,Cr
Debug "KMS Medical LLC5Cr
Debug "-----";Cr
Debug Cr
Debug "Serial Number: ",Dec sn,Cr
powerons=Eeread(2, 1 )
If powerons>=255 Then powerons=255
Debug "Total Cycles: ",Dec powerons,Cr
Debug Cr
Debug "-----",Cr
Debug Cr
For stan=5 To (powerons*5) Step 5
Debug "Cycle ",Dec (stan/5),Cr
Debug "-----",Cr
chef=Eeread(stan, 1 )
tf=chef+tf
Debug "Completed Fires: ",Dec chef,Cr
kyle=Eeread(stan+ 1,1)
ta=kyle+ta
Debug "Aborted Fires: ",Dec kyle,Cr
token=Eeread(stan+2 , 1 )
ers=token+ers
Debug E /Rs: ",Dec token,Cr

```

```

ike=Eeread(stan+3 , 1 )
tj=ike+tj
Debug "Jogs: ",Dec ike,Cr
kenny=Eeread(stan+4, 1 )
tdd=kenny+tdd
Debug "Datadumps: ",Dec kenny,Cr
Debug Cr
Next 'stan

```

```

Debug "-----",Cr
Debug "Cycle Totals",Cr
Debug Cr
Debug "Completed Fires: ",Dec tf,Cr
Debug "Aborted Fires: ",Dec ta,Cr
Debug "E/R Presses: ",Dec ers,Cr
Debug "Jog Presses: ",Dec tj,Cr
Debug "Datadumps: ",Dec tdd,Cr
Debug Cr

```

10

```

Delay 1000
For x=1 To tfblink the number of completed firing cycles
Out 22,1
Delay 500
Out 22,0
Delay 500
Next 'x
Do Until Adin(0)>800 And Keyin(3,20)=1 'wait until datadump buttons are released
Loop
End Sub

```

20

30

'最初の射出

```

Sub initialfire()
Dim f As Integer
Dim p As Integer
Dim t As Integer
Dim y As Integer
Dim z As Integer
Dim q As Integer
Dim timmy As Integer
Dim butter As Integer
Dim numblinks As Integer
Dim fbcount As Integer

```

40

```

Debug clr,Cr

```

```

'turn off extend and retract buttons to show that they are not active for abort?
Out 20,0 'extend button
Out 21,0 'retract button

```

50

```

bail=0
t=15 'total blink time
p=3 'number of blink periods
Pwm 0,fast,60000
'start blink and adjust pinch motor to force
f=(t*1000)/p
fbcount=0
If Keyin(12,20)=1 Then fbcount=1

For y=1 To p
numblinks= (t*y)/p

For z=1 To numblinks
timmy=f/numblinks
butter=timmy/50 'calibrate this to seconds

If timmy=0 Then timmy=1
If Keyin(12,20)=0 And fbcount=1 Then
bail=1 'set abortfire flag
Exit For
End If
If Keyin(12,20)=1 Then fbcount=1
Do Until Keyin(19,20)=0 Or Keyin(14,20)=0 'retract until force switch met or re-
tract limit met
Out 31,1
If Keyin(12,20)=0 And fbcount= 1 Then
bail=1 'set abortfire flag
Exit Do
End If
If Keyin(12,20)=1 Then fbcount=1
Loop
If baiM Then Exit For
Out 31,0
Out 23,1 'force led
Out 22,1 'fire button led
For q=0 To butter
Delay 10
If Keyin(12,20)=0 And fbcount=1 Then
bail=1 'set abortfire flag
Exit For
End If
If Keyin(12,20)=1 Then fbcount=1
If Keyin(19,20)=1 Then Out 23,0
Next 'q
If bail=1 Then Exit For
Do Until Keyin(19,20)=0 Or Keyin(14,20)=0 'retract until force switch met
Out 31,1
If Keyin(12,20)=0 And fbcount=1 Then
bail=1 'set abortfire flag
Exit Do

```

```
End If
IfKeyin(12,20)=1 Then fbcount=1
Loop
Out 31,0
Out 23,1

If Keyin(12,20)=0 And fbcount=1 Then
bail=1 'set abortfire flag
Exit For
End If
If Keyin( 12,20)= 1 Then fbcount= 1

Out 22,0
For q=0 To butter
Delay 10
If Keyin(12,20)=0 And fbcount=1 Then
bail=1 'set abortfire flag
Exit For
End If
If Keyin(12,20)=1 Then fbcount=1

If Keyin(19,20)=1 Then Out 23,0
Next 'q
If bail=1 Then Exit For
Next 'z
'Debug Dec? fbcount,Cr
If bail=1 Then Exit For

Next 'y
Pwmoff 0
If bail=1 Then
abortfire
Else
'staplerangecheck
finalfire
End If
End Sub

'ステープル範囲確認ルーチン

Sub staplerangecheck()
srstatus=Keyin(29,20) 'read the staplerange limit switch
If srstatus=0 Then
finalfire
Else
abortfire
End If
End Sub

'最終射出ルーチン
```



```

Sub finalfire()
Out 23,0 'turn force led off
Out 20,0 'turn extend led off
Out 21,0 'turn retract led off
Out 22,1 'Turn on fire led to signify final fire abort ready
Pwmoff 1
'Pwm 1,fast,60000
'Out 32,1 'fire motor forward DDD
completefire=1
Do Until Keyin( 15,20)^0 'fire forward until forward limit is met
If speed>=60000 Then speed=60000
If speed<60000 Then
speed=speed+10000
End If
Pwm 1,speed,60000
Out 32,1
Delay 50
If Keyin(12,20)=0 Then Or Keyin(10,20)=0 Or Keyin(11,20)=0
bail=1
Exit Do
End If
Loop
Out 32,0 'fire motor fwd off DDD

speed=0

Delay 250
Do Until Keyin(16,20)=0 'retract fire motor
If speed>=60000 Then speed=60000
If speed<60000 Then
speed=speed+10000
End If
Pwm 1,speed,60000
Out 33,1
Delay 50
Loop
speed=0
Out 33,0
Pwmoff 1
Out 22,0 'turn fire led off
Out 21,0 'turn off retract led
extendonly=1
Incr cycnumfires
If cycnumfires>=255 Then cycnumfires=255
Eewrite ds,cycnumfires,1 'write the current cycle number of fires to the eeprom
Delay 200
End Sub 'return to the main routine

' 射出打ち切り

```

```

Sub abortfire()
'Debug "Fire aborted before firing! !",Cr
Out 31 ,0 'turn retract motor off
Out 32,0 'turn fire forward off DDD
Out 23,0 'turn force led off
Pwm 1,fast,60000
Delay 250
Do Until Keyin(1 6,20)=0 'retract fire motor
Out 33,1
Loop
Out 33,0
Pwmoff 1 Out 22,0 'turn fire led off
Incr cycabortfires
If cycabortfires>=255 Then cycabortfires=255
Eewrite ds+1, cycabortfires, 1 'write the current cycle abortfires to the eeprom
Delay 200
homeextend 'extend to lcm
End Sub

```

10

【 0 0 8 1 】

20

上記には、エンドエフェクタの着脱可能および／または交換可能な部分を具える同定装置を用いる可能性も開示されている。このような識別装置は、例えば、追跡用法または（track usage and inventory）として用いることができる。

【 0 0 8 2 】

識別装置の一例は、無線周波数を用い、R F I Dとして呼ばれるものである。医療用ステープラが、本書に開示するような再装填可能で交換可能なステープルカートリッジを用いる場合、R F I Dをステープルカートリッジに装填して、特定のステープラと、ハンドルに付属しうる可換ステープルカートリッジを検知するR F I Dをステープルカートリッジリーダーとの互換性を確かめてもよい。このような構成において、リーダーはカートリッジに装填されたR F I Dをステープルカートリッジに呼びかけ信号を送る。R F I Dはステープラを照合するユニークなコードで応答する。ステープラカートリッジが照合通りのラベルである場合、ステープラはアクティブとなり、使用可能となる。しかしながらカートリッジが拒否された場合、ステープラは拒否表示を出す（例えば、L E D点滅、可聴音、視覚表示）。近くのカートリッジの偶発的または不正確な読み込みを避けるために、R F I Dリーダーのアンテナは、ステープルカートリッジがステープラに搭載されるか非常に近い場合のR F I Dのみを読み込む（最適には、装置の遠位端部で）。R F I Dの使用は、機械的ロックアウトと組み合わせて、確実にステープルカートリッジごとに1の射出サイクルのみが行われるようにする。R F I Dは、リーダーが高価で、アンテナを比較的大きくする必要があり、読み取り距離が比較的狭く、通常は数センチメートルという不都合がある。

30

40

【 0 0 8 3 】

他のワイヤレス認証を用いてもよい。アクティブR F I Dを用いてもよい。同様に、赤外線（I R）通信装置を用いてもよい。しかしながら、これらはいずれも受信端で電力を生成する必要があり、これがコストとサイズの不利益となる。

【 0 0 8 4 】

他の認証装置の例は、暗号化である。暗号化により数字の処理が必要となり、これらの計算に伴って処理チップ（例えばマイクロプロセッサ）が使用され、これらのいずれかはステープルカートリッジや可換型エンドエフェクタシャフトなどの可換部品の上に配置される。このような暗号化チップは、本発明の手術器具の最適化を分析する特定の特性を有する。第1に、可換部品用の別の電源は必要ない。このような電源を追加するコストのみ

50

ならず、望まない重量までが追加され、他の部品または必要のない空間が占められる。このように、部品用の電源は、ハンドル内の既存の電源からとられるべきである。また、電源供給は常時保証されるべきである。可換部品は比較的小さく、これに対応して暗号化チップも小さい。さらに、ハンドルや可換部品の双方が使い捨て可能に構成されると、それ故、双方の暗号化プロセッサに使い捨てとするコストがかかる。最後に、可換部品の暗号化装置と、対応するハンドルの暗号化装置は小型化されるべきである。後述するように、本発明にかかる暗号化装置は、これらの望ましい特性のすべてを提供し望まない特性を制限するものである。

【0085】

暗号化認証装置は、商業的に入手可能である。このような暗号化装置の一つは、Dallas Semiconductorで製造され、DS2432チップとして参照される。このDS2432チップは、リーダとトランスポンダ間の暗号化認証を行うのみならず、装置特性情報を保存するのに用いるメモリを具え、これらの情報および使用については後に詳述する。DS2432の有利な特性は、1ワイヤ装置であることである。これは、電力と入力および出力信号の双方が同じ配線で送られることを意味する。このDS2432のような1ワイヤ装置では、ハンドルとエンドエフェクタ間を接続するのに、ハンドル本体10からアンビルネック30を通して可換ステーブルカートリッジ50へ単一の配線が延びるだけでよい。この構成は、電機接続を最小限の量とする特性を満たし、これに対応して製造コストが低減する。DS2432チップはアースする必要があるが、金属のアンビルネック30が導電性であり、装置1のアースに接続されており、このためDS2432チップのアース接続の一実施例は、リードからネック30への直接接続により達成することができる。

【0086】

暗号化回路の一実施例は、第1の暗号化チップを可換部品（例えばステーブルカートリッジ）に設けている。第1の暗号化チップのアースは可換部品の金属部分へと電氣的に接続され、これが装置のアース、例えばネック30へと電氣的に接続されている。DS2432チップの1ワイヤ接続は、可換部品のどこかであるがアースから電氣的に遮断された部分に電氣的に接続される。例えば、可換部品が60mm線形ステーブルカートリッジである場合、DS2432は最後のステーブルセットの遠位部と電氣的に絶縁されたカートリッジの遠位端部に取り付けられるか埋め込まれる。この暗号化チップは、カートリッジのステーブルが出るのと反対側に埋め込まれ、使用時に作業面にも曝された組織にも面しない。DS2432チップのアース線は、ステーブルカートリッジの金属外側フレームに電氣的に接続され、これがステーブラのアースに電氣的に接続されている。1ワイヤのリードは第1の導電装置（例えばパッド、リード、または双方）に電氣的に接続され、これはカートリッジの金属フレームから電氣的に絶縁されている。単一の導電性であるが絶縁された配線が、近位端部から回路ボードまたは装置のハンドル内の適切な制御電子部品に接続されている。この配線は、ステーブラの他の部分、特にアースフレームとの電気接触から遮断されており、ハンドルからネックを通り可換部品の受けチャンバまで延びている。遠位端部において、絶縁配線は第2の導電装置（例えばパッド、リード、または双方）に曝されて電氣的に接続され、これはカートリッジがエンドエフェクタ内で定位置にロックされたときに第1の導電装置と積極的に接触する形状である。このような構成により、2つの導電装置は可換部品（例えばステーブルカートリッジ）がエンドエフェクタに挿入される度に直接的な電気接続を形成し、ある特定の実施例では、部品が正しく挿入された場合のみ接触が実現する。

【0087】

DS2432はまた、面積が数mm四方であり、ステーブルカートリッジといった小型の可換部品にチップを容易に取り付け可能とすると同時に、例えば50mm²のサイズの小小型化要求にも応えている。DS2432チップは、比較的安価であることに留意されたい。DS2432チップによるすべての通信が外部試験から隠れた状態に維持するには、DS2460（これもまたDallas Semiconductorが製造）を、DS2432から受信する暗号送信を内部で計算した期待される答えと比較するのに用いることができる。これら

両方のチップの特性が、Dallas Semiconductors社のアプリケーションノート3675に開示されており、これは本書に全体として参照により組み込まれている。DS2460チップは、DS2432チップより実質的に割高であるが、ハンドルとともに使い捨てとする程度に廉価である。医療器具（例えば本発明の手術器具）の使い捨ての可換部品数は、通常、この可換部品を受けるハンドルの数を相当上回る。したがって、DS2432チップが交換可能な部品に設けられ、DS2460チップをハンドルに設けると、低コストでの暗号化特性が満足される。DS2460チップが約 31 mm^2 のフットプリントを有するため、所望の小型寸法が満たされる。アプリケーションノート2675の図2に説明される2つのDS2432チップを用いた代替的な回路構成も存在し、ここで回路はローカルのマイクロプロセッサ（例えばマイクロプロセッサ2000）との比較を行うことにより、高価な2460チップを不要としている。このような構成では、装置1に暗号化を付加するコストが低減するが、説明したように、この構成は比較される双方の数字を検査できるようにすることによってセキュリティ面を提供する。

10

【0088】

暗号化を用いる医療器具の可換部品の電子認証プロセスを、DS2432チップを1つとDS2460チップを1つ有する実施例で説明する。この暗号化装置の制御回路の例が、図30に示されている。この実施例は、マイクロプロセッサ2000を有する回路ボードが組み込まれたハンドルを具える線形ステープラを用いる。1の自由なI/Oピン2010がDS2460の第1のリード2110に接続され、別のI/Oピン2020が第2のリード2120に接続されている。各可換部品2200には、DS2432チップが設けられ、1ワイヤリードがマイクロプロセッサ2000の第3のI/Oピン2030に接続されている。

20

【0089】

処理を開始するには、可換部品2200を装置に接続し、アースと1ワイヤリードに電氣的に接続する。マイクロプロセッサ2000が、装置1に新しい部品2200が接続されたことを検知したら、認証ルーチンを実行する。最初に、マイクロプロセッサ2000は、第1の通信ピン2010でランダム番号要求をDS2460に出す。DS2460は予めプログラムされたシークレット番号を有し、これは可換部品2200に含まれる各DS2432チップに登録されたシークレット番号と同じである。したがって、DS2432とDS2460チップの双方に設けられたランダム番号が同じであれば、2つのチップからそれぞれ出力される結果は同一となる。DS2460はランダム番号を作成し、第2のピン2020を介してマイクロプロセッサ2000に送り、これがピン2030を介して1ワイヤリードを超えてDS2432に送られる。DS2432がこのランダム番号を受信したら、自身のSHA-1アルゴリズム（全国化学技術情報システム（NIST）が開発）にかけて、暗号のハッシュコード応答を生成する。このハッシュコード応答は、1ワイヤリードを超えてマイクロプロセッサ2000に返送され、ピン2010または2020のいずれかを介してDS2460に送られる。この期間中、DS2460はまた、自身でハッシュコード応答を算出する。最初に、DS2460は、内部的にDS2432に送ったのと同じランダム番号を自身のSHA-1アルゴリズムにかけて、内部的に、生成したハッシュコード応答を保存する。このDS2460はまた、DS2432からマイクロプロセッサ2000を通じて送信されたハッシュコード応答を保存する。双方のハッシュコード応答が照合され、これらが同一である場合、可換部品2200は確認され承認される。これらのハッシュコード応答が相違する場合、部品2200は拒否され、装置は部品2200が使えない状態か、特定の防衛手段が施されてからのみ使用可能とする状態となる。例えば、時間、日付、環境等に関するデータや、未承認の部品の特性を保存して、後に製造者（または販売店）へ一斉送信して、ユーザが装置に未承認の部品2200を使用しようとしているか既に使用したことを製造者に通知するようにしてもよい。メッセージが暗号化されない場合、認証メッセージは傍受され偽造され、盗まれ、または部品2200を認可された業者から購入せずに未承認の部品2200が使用されてしまう。本書における一実施例では、ラインを横切って送信される情報で試験しうる唯一のものは、単一のランダム番号

30

40

50

と単一のハッシュコード応答である。このSHA-1で生成した応答を解読するには数百年かかると言われており、これによりリバースエンジニアリングの動機が低減される。

【0090】

本例で使用するチップはいずれも、認証が成立した場合にアクセス可能となる安全なメモリを有し、それぞれがメモリ内に保存される複数のシークレットキーを持つようプログラムされてもよい。例えば、DS2460は内部に複数のキーが保存されており、部品2200はそれぞれこれらに保存されセットの複数のキーから選択される唯一のキーを有する場合、DS2460は、部品2200の「通常の」単一のキーに対する「マスター」キーとして作用する。

【0091】

本発明の手術器具の可換部品を認証すると、多くの肯定的な効果を得ることができる。第1に、装備の製造者はユーザが未承認部品を使用するのを防止することができ、これにより承認された部品のみを確実に使用させることができる。これは製造者が可換部品の売上げからロイヤリティを受け取れることを保証するばかりでなく、製造者は手術器具の高度な品質を保証することができる。暗号化回路を具えるメモリを有することにより、本発明による利益が飛躍的に増大する。例えば、線形ステープラの1のエンドエフェクタが30mm、60mm、120mmのステープルカートリッジを収容する場合、例えば、カートリッジの各サイズに個別のキーが付与されるとともに、ハンドルはこれらの3つのキーをそれぞれ保存し利用するようプログラムすることができる。他の2つとは異なるいずれか1に対応する内部演算されたハッシュコード応答を受信すると、ハンドルはどの種類のカートリッジが装置に挿入されたかを判別することができる。各カートリッジはメモリ内に、例えば多様なカートリッジサイズによって異なるステープルスレッド動作長などカートリッジ特有のパラメータを有してもよく、これにより検出されるカートリッジによってハンドルが異なる動作をしてもよい。確認されたパラメータは、特定の部品の改訂レベルを示してもよい。例えば、第1版のカートリッジはいくつかの使用パラメータを有し、このカートリッジを検出した場合に、ハンドルが第1版のカートリッジを使用せずに第2版のカートリッジを使用するようにしたり、その逆としたりすることができる。

【0092】

暗号化チップにメモリを具えると、このカートリッジは他の種類のデータを追跡できるようになる。例えば、カートリッジは過去に連結された各ハンドルの識別子、カートリッジから射出したハンドルの識別子、時間、日付、他の使用および／または接続されたときの時間データ、カートリッジを射出するまでにかかった時間、ステープル射出に射出トリガが何回作動したか、および他の類似のパラメータを保存してもよい。具体的には1のパラメータはカートリッジが誤動作したときのデータを記録してもよい。これにより製造者は、カートリッジの誤作動またはユーザエラーが生じたときに、例えば、後に検証して利用者に改善策や他の訓練を施す助けとすることができる。ハンドルに利用可能なメモリを設けると、他例えば各処置の長さ、各ステープル射出の速度、各射出で生成されるトルク、および／または各射出を通してかかる負荷などのハンドル関連パラメータを保存することができる。このメモリは、単にハンドルにあるリチウム電池で何年も駆動することができる。したがって、ハンドルのデータの長寿は保証されている。このメモリは、利用者によるこのハンドルの使用をすべて、対応する日付データとともに保存することができる。例えば、ハンドルが一度の手術処置での利用のみ承認されているが、このハンドルが数日または数週間あけてステープルカートリッジが射出されたデータがある場合、これが最終的にリサイクルのために製造者に戻されたとき、製造者はこの利用者（病院、医師、クリニック等）がハンドルを不適切に、そしておそらくは危険な状態で使用したことを検出できる。暗号認証は、着脱式電池パックにも同様に利用できる。さらに、装置の様々な部分にセンサを設けて暗号化チップのメモリ内に格納される情報を送るようにしてもよい。例えば、温度センサがカートリッジが射出される際の手術室の温度を送信するようにしてもよい。この測定温度は、手術中の不適切な温度管理により後に感染症が生じた場合に用いることができる（例えば、空調が使えない国など）。

10

20

30

40

50

【0093】

ステープラが使用中に動作不良となるような好ましくない場合のために、機械的補助手動装置またはベイルアウトを設けて、手で患者から装置を取り外せるようにする。すべてのベイルアウトの使用は、これらの暗号化チップにあるメモリに記録することができる。さらに、なぜベイルアウトが必要となったのかを示すデータも保存して、後に確認できるようにする。品質維持のため、ベイルアウトが検出されたら、ハンドルは顧客／利用者にベイルアウトの使用を伝える証明書が送られるようプログラムしてもよい。

【0094】

上述の通り、本発明は上記実施例で用いたような円形ステープラに限らず、例えば線形ステープル装置などの様々な手術用のステープルヘッドに適用することができる。したがって、以下の多くの説明の実施例で線形ステープラが使用される。しかしながら、本書における線形ステープラの使用はそれに限定されると解釈されてはならない。

【0095】

上述した構成要素は、線形および円形ステープラのステープル制御軸80の周囲に存在するものであり、これらの要素はステープル制御アセンブリ200を構成する。上述したように、正しくステープルを出して組織を切開するのに必要な力は200ポンド以上であり、好ましくは250ポンド以下である。人体組織（例えば、結腸組織）の手術用線形ステープラで所望のステープルおよび切開機能を実現するのに最低限の要求は：

- 1) 約3秒以内に約60mm（～2.4"）のストロークに約54.5kg（120ポンド）をかける、
- 2) 約8秒以内に約60mm（～2.4"）のストロークに約82kg（180ポンド）をかけるものである。

本発明の電気駆動式ハンドヘルド型手術用線形ステープル装置は、後述するように新規な方法で最適化され、これらの要求を満たすことができる。

【0096】

上述した要求を満たすのに必要な力を生成すべく、機械的アセンブリの最大出力（ワット）は、これらの要求の最大リミットに基づいて計算される必要がある：82kg超60mmで3秒。これらの特徴の数学的変換は、ドライブレインの出力に必要な最大約16ワットの動力を生成する。モータの効率は100%未満であり、ドライブレインの効率もまた100%未満であるため、電力から動力への変換は1：1ではない。これら2つの効率の積が、全体の効率を構成する。16ワットの動力を生成するのに必要な電力は、全体効率の逆関数により16ワットより大きくなる。必要な電力が定まったら、最低限の電力要求を満たすかについて利用可能な電源が確認される。その後、尾となる電源の確認と最適化が行われる。この分析は後の記載で詳述する。

【0097】

電源とモータのマッチングと最適化は、双方の個々の特性に着目することを含む。電気モータの特性を確認するとき、大きなモータは、小さなモータより高い効率で所定量の作業を実行する。希土類磁石またはコアなし構造のモータは、小さな寸法で同じ出力が出せるが、コスト高である。さらに、通常は、所定時間で同じ出力を出すよう設計された場合には大きなモータの方が小さなモータよりコストが低い。しかしながら大きなモータは、手術用ステープル装置に用いた場合には、配置されるハンドルのサイズが施術者の手のサイズに制限されるため、望ましくない特性となる。施術者は装置が小さく軽量であることを望み、大きく重いことを望まない。これらを考慮して、本発明の手術用ステープラハンドルに用いる場合のコスト、サイズ、重量が最適化される。

【0098】

施術者の手の中で用いるのに利用可能なモータは、比較的安価なセラミック磁石を用いるモータや、比較的高価な希土類磁石（例えばネオジム）を用いるモータを含む。しかしながら、後者の出力増加を前者と比較すると、後者のコスト増加に実質的に見合うほど十分に大きくない。したがって、ハンドル内に使用するにはセラミック磁石モータを選択できる。モータの実施例は例えば標準サイズ（直径）が27.5mmまたは24mmである

。これらのモータの効率は約 60 % である（サイズと負荷により 30 % 以下まで下がる）。これらのモータの速度は無負荷で約 30,000 rpm である（20,000 乃至 40,000 rpm）。

【0099】

このような従来のモータを使用しても、さらにサイズを小さくすることが望まれる。このため、発明者は同様の出力だがサイズをかなり小さくしたコアレス、ブラシタイプ、DC モータを開発した。例えば、17 mm 直径のコアレスモータは、24 mm 直径のモータと殆ど同じ出力を出すことができる。通常のモータと異なり、このコアレスモータの効率は 80 % 以上である。コアレスモータの殆どは、希土類磁石を用いる。

【0100】

このように制限された大きさと得られる動力では、効率の大きな機械的ギアトレインを選択することが望まれる。最終的なドライブトレイン制御段階でラックアンドピニオンアセンブリを配置すると、通常はラックアンドピニオンの効率が約 95 % であり、スクリュドライブの効率が約 80 % であるため、スクリュドライブと比較して最終段階で高効率となる。線形電気ステープラの場合、ステープラが 60 mm カートリッジを有する場合にはステープル／切開機構には 60 mm の移動範囲がある（30 乃至 100 mm の範囲のカートリッジを用いることができるが、説明目的で 60 mm を用いた例とする）。この移動範囲は、3 秒で、全体を移動する場合のラックアンドピニオンの秒速は 0.8 インチである。これを妥当なサイズのラックアンドピニオンアセンブリで実現しようとする、ギアトレインはモータ出力を約 60 rpm に落とす必要がある。モータの出力速度が約 30,000 rpm である、ドライブトレインの速度低下は約 500 : 1 となる。このモータでこの低減を実現するには、5 段階のドライブトレインを選択する。このようなドライブトレインの効率は各段階で約 97 % であることが知られている。したがって、約 95 % の効率を組み合わせたラックアンドピニオンの全体効率は、 $(0.95)(0.97)$ ⁵ すなわち 82 % である。この 82 % にモータ効率 60 % を組み合わせると、ドライブトレインの効率は、電氣的なものから機械的な効率全体で、約 49.2 % を生ずる。この全体効率を知ると、所望の条件下でステープラに必要な電力量を算出すると、ステープル／切開する力を生成するのに算出した値の約 2 倍が必要となる。

【0101】

上述した要求を満たすのに必要な力を生成するには、機械アセンブリの出力（ワット）は、82 kg で 60 mm を 3 秒が約 16 ワットに基づいて算出することができる。全体の機械効率は 40.2 % であることが分かるため、電源からは 32.5 ワットが必要となる（機械的 16 ワット～電氣的 32.5 ワット。ワット x 0.492 全体効率）。この電力の最低要求で、ステープラを励起する電池の種類が特定され、これはこの場合で高出力リチウム一次電池を含む。高出力リチウム電池（例えば CR123 や CR2 電池）の公知の特性で、電池毎に 5 ピークワットを生成することがある。したがって、少なくとも 6 つの電池を直列にすると、およそ 32.5 ワットの要求された電力を生成し、これが 16 ワットの動力に変換される。製造される各種の高出力リチウム電池が、ピーク出力供給において異なる特性を有しこれらの特性はかかる負荷により異なるため、最適化はここで終わりではない。

【0102】

第 1 の製造元の 1 の電池を第 2 の製造元の別の電池と区別する多様な特性の相違が存在する。比較しうる有意な電池特性は、1 の電池から得られる出力を制限するものであり、これは以下のいくつかを含む：

- ・セル内の電解質の種類
- ・電解質の濃度および化学組成
- ・陽極と陰極がどうやって作られているか（化学的あるいは機械的構造の両方）
- ・PTC（抵抗の正温度係数）装置の種類と構造

これらの特性の 1 またはそれ以上を試験すると、ステープル装置への使用に最も望ましい電池を選択するのに価値ある情報を与えてくれる。最後の特性、すなわち PTC 装置の

10

20

30

40

50

動作の試験により、望む作業を行う電池種類の最適化が実現する。

【0103】

大多数の電源が、長時間にわたって、相対的に安定かつ効率的に動作することが求められている。電源を設計・構成する場合、通常は少ない回数の使用のために寿命の短い電源を選択することはない。しかしながら、電気ステープル装置の電源はほんの数回、短期間のみ使用される。使用の都度、モータはピーク負荷に耐えてエラーなく動作する必要がある。これはつまり、手術用ステープラでは、ステープル／切開機能は単一の医療処置で行われ、最大使用が10から20のサイクルカウントで、各回で可能な限りの装置のピーク負荷に対処するよう求められる。この1の処置の後、装置は使用不能となり破棄される。このため、本発明のための電源は、他の従来の電源とは異なる構造である必要がある。

10

【0104】

本発明にかかる装置は、装置内で使用されない場合の電池に求められる寿命と比較して、制限された寿命をもたせて構成される。このように構成すると、装置はこの規定された「寿命」の後には殆ど作動しない。電池などの内蔵型電源は、ある種の使用後に回復する機能がある。本発明への最適化では、装置は、規定された処置において、処置後に使用時間が経過したら継続処置が制限されるかできなくなるよう構成される。装置が回復して別の処置に再使用可能であっても、装置は予定される1回の使用期間または使用時間の集合範囲の外では電源が強化レベルで作動できなくなるよう設計される。これを念頭に、この装置電源の寿命または臨床上の寿命が規定され、この寿命は使用意志として説明されてもよい。この利用可能／臨床上の寿命は、装置が予想通り作動するかを確認する試験期間中の使用の期間または事象を含まない。この寿命はまた、装置が予定された処置以外で作動した、すなわち手術処置に関連して作動されなかった他の回数を含まない。

20

【0105】

市場で入手可能な従来の電池は、2種類の使用のために設計されている：(1)短期間でかなり大きな出力（例えばカメラのような大放出デジタル装置）、または(2)長期にわたって少ない出力（例えばコンピュータのクロックバックアップ）。これらの動作のいずれかでなければ、電池はヒートアップを開始する。これをチェックせず放置したら、電池は化学作用で例えば爆発するなどの有意な損傷を引き起こす場合がある。明らかに、電池の爆発は避けるべきである。このような極端な状態は、今までの電池でPCT装置－電池の温度が上がるにつれ電池の伝導を制限するよう構成された装置（正温度係数抵抗）を設けることにより回避している。このPCT装置は、電池および／または回路を過電流や過熱状態から保護する。重要なことは、PCT装置は電池を外部の回路短絡から保護するとともに、短絡回路が除去された後も電池が継続機能できるようにする。いくつかの電池では、ワントタイムヒューズを用いて回路短絡および／または過熱保護を保護している。しかしながら、ヒューズ付きの電池で偶発的な回路短絡があるとヒューズが開放され、電池が使用不能となる。PCTで保護された電池は、ヒューズ式電池に比べると、短絡回路が除去されたら自動的にリセットして電池の通常動作を可能とするため利点がある。モータは何回か従来の一般的な高出力アプリケーションより大きい電流を流すため、このPCT装置の特性の理解は本発明で重要となる。

30

【0106】

PCT装置は陽極および陰極と直列的に設けられ、例えば一部導電層を2つの導電層で挟んで構成される。この装置は、通常動作の温度（装置が適用される回路の状態によるが、例えば、室温から40°Cまで）では低抵抗状態である。例えば回路短絡の形成または過度の放電（装置が適用される回路の状態によるが、例えば60°Cから130°C）などにより異常な大電流が生じると、このPCT装置は極高抵抗モードに切り替わる。設置するだけでPCT装置は回路に含まれて、この回路に異常な電流が流れて装置が高温状態となると、これにより高抵抗状態となり回路を流れる電流を最低限のレベルに低減して、回路と電池の電気素子を保護する。最低レベル（例えばピーク電流の約20%）では、電池は「安全」レベルまで冷却され、大きな出力を供給できるようになる。このPCT装置の部分導電層は、例えば、カーボンパウダーとポリオレフィン樹脂で構成される。これら

40

50

の装置はこの分野で説明されよく知られているため、これ以上の説明は不要である。

【0107】

異なる製造元の P T C 回路は異なる特性で動作するため、本発明はこれを役立てて特定のモータと特定の使用に適合する特定の電池を選択する最適化を行うことができる。P T C 装置が高抵抗状態に切り替わった時間の確認を、特定のモータと電池へのドライブレインを最適化する目安として用いることができる。いつ P T C 装置が切り替わるかを知ることが望ましく、これにより通常のステープラ使用において P T C 装置がこの変化を起こさなくなる。

【0108】

電池の実施例は、約 3 アンペアから約 8 アンペアまでの多様なレベルで用いられる。ハイエンドでは、P T C 装置はほぼ即座に高抵抗状態へと変化して、標準的な C R 1 2 3 電池にこの電流レベルは高すぎるとする。4-6 アンペアでは、ある製造元の電池は他の製造元の電池より早く P C T が作動することが判明している。第 2 の製造元の P T C 移行期間は 4 アンペアで 3 分以上、5 アンペアで約 2 分、6 アンペアで約 50 秒である。これらの期間はいずれも、8 秒ピーク負荷要求よりかなり大きい。したがって、第 2 の製造元の電池が、第 1 の製造元の電池と比較してピークアンペアでの使用に最適であることが判明する。

【0109】

当初は、低いか一定の出夏で高いアンペアとすると、電池から高出力が生成されると推測されていた。6 セル直列構成に基づく、ピーク電圧は 18 ボルトでピーク電流は 6 アンペアしかない。電池を並列とすると、理論的には、ピークアンペアが高くなり、3 x 2 構成（3 つの電池の直列セットを 2 つ並列にする）では、ピークで 9 ボルトでピークで 12 アンペアとなる。

【0110】

異なる多くの電池を検証したうえで、比較的低い電圧（約 1.5 ~ 2 ボルト）で約 4-6 アンペアとすると、最大のワット出力が生成されることが判明した。2 つの 6 電池構成を確認してみた：6 x 1 の直列接続と、3 x 2 の並列接続である。3 x 2 構成は、約 10 アンペアと大きなピークアンペアを生成した。6 x 1 構成は、ピークアンペアがおおよそ 6 であり、単一の電池では P T C 装置が状態を変える前にピークで 5-6 アンペアが可能であった。この情報は、使用時に直列グループの様々な個々の電池がその P T C 装置を作動させ、これによりグループ全体の電池を流れる電流が制限される。したがって、低い電圧でピークアンペアを生ずる暫定的な結論は、3 x 2 構成が支持される。

【0111】

4 x 1、6 x 1、3 x 2 の 3 つの異なる C R 1 2 3 電池構成で、所定の通常のギア構成で 120 # と 180 # の負荷でピニオンがラックを動かす早さが試験された（毎秒インチ（「I P S」））。この現実の動的負荷試験の結果が、図 31 のチャートに示されている。120 # 負荷について、

- ・ 4 x 1 電池パックでは、約 2.5 アンペア、約 8 ボルトで、負荷を約 0.6 I P S で駆動した。

- ・ 6 x 1 電池パックでは、約 2.5 アンペア、約 13 ボルトで、負荷を約 0.9 I P S で駆動した。

- ・ 3 x 2 電池パックでは、約 2.5 アンペア、約 6 ボルトで、負荷を約 0.4 I P S で駆動した。

180 # 負荷について、

- ・ 4 x 1 電池パックでは、約 4 アンペア、約 7.5 ボルトで、負荷を約 0.65 I P S で駆動した。

- ・ 6 x 1 電池パックでは、約 4 アンペア、約 12 ボルトで、負荷を約 0.9 I P S で駆動した。

- ・ 3 x 2 電池パックでは、約 4 アンペア、約 7 ボルトで、負荷を約 0.4 I P S で駆動した。

10

20

30

40

50

明確に、ピーク電流は制限され、この限界は負荷に依存する。この実験は、所定の負荷では電源に拘わらず電流は同じとなるが、電池構成によって電圧は変化することを示している。各負荷について、予想通り、6 x 1 構成で出力が大きく、3 x 2 構成で少なかった。ここから、電池パックの合計出力は電流ではなく電圧により変化し、このため、並列構成（3 x 2）はこの電源を最適化する方法ではない。

【0112】

従来は、モータの仕様を設計する際に、モータの巻線は当該モータが駆動する予想電圧に適合される。このマッチングは個々のサイクルの期間と製品に望む全体寿命とを勘案する。電気ステープル装置の場合、モータは非常に短いサイクルかつ非常に短い寿命でのみ使用され、従来の適合方法では最適とされない。モータの製造元は、巻線の巻数に応じてモータの定格電圧を決定している。巻数が少なければ、定格電圧も低い。所定のモータ巻線のサイズ内では、巻数が少ないとワイヤを多く使用することができ、巻数が少ないと巻線の抵抗が小さくなり、巻数が多いと抵抗が大きくなる。これらの特性は、このモータがオーバードライブした場合に熱とダメージの多くを生成するモータの最大電流を制限する。本発明において望ましい構成は、巻線の抵抗が最小で、電源（すなわち電池パック）から最大電流を出すものである。モータの定格より高い電圧でモータを駆動すると、同じサイズのモータでも有意に大きな出力を出す。この特性は、巻線抵抗（すなわち巻数）が異なる以外は殆ど同一のコアレスモータを試験して得られる。例えば、6つの電池（すなわち、19.2ボルトで）で12ボルトと6ボルト定格のモータを駆動する。12ボルト定格のモータは、0.7アンペアを出すときに電圧降下が僅か18ボルトでピーク出力が4ワットである。比較すると、6ボルト定格で電圧降下が15ボルトのモータは出力15ワットだが、電流2アンペアである。このように、抵抗の低い巻線を選択して電池の出力を十分に引き出すようにする。モータ巻線は特定の電池パックとバランスさせるべきであり、失速状態ではモータはPTCを作動させるのに十分な電流を電池から引き出さず、この状態では手術中に手術用電気ステープラを使用するのに許されない遅延例が生じる。

【0113】

6 x 1の電池構成が、電気ステープル装置の要求を満たすのに十二分であることが分かる。それにも拘わらず、この時点で、要求される作業を行うのに6つの電池が必要なのかを確認すべく電池をさらに最適化することができる。4つの電池で試して、120#負荷の下で、モータ／ドライブトレインは60mmスパン以上のラックを3秒以内に動かせなかった。6つの電池で試して、120#負荷の下で、モータ／ドライブトレインは60mmスパン以上のラックを、要求される3秒よりかなり早い2.1秒で動かせることが確認された。さらに、180#負荷の下では、モータ／ドライブトレインは60mmスパン以上のラックを、要求される8秒よりはるかに早い2.5秒で動かせることが確認された。この時点で、「制御不能の(runaway)」ステープル／切開が生じないように電源および機械レイアウトを最適化することが望ましく、換言すれば、負荷が要求される最大180#またはさらに最大120#より有意に小さい場合、ラックはあまり早く動かない方が望ましい。

【0114】

ギアの減速比および駆動システムは、射出ストローク間にモータがピーク効率近くを維持するよう最適化される必要がある。3秒で60mmの望ましいストロークは、最小ラック速度が20mm／秒（～0.8インチ／秒）を意味する。最適化処理の変数の数を減らすために、ギアボックス内で基本の減速が333：1にセットされる。これはギアボックスの出力シャフト214とラック217間に存在するギアで行われる最終的な減速を残しており、ここでギアは例えばベベルギア215と（ラックを駆動する）ピニオン216とを具え、その簡単な例が図32に示されている。

【0115】

これらの変数は、333：1ギアボックスの出力シャフト214の1回転で移動するラックのインチ数へと組み込むことができる。ギアボックスの出力（rpm）が変化しない場合、出力シャフトの回転（「IPR」）ごとに移動するラックのインチを出力rpmに

合わせる簡単な機能で、以下に示す所望の速度を得ることができる：

(60 rpm → 1 回転/秒 (rps) ; 1 rps @ 0.8 IPR → 0.8 インチ/秒)

このような理想化されたケースでは、速度に対して IPR をプロットすると、真っ直ぐな線が出来上がる。固定の距離に対する速度は、さらに射出時間まで低減することができる。したがって、IPR に対する射出時間のプロットもこの理想的なケースでは真っ直ぐな線となる。しかしながら、モータの出力 (rpm) と、それ故ギアボックスの出力は、負荷によって変化するため一定ではない。負荷の程度により、モータが出力しうる出力量が決定される。負荷が増え、rpm が減り効率が変化する。負荷を変化させた効率試験によると、効率のピークは丁度 60 % 以上と判明している。しかしながら、このピーク効率における対応する電圧とアンペアは、出力のピーク時点と同じではない。負荷が増大するのに伴い、電力の増加速度より効率の定価が早くなるまで電力は増え続ける。IPR が増大すると、速度が増加することが見込まれるが、IPR の増加に対応して機械的利益は低くなり、したがって負荷が増大する。この負荷が増大すると、段々増える高い負荷に応じて効率が落ちることは、IPR が大きくなってもラックからの出力速度が大きくなる点が存在することを意味する。この性質は、IPR に対する射出時間 (秒) のプロットにおける予測される真っ直ぐな線からの偏向として反映される。本発明のシステムの実験は、不要な機械的利益と不十分な機械的利益が約 0.4 IPR で生じることを示している。

10

【0116】

20

この IPR の値から、ベベルギア 215 の最終ギアの比を出力シャフトのスプロケットより約 3 倍大きくなるよう選択することが可能となる (3 : 1)。この比は約 0.4 の IPR に変換される。

【0117】

ここでベベルギアが最適化されたら、電池パックを再び試験して 6 つの電池を 5 つやさらに 4 つまで減らして、費用を節約するとともにハンドル内における電源に必要な容量をかなり減らすことができるかを判定する。約 120 # の一定の負荷を最適化されたモータ、ドライブトレイン、ベベルギア、およびラックアンドピニオンに適用し、4 つの電池を用いるとラックを 60 mm 動かすのに約 5 秒間かかる結果となった。電池 5 つでは、この自家は約 3.5 秒に減った。6 つの電池構成では、この時間は 2.5 秒であった。したがって、この曲線を補完した結果は、最低 5.5 の電池構成となる。電池は整数でのみ供給される事実から、電気ステープル装置の要求に合うには 6 つの電池構成が必要となることが分かる。

30

【0118】

このように、同じ電力特性を出すのに異なるサイズの電池を用いない限り、最小の電源量が固定値として算出される。CR2 として参照されるリチウム電池は、CR123 と似た電力特性を有するが、より小さい。このため、CR2 で 6 つの電池の電源とすると、スペースの要求が 17 % 以上低減される。

【0119】

上記詳述したように、電源 (すなわち電池)、ドライブトレイン、およびモータは、手術処置を完了するために必要な時間枠内で所望の出力を供給する全体効率のために最適化される。各種の電源、ドライブトレイン、およびモータが試験され、その後電源、ドライブトレイン、およびモータの種類が、前記試験に基づいて所望期間だけ最大出力を供給するように選択された。すなわち、最大電力条件 (電圧と電流) が所定期間 (例えば約 15 秒間) PTC を作動させずに存立しうるかが試験された。本発明は、電池がモータを駆動することにより力を抽出する方法を最適化する電圧-電流-電力の値を確認する。この最適化の後でも、電気ステープラ 1 の特性を改善する他の変更がなされてもよい。

40

【0120】

他の種類の電源を用いてもよく、これは本書で「ハイブリッド」電池と呼ぶ。この構成では、再充電可能なリチウムイオンまたはリチウムポリマ電池が 1 またはそれ以上の上述

50

の最適化された電池（またはサイズが小さいが電圧が同等または高い他の一次電池）に接続されている。この構成では、1のCR2電池に含まれる合計エネルギーがリチウムイオン電池を何回も充電するのに十分であるため、リチウムイオン電池がステابل／切開モータを駆動するが、一次電池は供給に限界がある。リチウムイオン電池やリチウムポリマ電池は内部抵抗が非常に低く、短期間で非常に高い電流供給が可能である。この有利な特性を活用すべく、一次電池（例えば、CR123、CR2または他の電池）は10乃至30秒間二次電池を充電し、これが射出時にモータの追加の電源を構成するようにしてもよい。リチウムイオン電池の代替例としてコンデンサの使用があるが、コンデンサは容量が不十分である。そうであっても、超コンデンサ（super capacitor）をモータ駆動システム内に設けてもよい；これはオペレータが追加の電力が必要と判断するまでここから電氣的に分離されていてもよい。このようなとき、オペレータはコンデンサを追加のエネルギー「ブースト」として接続する。

10

【0121】

上述したように、モータの負荷が所定の値を超えて増大した場合、効率は下がり始める。このような場合、複合比トランスミッションを用いて供給電力を所望期間変化させてもよい。効率が落ちるほど負荷が大きくなりすぎたら、複合比トランスミッションを用いてギア比を切り替えて、モータを例えば少なくとも180#の力を供給しうる高効率の地点まで戻す。ただし、本発明のモータは前後方向の双方で動作する必要があることに留意されたい。後者の動作モードでは、組織を挟んで「からまった」状況からモータはステابل／切開器具から切り離せる必要がある。このため、前進ギアより大きな力を生じるリバースギアが有利となる。

20

【0122】

例えば低ポンドから180ポンドまで大きく変化する負荷において、負荷範囲の下端部では駆動アセンブリが強力すぎてしまう可能性がある。このため、本発明は速度制御装置を具えてもよい。考えられる制御装置は、散逸（能動）制御器と、受動制御器がある。受動制御器の一例はフライホイールであり、例えばPalmerらの米国特許出願番号2005/0277955に開示されたエネルギー保存素子56、456がある。別の受動制御器として「フライ」車輪がある。このようなアセンブリは、回転速度が高くなるほど力を吸収する風力抵抗を速度管理に用いており、このためモータが早くなりすぎた場合に速度管理機能を発揮する。他の種類の制御器は、モータがゆっくりと圧縮状態に圧縮する圧縮バネがある。作動が必要な場合、圧縮されたバネが解放され、比較的短期間にすべてのエネルギーがドライブへ伝達される。さらなる制御器の例は、各ステージがそれぞれ多様な電池のサブセットに接続されたマルチステージスイッチがある。低い電力が欲しい場合、第1のスイッチまたはスイッチの第1の部分が作動して、電源回路における電池のいくつかのみが接続される。より多くの電力が求められるに伴い、利用者（または自動化されたコンピュータ装置）が以降の追加の電池を電源回路に接続する。例えば、6つの電池構成では、スイッチの第1の部分では最初の4つの電池を電源回路に接続し、スイッチの第2の部分で5つめの電池を接続し、スイッチの第3の部分で6つめの電池を接続する。

30

【0123】

電気モータおよび付属のギアボックスは、使用時に一定のノイズを生じる。本発明のステープラは、ハンドルからモータおよび／またはモータのドライブトレインを分離して音声と振動特性の双方を低減し、したがって運用時に生じるノイズ全体を低減している。第1の実施例では、ハンドル本体とモータおよびドライブトレインの双方との間にダンパ材が設けられている。この材料は、ラテックス、ポリエステル、植物性の、ポリエーテル、ポリエーテルイミド、ポリイミド、ポリオレフィン、ポリプロピレン、石灰酸、ポリイソシアネート、ポリウレタン、シリコン、ビニル、エチレン共重合体、伸張ポリエチレン、フルオロポリマー、またはスチロフォームなどの発泡体とすることができる。この材料は、シリコン、ポリウレタン、クロロプレン、ブチル、ポリブタジエン、ネオプレン、天然ラバー、またはイソプレンなどのエラストマであってもよい。発泡体は、閉細胞、開細胞、軟質、網状、またはシタクチックであってもよい。この材料は、ハンドルとモータ／

40

50

ギアボックスとの間の所定位置に配置されるか、モータ／ギアボックスを取り巻くチャンバ全体に充填されてもよい。第2の実施例では、モータとドライブトレインは、たまに「中華ボックス」または「ロシアのネスト人形」などと称されるネスト状の筐体構造内に隔離されてもよい。このような構成では、ダンパ材料はモータ／ギアボックスの周囲に配置され、これら2つはギアボックスシャフトが突出する第1の筐体内に配置される。その後、この第1の筐体が「第2の筐体」すなわちハンドル本体に搭載され、ダンパ材料は第1の筐体とハンドル内側の間に配置される。

【0124】

本発明の電気ステープラは、手術に用いることができる。多くのステープル装置は一度のみ使用可能である。コストが比較的低いため、これらは1の医療処置の後に廃棄することができる。しかしながら、電気式の手術用ステープラはコストが高く、少なくともハンドルを1より多い医療処置に使用することが望ましい。したがって、ハンドル部品の使用後の殺菌が問題となる。使用前の殺菌も重要である。電気ステープラは、通常の殺菌処理（すなわちスチームやガンマ照射）に一般に耐えられない電気要素を含むため、このステープラは、例えば酸化エチレングスなど他に考えうるより高価な手段で殺菌する必要がある。しかしながら、ガスによる殺菌にかかる費用を低減するため、ステープラがガンマ照射による殺菌を可能とすることが望ましい。電子部品は宇宙で使用可能であることが知られており、それはこれらの電子部品がガンマ照射に晒される環境である。このような例では、しかしながら、電子部品は晒されながら動作する必要がある。対照的に、電気ステープラはガンマ殺菌照射に晒されている間に動作する必要はない。半導体を用いる場合、電子部品への電源が落とされていても、ガンマ照射は保存されたメモリに悪影響を及ぼす。これらの部品は、この照射に耐える必要があり、晒された後も使用可能となる必要がある。これをふまえて、ハンドル内の電子部品をガンマ殺菌しうる多様な基準がある。第1に、MOSEFTメモリを使用する代わりに、ヒューズ可能リンクメモリを使用することができる。このようなメモリでは、ヒューズがプログラムされる（焼かれる）と、メモリは永久的にとなりガンマ殺菌に耐えられる。第2に、メモリをマスクプログラムする。メモリにマスクを用いてハードプログラムすると、医療殺菌レベルのガンマ照射ではプログラムに悪影響は及ぼさない。第3に、揮発性メモリが空の間だけ殺菌を行い、殺菌後に様々な測定を通じてメモリにプログラミングを行い、例えば赤外線、無線、超音波、ブルートゥース通信を含むワイヤレスリンクを用いることができる。付加的あるいは代替的に、外部電極を清潔な環境で接触させてこれらの導電体がメモリをプログラミングしてもよい。最後に、放射線不透過性シールド（例えばモリブデンまたはタングステンで作成）をガンマ照射に敏感な部品の周りに設けて、これらの部品にダメージを与える可能性のある照射に晒されるのを防いでよい。

【0125】

上述したように、電池、ドライブトレイン、およびモータの特性は試験され、電気ステープル用途のために最適化される。電池の特定の設計（すなわち過科学的小およびPTC）により、供給される電流量および／または一定期間で生成される電力量が決定される。通常のアルカリ電池では、短期間で電気ステープル装置を作動させるのに必要な高い電力を生成する能力がない。また、いくつかのリチウム二酸化マンガン電池も、ステープル装置を作動させる要求を満たすことができない。このため、例えば電解質や正の温度係数など、特定のリチウム二酸化マンガン電池の特性を試験した。

【0126】

従来のリチウム二酸化マンガン電池（例えば、CR123やCR2）は、長期の負荷用に設計されていると理解される。例えば、SUREFIRE（登録商標）はフラッシュ光源やこのような電池で売られており、フラッシュ光の最大出力ルーメンで電池が20分から数時間（3乃至6）持つと述べている。この期間の電池の負荷は電池の電力容量と離れており、このため、電池の危機的な電流レートには届かず、過熱や爆発の危険はない。このような利用が連続しなければ、電池はこの同じ最大出力で多くのサイクル（数百）を通じて長持ちする。

10

20

30

40

50

【0127】

簡単に言うと、このような電池は10秒またはそれ以下、例えば5秒の期間の負荷用に設計されておらず、また例えば15回などの少ない回数の使用のために設計されていない。本発明は、電源、ドライブレイン、およびモータが、少ない使用回数でそれぞれの使用が10秒以下で負荷が定格よりかなり高い場合の電源（すなわち電池）を最適化するように構成する。

【0128】

テストしたすべての一次電池は、各々のPTC装置および／または化学的性質と内部構造で規定される臨界電流をもつ。この臨界電流レートより上で所定期間使用されると、電池は過熱し、爆発するかもしれない。少ないサイクル数で非常に高い電力要求（PTC閾値に近い）に晒されると、電圧と電流のプロファイルは従来の通常使用と同じふるまいでなくなる。いくつかの電池は、本発明のステープラが要求する電力の生成を妨げるPTC装置を具えるが、他の電池はこの電気ステープル装置に電力供給するのに必要な電力を生成することができる（所望の電圧で電流を供給できる）。これは臨界電流レートが特定の化学的性質、構造、および／または電池のPTCによって異なることを意味する。

【0129】

本発明は、電源が臨界電流レートより上の範囲で動作するように構成しており、これを本書で「超臨界電流レート」と称する。超臨界電流レートの定義には、電源から供給される臨界電流レートより上の変調電流の平均化が含まれることに留意されたい。超臨界電流レートで電力供給を行うと電池は長持ちしないため、その使用期間は短くなる。この電池が超臨界電流レートで駆動できる短い期間を本書で「超臨界パルス放出期間」と称し、電源が作動する期間全体を「パルス放出期間」と称する。換言すれば、超臨界パルス放出期間はパルス放出期間と同じか短い時間であり、電流レートが電池の臨界電流レートより大きい期間である。本発明における超臨界パルス放出期間は約16秒より短く、言い換えると約半分から15秒の範囲であり、例えば2乃至4秒であり、より具体的には約3秒である。この電源は、ステープル装置の寿命内で、例えば臨床処置の時間内で1回以上20回以下、例えば約5乃至15回、より具体的には10乃至15回を5分以内で、パルス放出期間において超臨界電流レートにかけられる。このため、電源の通常の適用時間に比べて、本発明は集中した使用となり、これを集中パルス時間といい、多くの場合に約200乃至300秒であり、具体的には約225秒である。器具に設けられる負荷は具体的な臨床アプリケーションに依存するため（すなわち、いくつかの組織は他より密集しており、組織密度が高いと装置にかかる負荷が大きくなる）、作動中、装置が所定の処置において超臨界電流レートを超えるか常に超えることは必要でない。しかしながら、手術処置での使用時にステープラは何回か超臨界電流レートを超えられるように設計される。超臨界パルス放出期間の動作では、装置は所望の手術処置を完了すべく十分な回数だけ動作可能であるが、電池は大きな電流で動作するように求められるためあまり多くはない。

【0130】

増大させた範囲で動作するとき、例えば電気ステープラ1の装置が生成する力は、既存の手動ステープラよりかなり大きくなる。事実、この力はかなり大きくステープラ自身にダメージを与える場合もある。使用の一態様では、モータおよび駆動アセンブリは、ステープルカートリッジがないかステープルカートリッジホルダ1030に直前に射出されたステープルカートリッジがある場合にナイフブレード1060が前進するのを防ぐ安全機構である、ナイフブレードロックアウト機能を損傷するまで作動してもよい。この構造が図33に示されている。上述したように、ナイフブレード1060は射出可能位置にステープルスレッド102がある場合、すなわちスレッド102が図33に示す位置にある場合にのみ遠位方向に移動可能とするべきである。スレッド102がその位置にない場合、2つの場合があり、ホルダ1030内にステープルカートリッジがないか、スレッド102が既に遠位方向に移動しているかであり、すなわちロードされたステープルカートリッジで射出が部分的または完全に生じていることを意味する。このため、ブレード1060は動いてはならず、またはその動きが制限されるべきである。したがって、スレッド10

2が射出段階でブレード1060を支えられるよう、スレッド102はロックアウト接触面104を具え、ブレード1060には対応する形状の接触ノーズ1069が設けられている。この地点で、ブレード1060がエッジ1035を超えて遠位方向に移動しない限り、下側ガイドウィング1065はカートリッジホルダ1030のフロア1034に対して静止しない。このような構成により、スレッド102がノーズ1069を支持すべくブレード1060の遠位端部にない場合、下側ガイドウィング1065はエッジ1035の近くまで凹部1037に追随し、そしてフロア1034上で前進する代わりにエッジ1035に当たりブレード1060のさらなる前進移動が防止される。スレッド102がない場合（「ロックアウト」と称す）にこの接触を補助するために、ステーブルカートリッジ1030はブレード1060を付勢する（1以上のリベット1036でそこに取り付けられた）プレートバネ1090を具える。プレートバネ1090が上側に曲がり、フランジ1067を（フランジ1067がプレートバネ1090の遠位端部の遠位側にくるまで）下側に押すと、下側に向いた力はブレード1060にかけられウィング1065を下側に凹部1037内へと押す。これにより、ブレード1060はスレッド102がなくても遠位側に進み、ウィング1065は凹部1047の下側カーブに沿って移動し、ウィング1065の遠位端縁がエッジ1035に当たるとさらなる遠位移動が止まる。

【0131】

この安全構造は、ナイフブレード1062からブレード1060に伝わる力がブレード1060から下側ガイドウィング1065を切り取るのに不十分である限り、上述のように動作する。本発明の電源、モータ、およびドライブレインで生成しうる力により、ブレード1060は遠位側に強く押されてウィング1065が引きはがされる。これが生じると、ブレード1060またはスレッド102の遠位側への移動を防ぐ手段はない。したがって、本発明は、ウィング1065がエッジ1035を超える前に、ここにかかる力を低減する方法を提供する。換言すると、ブレード1060にかけることができる力の上限は、（エッジ1035を超える）ブレード移動の第1の部分では低減され、ウィング1065がエッジ1035を一掃してフロア1034条で静止した後に増大する。より具体的には、これらの2つの部分の力発生リミッタの第1実施例は、ステーブル／切開ストロークの第1の部分で電源における1かもう少しのみの電池をモータに接続し、ステーブル／切開ストロークの第2の部分で電源における大部分または全部の電池をモータに接続する回路の形をとる。このような回路の第1実施例が図34に示されている。この第1実施例では、スイッチ1100が「A」の位置にある場合、モータ（例えばステーブルモータ210）は（本実施例で利用可能な4つのうち）1の電池602のみで駆動される。しかしながら、スイッチ1100が「B」の位置にある場合、モータは電源600の4つ全部の電池602で駆動され、これによりブレード1060にかかる力の量が増大する。スイッチ1100をAとBの位置で制御するには、第2のスイッチをブレード制御アセンブリのどこかに配設し、この第2のスイッチがウィング1065がエッジ1035を通り過ぎたら制御部に信号を送るようにする。この制御回路の第1実施例は単なる例示であり、同じ機能のアセンブリを装置のロックアウト保護に用意することが可能であり、これには例えば図36に示す第2実施例がある。

【0132】

モータの前後制御回路の第1の実施例が、図35に示されている。この第1実施例は二極双投スイッチを用いる。このスイッチ1200は通常、両極がオフとなるセンター位置にバネ付勢されている。図示するモータMは、例えば、本発明のステーブルモータを表すものである。図示するように、装置をオンにするにはパワーオンスイッチ1210を閉じる必要がある。もちろん、このスイッチは任意である。モータMの前進駆動を望む場合、スイッチ1200は図35に示すように右の位置に配置され、これによりモータを第1の方向に駆動するようにモータに電力が供給され、これは電池の「+」がモータMの「+」に接続されるため前進方向として規定される。この前進スイッチ位置では、モータMはブレード1060を遠位方向に駆動する。ブレード1060またはスレッド102の所望位置の最前部に適切なセンサまたはスイッチを設けると、モータMの電力供給を遮断する前

進移動リミットスイッチ1220を制御して、このスイッチ1220が開いている限りさらなる前進移動を防止することができる。このスイッチ1220が閉じて回路が完成しないよう、あるいは例えば新たなステーブルカートリッジが装填された場合にスイッチ1220のリセットのみを許可するよう、回路をプログラムすることができる。

【0133】

モータMの後進駆動を望む場合、スイッチ1200は図35に示す左の位置に配置され、これによりモータを第2の方向に駆動するようにモータに電力が供給され、これは電池の「-」がモータMの「-」に接続されるため後進方向として規定される。この後進スイッチ位置では、モータMはブレード1060を近位方向に駆動する。ブレード1060またはスレッド102の所望位置の最後部に適切なセンサまたはスイッチを設けると、モータMの電力供給を遮断する後進移動リミットスイッチ1230を制御して、このスイッチ1230が開いている限りさらなる後進移動を防止することができる。他のスイッチ（点線矢印で示す）を回路内に設けて、リミットスイッチ1220、1230とは別にどちらの方向への移動も選択的に制限してもよいことに留意されたい。

【0134】

モータはかなり大きな力でギアトレインを駆動することができ、これが高い回転慣性に変換される。このようにして、図34、35で説明したどのスイッチをモータのオフ切換に用いた場合でも、ギアは直ちに止まらない場合がある。代わりに、例えばモータへの電力が遮断された場合でもラック217が回転慣性によりそれまで移動していた方向に進み続ける。この動作は多くの理由で不利益となる。電源とモータを適切に構成することにより、このような遮断後の動作をほぼなくした回路を構成することができ、これにより利用者が動作をより制御できるようになる。

【0135】

図36は、前進または後進制御が遮断されたときにさらなる回転を阻止するモータ（例えばステーブルモータ210）の一実施例を示す。図36も、前進／後進制御とマルチステージ電源の代替実施例を示す図である。図36の回路は、電気モータの短絡回路特性を用いるモータ沮止サブ回路を具える。より具体的には、電気モータMが短絡回路に配置され、電氣的に生成された磁界が永久磁界と対立して生じ、これにより回転を続けるモータの速度を低下させ、慣性によるオーバーストロークが実質的に回避される。図36の回路がどのようにモータMを制動するかを説明するために、前進／後進スイッチ1300の一例が提供されている。図示するように、前進／後進スイッチ1300は、図35のスイッチ1200と同様に、3つのポジションがある。右の位置にある場合、モータMは後進回転方向に駆動される。スイッチ1300が作動していない場合、図36に示すように、モータMは回路短絡する。この回路短絡がスイッチ1300の上側部分により概略的に示されている。制動スイッチにおける切換プロセスは時間遅延方式で実現されることが望ましく、これはブレークビフォアメークスイッチング構成とも呼ばれる。モータMの動作をモータMを制動するよう切り換えると、モータの回路短絡が作用する前に前進／後進スイッチ1300の二極双投部分が開放される。逆に、モータMのブレーキ状態からモータMを駆動する場合、スイッチ1300がモータを作動させる前に短絡回路が開放される。これにより、運用では、利用者が3ウェイスイッチ1300を前進または後進位置から解除すると、モータMが回路短絡して迅速に制動される。

【0136】

図36における他の構造は、図35に関連して説明されている。例えば、オン／オフスイッチ1210が設けられている。電力ロックアウトスイッチ1100もあり、動作の所定部分で1の電池602'のみでモータ駆動し（ストロークの最初または他の所望部分で生じる）、動作の他の部分で全部の電池602（ここでは6つの電池）でモータMを駆動する。

【0137】

後進および前進リミットスイッチ1320、1330の新たな構成により、前進リミットスイッチ1320が作動した後にモータMのさらなる前進駆動が防止される。このリミ

ットに達したら、前進リミットスイッチ1320が作動して、スイッチが第2の位置に切り替わる。この状態では、モータに前進駆動させる電力が入らないが、後進駆動させる電力は供給することができる。この前進リミットスイッチは、所定のステーブルカートリッジ用にトグルまたはワнтаム使用となるようプログラムすることができる。より具体的には、スイッチ1320は、ステーブルカートリッジを新たなものと交換するようリセットされるまで第2の位置を保持する。したがって、交換されるまでは、モータMは後進方向にのみ駆動しうる。スイッチが単なるトグルである場合、スイッチ1320の作動から動作の一部が退かれた場合にのみ、追加のさらなる動作用に電力が復元される。

【0138】

後進リミットスイッチ1330も同様に構成することができる。後進リミットに達したら、スイッチ1330が第2の位置に切り替わり、リセットされるまでこれを保持する。この位置では、モータMは回路短絡しており、いずれの方向にもモータは駆動しない。この構成により、ステーブラの動作は前進リミットまでの一度のストロークと、後進リミットまでの一度の引き戻しに限定される。両方が起こった場合、モータMは2つのスイッチ1320がリセットされるまで使用不能となる。

【0139】

ここで図面を詳細に、特に、図37乃至40を参照すると、本発明にかかる電気手術器具1000の例示的な実施例が示されており、この実施例では電気手術用線形ステーブラである。図37および37'は装置1000の左側を示しており、ハンドルの外側シェル1001と1002が除去されている。同様に図39および39'は装置1000の右側を示しており、ハンドルの外側シェルが除去されている。外形シェル1001と1002の2半分(two halves)は、図63および66'のみに示されており、内側アセンブリを明確に示している。これらには示されていないが、以降の図はエンドエフェクタである。線形ステーブルエンドエフェクタの例示的な実施例が、2005年7月26日に出願された継続中の米国暫定特許出願整理番号60/702,643、2006年1月18日に出願された60/760,000、および2006年6月8日に出願された60/811,950と、2006年7月24日に出願された米国特許出願番号11/491,626、2006年9月29日出願された11/540,255と11/541,105、および2007年8月24日出願された11/844,406を含む、共有および同時係属中のファミリーに詳細に記載されている。この出願のファミリーの公開全文は、全体を参照することによりここに組み込まれる。

【0140】

図38および38'は装置1000の機械的アセンブリを示しており、左側フレーム1010が除去されている。図40および40'は、比較的、左、右側のフレーム1010、1020の双方が除去された機械的アセンブリを示している。

【0141】

図37および37'はギアカバープレート1105を示しており、モータトラスミッションアセンブリの1、2、3段ギア1110、1120、1130である。また、図37および37'に示されているのはエンドエフェクタクロージングアセンブリ1400である。このエンドエフェクタクロージングアセンブリ1400は図59乃至60'に詳細に図示されている。

【0142】

図37乃至38'はまた、電気駆動および駆動制御アセンブリを示している。この例示的な実施例での電気駆動アセンブリ1500は、1以上のバッテリー1510を含む取り外し可能なバッテリーパックである。上述のように、一の例示的な電源はCR123またはCR2電池の4乃至6の直列接続である。ここでは、6つのバッテリー1510がある。これらのバッテリー1510aのうち図37乃至37'の上部左側にある1つは、電氣的に切り離し可能に構成されていて、電力がモータ1520に選択的に、単一の電池1510aから6つのバッテリー1510の全セットのどちらか一方を通して供給されるよう設けられている。これは、わずかな電力しか必要としない場所または全トルクの禁止が望まれる場所で

のアプリケーションにおいて便利である。このような禁止の一例が、ステープルスレッドまたはブレードがロックアウトを越えて動くこととして上述されている。例示的な回路は、ステープル／切開ストロークの第1部の間、この1の電池1510aをモータ1520に接続し、ステープル／切開ストロークの第2部の間、電源供給における電池1510, 1510aの全てがモータ1520に接続される。図34を参照されたい。

【0143】

例示的な実施例での電源制御アセンブリ1600は、ロッカースイッチ1610の形態をとる。ロッカースイッチ1610の1の作動方向において、モータ1520は第1の方向、例えば前方へ回転し、ロッカースイッチ1610の別の作動方向において、モータ1520は反対の第2の方向、例えば後方に回転する。

10

【0144】

例示的な実施例での電気駆動式ドライブトレインは、線形カッター／ステープラの形態を駆動すべく用いられる。ここでは、ドライブトレインは、ステープル／切開動作を実行すべく用いられる。このためドライブトレインは、線形アクチュエータ1700に接続され、本実施例では、ラックガイド1720に沿って遠位および近位に移動する歯付のラックの形態である。図38および38'に示されているように、ラック1700は相対的に近位位置にある。近位端部（図38の右側）でシェル1001、1002のサイズを最小にするために、ラック1700は、回転部1710がラックガイド1720内に含まれない場合、（図38で見られるような）下向きに自由に回転する回転部1710を有する。ラック1700が遠位（図38で左側）に動くとき、回転部1710の底部はラックガイド1720の近位端部に接触し、ラックガイド1720の形状のため、ラック1700の残りの部分とほぼ同軸である位置へと上方に回転する。ラックガイド1720の近位端部は図41および41'で見られる。

20

【0145】

ラック1700の歯1702は、ラックアンドピニオン構造におけるドライブトレインの最終段と相互作用するよう形成されている。ドライブトレインの様々な形態が、実際には図37乃至47'のすべてで見ることができるが、ドライブトレインの詳細は、特に図43、43'、46、および46'を参照して容易に見ることができる。多くの図に見られる変速段のいくつかは歯を持たないことに注目されたい。これは、これらのギアが単に具体的な実施例の概略図であるからである。このように、歯がない場合や、歯の数やサイズが存在する場合でも、限定または固定と解されるべきではない。さらに、図示されるギアの多くは、歯の内側に配置された中央バンドを有する。このバンドは、装置1000の一部と見なされるべきではなく、単にこのアプリケーションの図を作成するのに用いられたソフトウェアの限定である。

30

【0146】

ドライブトレインの説明はモータ1520から始まる。モータ1520の出力ギア1522が変速機の1段1110、2段1120、および3段1130に接続される。3段1130は、装置1000の左側に存在する最終段に接続される。この接続は内部配置のため、全ての図で見るとは困難である。図55乃至56'は、しかしながら、3段から4段のクロスオーバーギア1140への接続を示す。上述のように、3段1130の出力は、歯がない円筒として概略的に図示されている。続けて図46および46'を見ると、クロスオーバーギア1140は4段に回転接続され、その軸1142は装置1000の左側から右側へとラック1700を横切る。軸1142の右側は、右側のギアのいずれにも回転形態で直接接続されていない。代わりに、右側フレーム1020内の対応するポケット内に嵌合するシャフトベアリング1144内で回転し、ここでフレーム1020は図46では除去されており、右側ドライブトレインを見ることができる。

40

【0147】

キャスルギア1146（図53および図53'に単独で示されている）は、クロスオーバーシャフト1142上に配置され、ともに回転するよう固定されているが、縦にしか動くことができない。このような接続を可能にするために、軸1142は図示されない内

50

部スロットを有し、キャスルギア 1 1 4 6 の 2 つの対向するポート 1 1 4 6 2 を通る図示されないピンが配置されている。ピンをキャスルギア 1 1 4 6 にしっかり固定することにより、軸 1 1 4 2 の回転によりキャスルギア 1 1 4 6 に付随する回転が生じるが、未だキャスルギア 1 1 4 6 は、少なくとも軸 1 1 4 2 のスロットまで軸 1 1 4 2 の縦軸に沿って自由に動くことができる。図 4 6 および 4 6 ' に見られるように、キャスルギア 1 1 4 6 の右側の胸壁 1 1 4 6 4 は、図 5 4 および 5 4 ' に単独で示されている 4 段ピニオン 1 1 4 8 の左側の対応する胸壁スロット 1 1 4 8 2 の間に嵌合するよう形成されている。キャスルギア 1 1 4 6 が 4 段ピニオン 1 1 4 8 に確実に接合される必要があるため、右側の付勢力 F が必要となる。この付勢力を供給するため、図示しない圧縮バネを、例えば、一端部がクロスオーバーギア 1 1 4 0 の右側面へ接触し、他方の端部がキャスルギア 1 1 4 6 の外側円筒面から放射状に離れて突出する中央フランジ 1 1 4 6 8 の左側面へ接触するように設けてもよい。（このフランジ 1 1 4 6 8 は、装置 1 0 0 0 の手動解放特性に関してより詳細に後述される。）様々な別の同様に機能する付勢装置が、例示したバネの代わりに用いられてもよい。このような構成は、キャスルギア 1 1 4 6 を 4 段ピニオン 1 1 4 8 に選択的、回転的に係合可能にする。より具体的には、キャスルギア 1 1 4 6 が付勢装置の力 F 以外のいかなる力も受けない場合、胸壁 1 1 4 6 4 は胸壁スロット 1 1 4 8 2 と合致し、軸 1 1 4 2 の回転が 4 段ピニオン 1 1 4 8 の回転を起こさせる。しかしながら、付勢力 F に対向し、越える力がかかる場合、胸壁 1 1 4 6 4 は胸壁スロット 1 1 4 8 2 から出て、軸 1 1 4 2 の回転は 4 段ピニオン 1 1 4 8 にまったく影響を与えない。この選択的な係合により、手動解放を実現することができる。このような開放を説明する前に、右側ドライブトレインが説明される。

【0 1 4 8】

4 段ピニオン 1 1 4 8 はドライブトレインの 5 段 1 1 5 0 に直接接続され、これは 5 段軸 1 1 4 2 と、5 段軸 1 1 4 2 に回転固定される 5 段入力ギア 1 1 5 4 と、5 段軸 1 1 4 2 にまた回転接続される 5 段ピニオン 1 1 5 6 とを具える。5 段ピニオン 1 1 5 6 の歯はラック 1 7 0 0 の歯 1 7 0 2 に直接接続される。こうして、5 段入力ギアの回転により、5 段ピニオンの回転およびラック 1 7 0 0 の縦の動きが生じる。図 4 6 および図 4 6 ' の例示的な実施例に見られるように、5 段入力ギア 1 1 5 4 の時計回りの回転は、ラック 1 7 0 0 （後退）に近位方向の動きを起こさせ、5 段入力ギア 1 1 5 4 の反時計回りの回転は、ラック 1 7 0 0 （伸長）に遠位方向の動きを起こさせる。

【0 1 4 9】

上記ドライブトレインの 5 段の接続によると、モータ軸の一方向の回転はラック 1 7 0 0 に縦の動きを起こさせるが、これはキャスルギア 1 1 4 6 が 4 段ピニオン 1 1 4 8 と係合される場合のみである。キャスルギア 1 1 4 6 が 4 段ピニオン 1 1 4 8 と係合されない場合は、モータの回転はラック 1 7 0 0 に影響を与えない。この 2 つのギア 1 1 4 6 と 1 1 4 8 が非接続状態となると、ラック 1 7 0 0 の手動解放が実現する。

【0 1 5 0】

装置 1 0 0 0 の運用において、ラック 1 7 0 0 はエンドエフェクタのいくつかの部分を作動させるように放射状に動く（伸長する）。線形ステーブル／切除装置の実施例において、ラック 1 7 0 0 が遠位に動くと、ステーブル留めおよび切開を起こさせるスレッドは、ステーブル留めおよび切開の双方を実行すべく遠位方向に動く。エンドエフェクタの顎部の間に配置される組織は、実際には各手術処置で異なるので、施術者は、（ステープリングアクチュエータおよび切断ブレードを担持する）スレッドが何らかの理由で引っかかったり動かなくなる時を予測できない。このような場合、スレッド、よってラック 1 7 0 0 は、モータを使用することなく遠位に引き戻す必要がある。また、電力を損失する可能性もある。スレッドが遠位位置にある場合にこれが起こると、エンドエフェクタの顎部間に組織を挟んで閉じたままになり、したがって、顎が開き、組織が解放される前に、スレッドを近位に移動させなければならない。このような場合において、モータを使用することなく、スレッド、よってラック 1 7 0 0 は遠位に後退する必要がある。これらの所望の機能のどちらかを有効にするために、本発明は手動解放アセンブリ 1 8 0 0 を提供する

。

【0151】

図37乃至44'、55、55'、および59乃至62'の各々において、手動解放レバー1810は非作動（例えば下）位置にある。図45、45'、57、57'において、手動解放レバー1810は中間位置にある。図46乃至47'、56、56'、58、および58'において、手動解放レバー1810は、完全に作動（例えば上）位置にある。

【0152】

図44乃至44'に見られるように、手動解放レバー1810が非作動位置にある場合、キャスルギア1146は4段ピニオン1148に係合される。これによりモータ1520の出力ギア1522の回転が、ラック1700を動かす。しかしながら、4段ピニオン1148は5段入力ギア1154に直接接続されるだけではない。4段ピニオンは、1段解放ギア1820にも直接接続され、これが2段解放ギア1830に直接接続される。こうして、4段ピニオン1148の回転が、必然的に2段解放ギア1830を回転させる（その方向は、その間にあるギアの数による）。このギア1830の軸が手動解放レバー1810に直接接続される場合、レバー1810は4段ピニオン1148が回転する度に回転する。4段ピニオン1148が1回転以上回転すると、レバー1810は360度完全に回転することが可能である。予想されるように、手動解放レバー1810を2段解放ギア1830（以下の図48乃至48'の説明を参照）に連結する一方向ギアアセンブリがあるため、これは起こらない。1段解放ギア1820は、そこから同軸上に延びる歯付軸1822を有することに注目されたい。この歯付軸1822はインジケータホイール1840に直接連結される。ホイール1840の右側面は、ホイール1840の軸の周りに直線的に延びる湾曲形状となっており、表面の残りの部分と異なる色を有する。右側シェル1002（図64乃至65'を参照）にある窓1004に連結される場合、色の着いた形状は、完全な近位（すなわち後退した）位置から動いたラック1700の直線距離に対応する線形様式で、よりよく見えるようになる。

【0153】

手動解放レバー1810を2段解放ギア1830に連結する一方向ギアアセンブリは、図48および図48'に示されている。このアセンブリは、レバー1810の回転点で中心付けされたラチェットギア1850を設け、当該ラチェットギア1850の軸1852を2段解放ギア1830の中心ボア1832の中を通して伸長させることによって形成される。このように軸1852を2段解放ギア1830のボア1832に固定すると、2段解放ギア1830の回転により、対応してラチェットギア1850が回転する。しかし、単にこのラチェットギア1850を2段解放ギア1830とともに回転させるだけでは、モータ1520がドライブレインに電力を供給していない場合にラック1700の手動解放をアシストしない。

【0154】

手動解放機能を作り出すには2つの要素がある。まず、右側ギアトレインを左側ギアトレインおよびモータから切り離す装置である。これにより、手動開放を作動させるときに、モータ1520および左側トレインのギアの双方によって生じる抵抗を乗り越えなくてもよくなる。この切り離しは、キャスルギア1146が4段ピニオン1148から離れる場合に起こる。この切り離しを起こすために、カムプレート1860がラチェットギア1850と2段解放ギア1830のとの間に配置され、軸1852に回転固定される。カムプレート1860は、図52および図52'に示されている。カムプレート1860には、キャスルギア1146の中央フランジ11468と相互作用するよう配置される傾斜カム面1862が設けられている。カムプレート1860と中央フランジ11468との相互作用は、図44乃至47'および図57乃至58'の工程で見られる。

【0155】

図44および44'では、手動解放レバー1810は非作動位置にあり、これはキャスルギア1146が4段ピニオン1148に回転可能に接続されることが望まれることを

意味する。この方法において、モータ1520の回転は、4段ピニオン1148の回転およびラック1700の動きに変換される。図45乃至47'および57乃至58'において、手動解放レバー1810は複数の作動位置のうちの1つにあり、これらはそれぞれ、カムプレート1860を回転させて、これにより傾斜したカム面がキャスルギア1146の中央フランジ11468に接触し、十分にキャスルギア1146を左側に押しやって胸壁11464が4段ピニオン1148の胸壁スロット11482から分離するよう図示されている。この位置において、キャスルギア1146は、4段ピニオン1148から回転的に切り離されている。このように、モータ1520の回転（または左側トレインのギア）は右側ギアトレインから完全に独立し、こうしてモータ1520の回転によってラック1700が動かないようにしている。

10

【0156】

右側ギアトレインが右側モータおよびギアトレインから回転可能に独立し、手動ラック解放機能を持つようになった後、ラック1700は近位方向に動く必要がある。この動きをもたらすために、第2の手動解放装置が設けられる。この第2の手動解放装置はラチェットギア1850の歯1832と相互作用し、手動解放レバー1810の反時計回りの回転が（装置1000の右側から見た場合）ラチェットギア1850を時計回りに回転させる（この向きは、この回転が5段ピニオン1156を時計回りに回転させるので、例示的な実施例で所望される）、これはラック1700の近位の動き（すなわち後退）に相当する回転である。ラチェットギア1850をこの時計回りのレバー1810の動きを用いて制御するために、本発明はレバー1810のロッキングボス1814に回転可能に取り付けられるラチェット爪1870を提供する。この構成は図48および48'にうまく例示されている。図示しない板バネがレバー1810のスプリングチャネル1816に固定され、ラチェットギア1850に向かう方向Dに爪1870を付勢する。爪1870が何らかの方法で抑止されない場合、爪1870は常にラチェットギア1850の歯1852に接触し、本実施例においてキャスルギア1146および4段ピニオン1148が互いに係合し（すなわち図44を参照）共に回転する場合に生じるギア1850の時計周りの回転を防ぐことに注目されたい。この状態を防ぐために図44、44'、55、および55'に示されているように、爪1870の遠位端部は爪キャビティ1818から2段解放ギア1830へと伸長する拡大部1872を有する。2段解放ギア1830とカムプレート1870の間に第2のカムプレート1880があるため、爪カム1882を拡大部1872の底面に接触するよう配置して、レバー1810がホームまたは非作動位置にある場合に、（Dと反対向きで、板バネの付勢に反する力を提供することにより）爪1870を爪キャビティ1818に保持することができる。爪1870と爪カム1882間の接触は、図44、44'、55、および55'に示されている。したがって、レバー1810が作動されない場合、爪1870はラチェットギア1850の歯1852と接触しない。これに対し、手動解放が4段ピニオン1148からラチェットギア1850を離すのに十分な位置を過ぎて回転した場合、爪1870の底面はもはや回転していないカムプレート1880の爪カム1882と接触せず、したがって、時計回りに回転する場合、（板バネの付勢力によって）Dの向きに自由に動いてラチェットギア1850の歯1852に係合する。このように、時計回りに回転する場合、爪1870は歯1852の上面に対して歯止めされる。

20

30

40

【0157】

レバー1810を例えば約15度動かした後、爪1870は、もはや爪カム1882と接触せず、キャスルギア1146の胸壁11464は、もはや4段ピニオン1148の胸壁スロット11482と係合しない。このポイントにおいて、爪1870は軸1852の方へ動くことができ、ラチェットギア1850の歯1852の1つと係合する。さらに、レバー1810の反時計回りの動きがラチェットギア1850を回転させ、これに応じて2段解放ギア1830が時計回りに回転する。順に、2段解放ギア1830の回転は1段解放ギア1820を時計回りに回転させ、4段ピニオン1148を反時計回りに回転させ、5段入力ギア1154を時計回りにそれぞれ回転させる。上述のように、5段入力ギ

50

ア 1 1 5 4 の時計回りの回転により、ラック 1 7 0 0 の近位の動きが生じ、これはラック 1 7 0 0 に接続されるエンドエフェクタ特性の手動解放において望まれる移動方向である。レバー 1 8 1 0 が解放されると、戻りバイアス 1 8 9 0 はレバー 1 8 1 0 を非作動位置（図 4 4 および 4 4 ' を参照）に戻し、これにより爪カム 1 8 8 2 が爪 1 8 7 0 を、ラチェットギア 1 8 5 0 の歯 1 8 5 2 から外される爪キャビティ 1 8 1 8 の上部位置に戻す。爪カム 1 8 8 2 と拡大部 1 8 7 2 の下面間の接触は、爪カム 1 8 8 2 の各上部正面と上部後面および拡大部 1 8 7 2 の底部正面と底部後面を成形することによりスムーズになることに注目されたい。さらに、例えばコイルバネといった、戻りバイアス 1 8 9 0 が図 4 6、5 7、および 5 8 に示されており、その一端はレバー 1 8 1 0 に固定されるボルト周りに巻かれ、反対の他端はシェル 1 0 0 1、1 0 0 2 の一部に固定されるシャフトであり、ここでは図示されない。コイルバネ 1 8 9 0 の反対の軸は、描画プログラムの限界のため図のみで動く。この動きは本発明では生じない。

【0158】

上述のように、本発明の装置 1 0 0 0 のためのエンドエフェクタの一実施例は、その間に配置される組織上で閉じる一組の顎部と、切開される組織の 2 つの側部を互いに固定するステープラ／カッターとを具える。上記の手動解放はステープラ／カッターに取り付け可能であり、エンドエフェクタクロージングアセンブリ 1 4 0 0 は、作動時に、顎部と一緒に閉じるために顎部に取り付け可能である。図 5 9 乃至 6 0 ' は、顎部とエンドエフェクタクロージングアセンブリ 1 4 0 0 の取り付けの一実施例を図示する。ここで、エンドエフェクタクロージングアセンブリ 1 4 0 0 はレバーサポート 1 4 1 2 を有し、ハンドルピボット 1 4 1 4 周りに回転するハンドル 1 4 1 0 を具える。このレバーサポート 1 4 1 2 はリンク 1 4 2 0 の第 1 の端部に回転接続される。リンク 1 4 2 0 の反対の第 2 の端部は、スライダシャフト 1 4 3 0 に回転接続される。エンドエフェクタシャフトアセンブリ 1 9 0 0 は外側シャフト 1 9 1 0 と内側シャフト 1 9 2 0 を具える。内側シャフト 1 9 1 0 はフレーム 1 0 1 0、1 0 2 0、およびエンドエフェクタの下顎に縦に固定され、このため、エンドエフェクタに縦に固定された要素となる。外側シャフト 1 9 2 0 は内側シャフト 1 9 1 0 に連結され、そこで縦に動く。エンドエフェクタの上顎は下顎に関して回転する。回転させるために、外側シャフト 1 9 2 0 は、図 5 9 に示されている近位位置から、図 6 0 に示されている遠位位置に伸長される。外側シャフト 1 9 2 0 が内側シャフトを囲むので、一部分（例えば上部）が、上顎ピボットの近位位置である開口した上顎の近位端部に接触する。外側シャフト 1 9 2 0 がさらに遠位に動くとき、上顎は固定ピボット位置のため遠位に動くことができないが、そのピボットの周りを回転可能である。したがって、上顎は、縦に固定された下の顎の上に閉じる。換言すると、図 5 9 乃至図 6 0 の工程で見られるように、ハンドル 1 4 1 0 が電気アセンブリ 1 5 0 0 に向かって動くと、スライダ 1 4 3 0 は図 5 9 の近位位置から図 6 0 の遠位位置へと縦方向に動く。この従来技術の顎アセンブリは、エチコンによって製造された線形ステープラに存在する。

【0159】

エンドエフェクタシャフトアセンブリ 1 9 0 0 のこの例示的な構成は、2 0 0 7 年 8 月 2 4 日に出願された米国特許出願番号 1 1 / 8 4 4, 4 0 6 を含む同時係属中のファミリーに示されたエンドエフェクタの動作と反対であることに注目されたい。この出願に示されているように、図 3 9 および 4 0 では、下顎／ステープルカートリッジホルダ 1 0 3 0 は隙間 1 0 3 1 上を近位方向に動く際、上部アンビル 1 0 2 0 の近位上端が縦に固定されたドラムスリーブ 1 0 4 0 に対して押圧されるので、上部アンビル 1 0 2 0 は下方に回転する。

【0160】

その一つを上述した従来の様々な従来技術の線形ステープラは、同じエンドエフェクタおよび軸を用いている。したがって、本発明の装置 1 0 0 0 は、これら従来のエンドエフェクタアセンブリを内部に嵌合しうることが望ましい。このことは、例えば、図 6 1 乃至 6 2 ' に示されているような左右フレーム 1 0 1 0、1 0 2 0 を構成することにより達成される。これらのフレーム 1 0 1 0、1 0 2 0 は、図 6 2 に示されているような一側（上

側)の開口で形成されている。この構成において、従来のエンドエフェクタシャフトアセンブリの内側シャフト1910の近位端部は、そこで内側シャフト1910(全アセンブリ)を縦に固定するように、各タブ1012、1022間に単に隣接させ、その方向を除いた全ての半径方向間で内側シャフト1910を横に固定し、内側シャフト1910がフレーム1010、1020間の開口に挿入される。この開口を閉じるために、シャフトプラグ1930は、例えば図61に示されているようなボルトを用いて、タブ1012、1022間に固定される。別の代替的な実施例において、シャフトプラグ1930は、左右のフレーム1010、1020の遠位端部を伸長させることにより完全に無視され、それらと一緒に設けて二枚貝のデザインに形成し、内側シャフト1910周りに固定する。


【0161】

上記の説明や添付の図面は、本発明の原理と、好適な実施例と、動作モードとを示す。より具体的には、本発明の最適化された電源、モータ、およびドライブレインは、手術用ステープラに関して説明されている。しかしながら、本発明は上述した具体的な実施例に限定されると解釈されてはならない。当業者であれば、上述した実施例のさらなる変更を理解することができ、電力または出力電流が制限された電池で短く限られた時間だけ大きな電力または出力電流を必要とする手術デバイス以外の応用例も同様である。図示し説明したように、本発明の最適化によれば、限られた電源で、例えば82kg以上のおよその重量を持ち上げ、押し、引き、引きずり、引き戻し、または他の種類の力を供給することができる。


【0162】

上述した実施例は、説明のためであって限定するものではない。したがって、当業者であれば添付のクレームに規定された本発明の範囲を逸脱することなく、これらの実施例の変形例を理解することができる。


【図1】

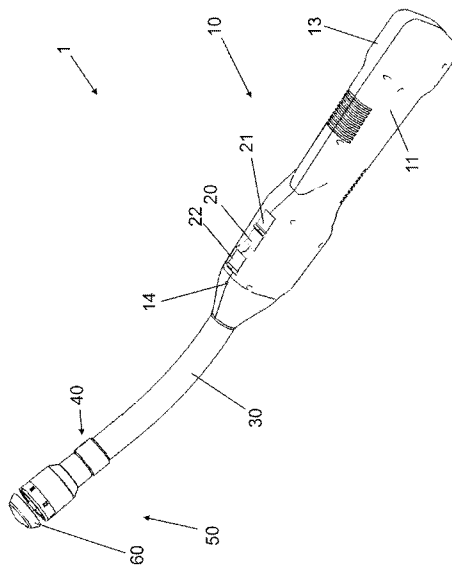


【図2】

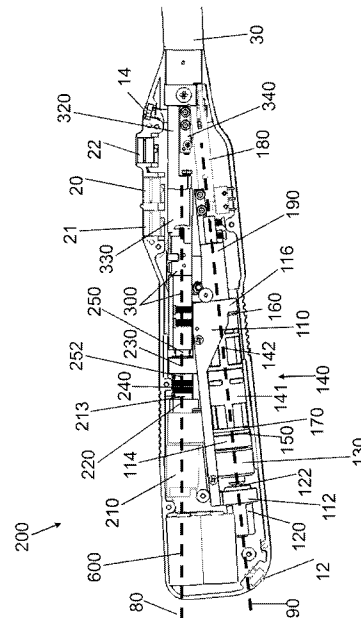


【図 3】

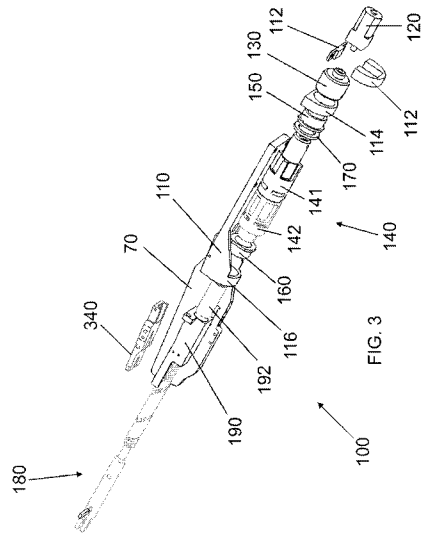


【図 4】

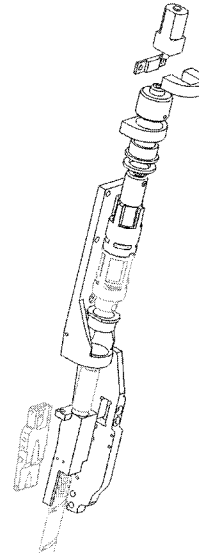


【図 5】

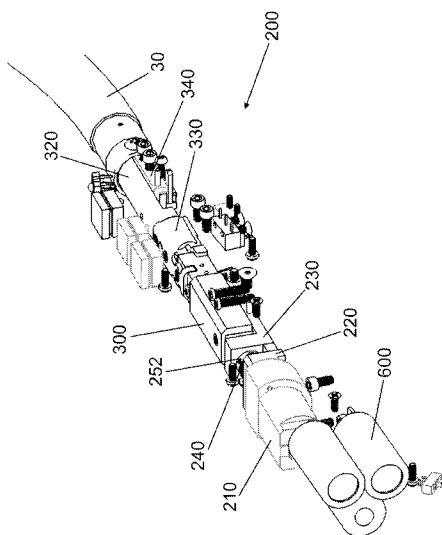


【図 6】

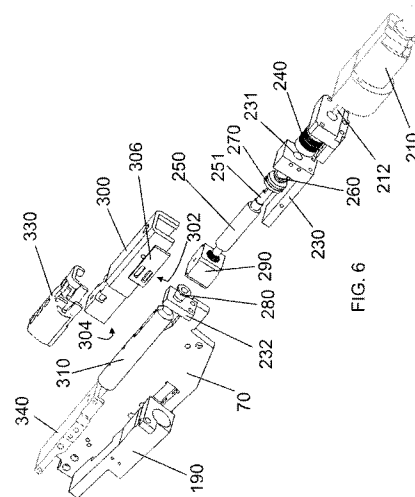


【図 7】

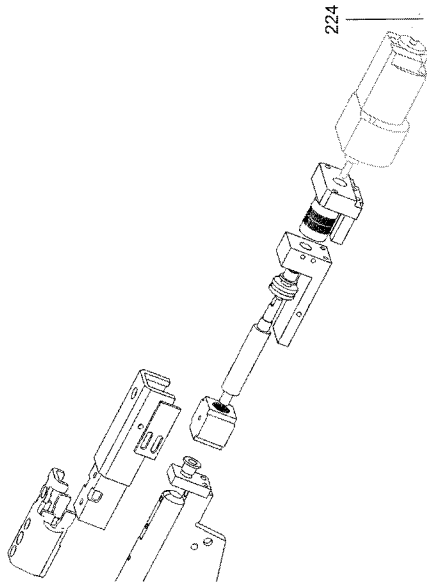


【図 8】




【図 9】

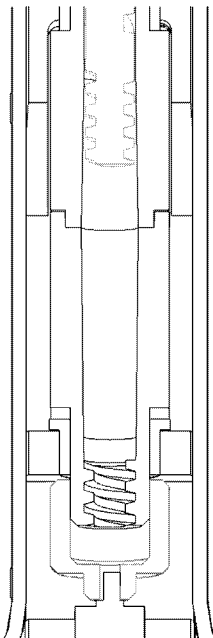


【図 10】

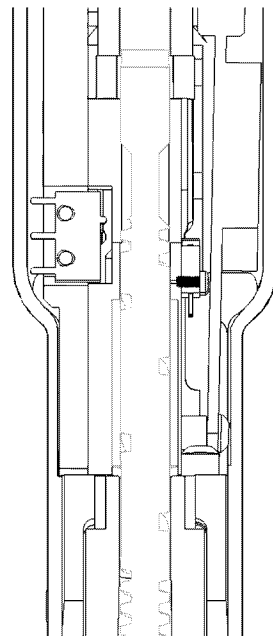


【図 1 1】

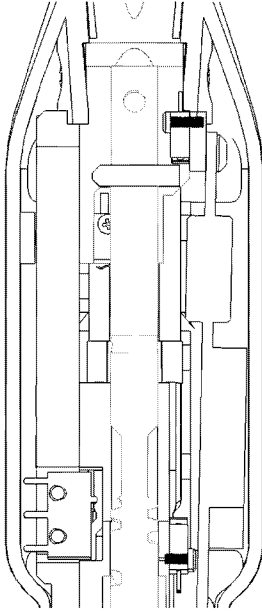


【図 1 2】

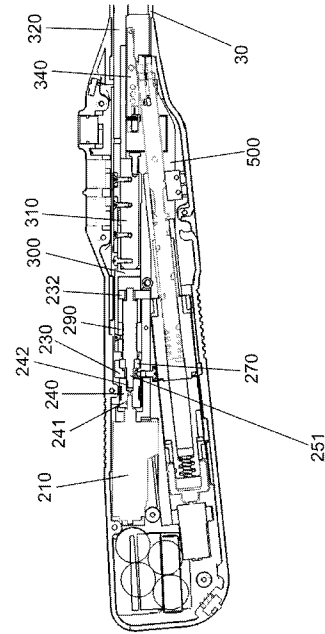


【図 1 3】

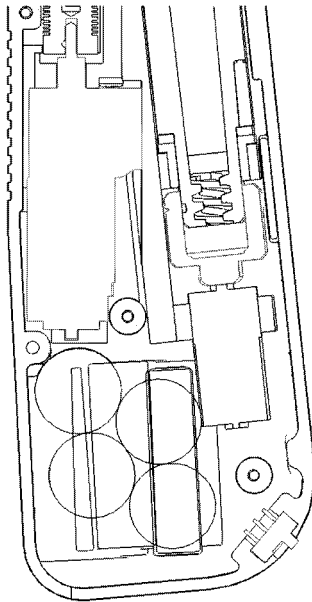


【図 1 4】

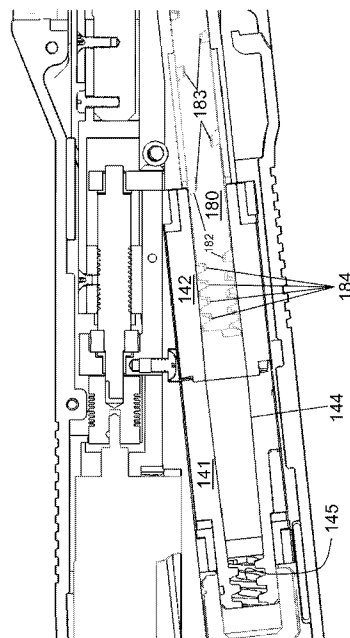


【図 15】

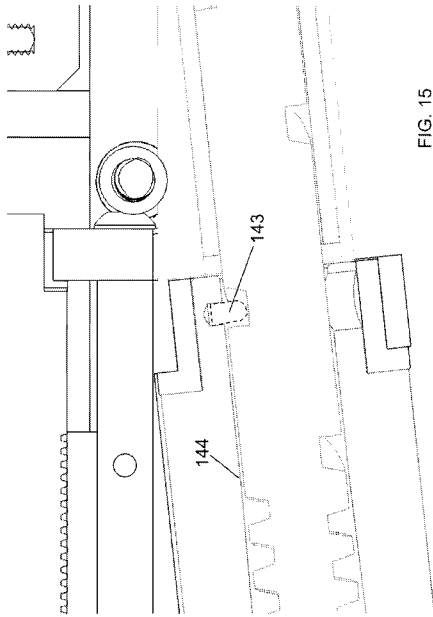


【図 16】

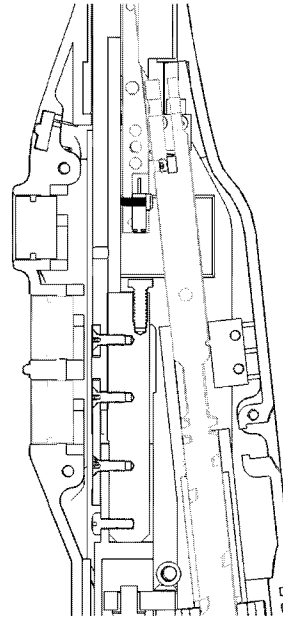


【図 17】




【図 19】

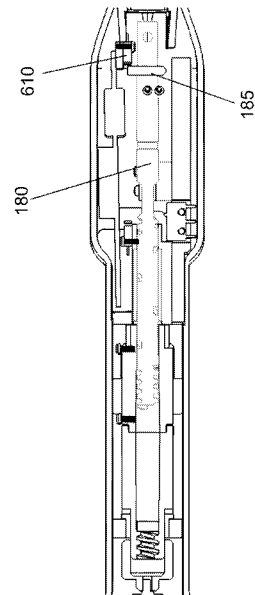


【図 18】

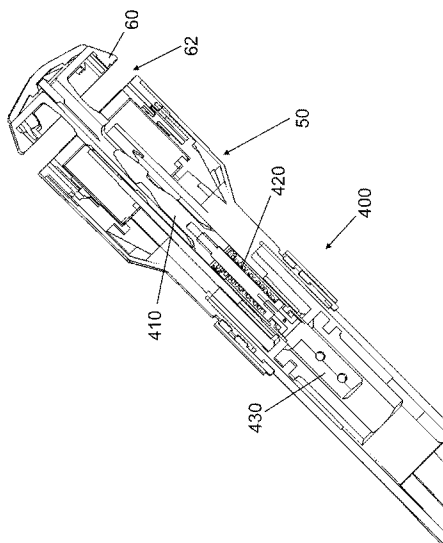


【図 20】

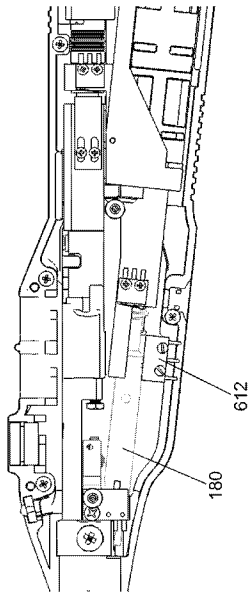


【図 21】

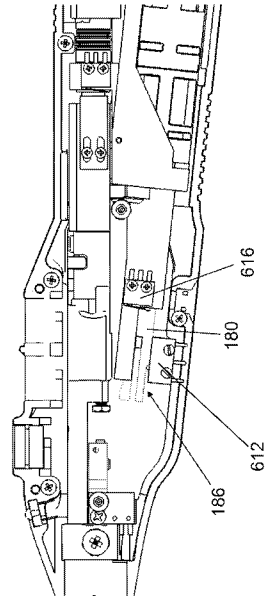


【図 22】

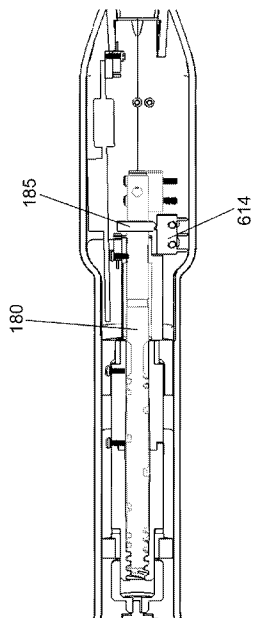


【図 23】

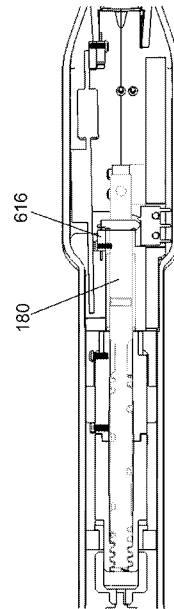


【図 2 4】

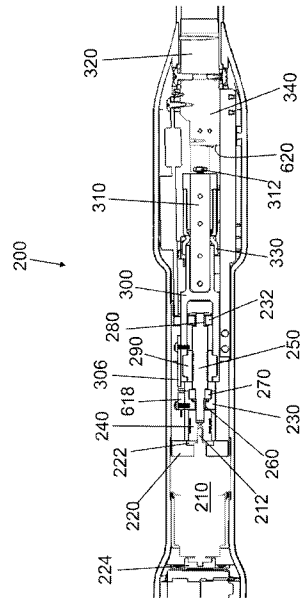


【図 2 5】

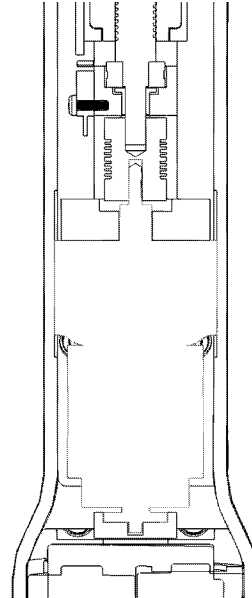


【図 2 6】

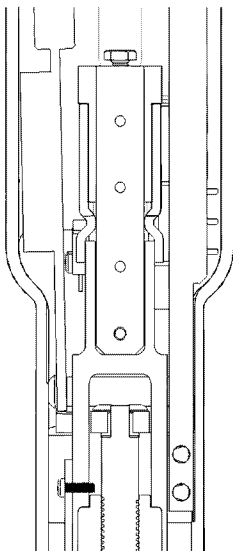


【図 2 7】

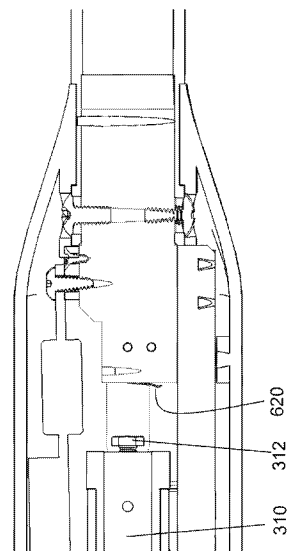


【図 28】

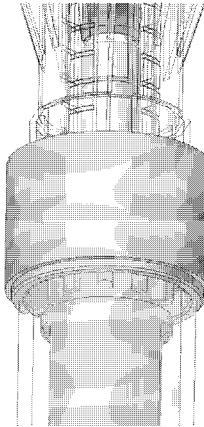


【図 29】

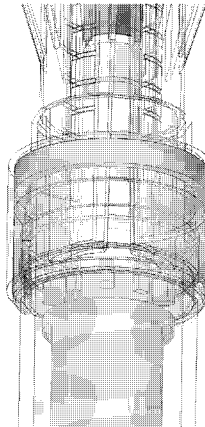


【図 30】

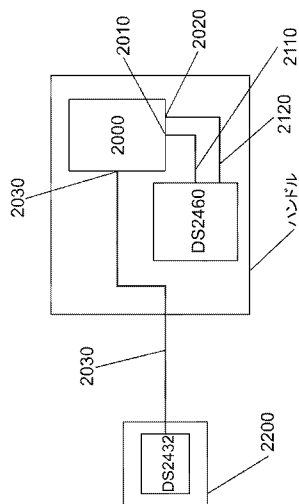


【図 31】

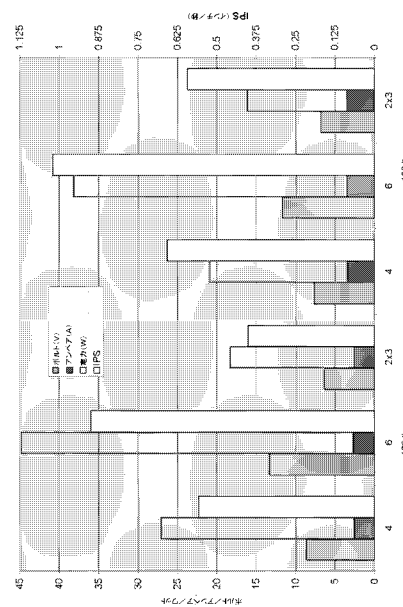


【図 3 2】

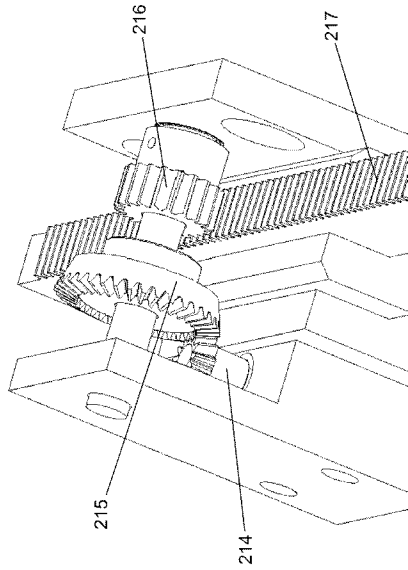


【図 3 3】

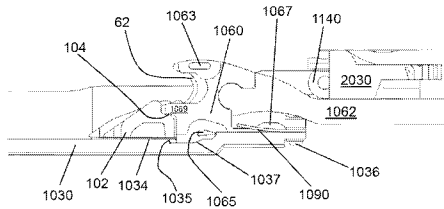


【図 3 6】

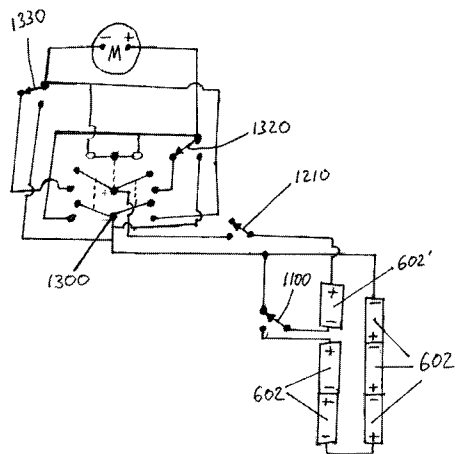

【図 3 4】



【図 3 5】

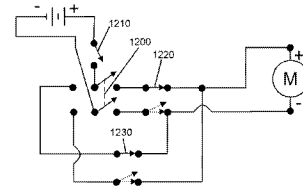

【図 3 7】



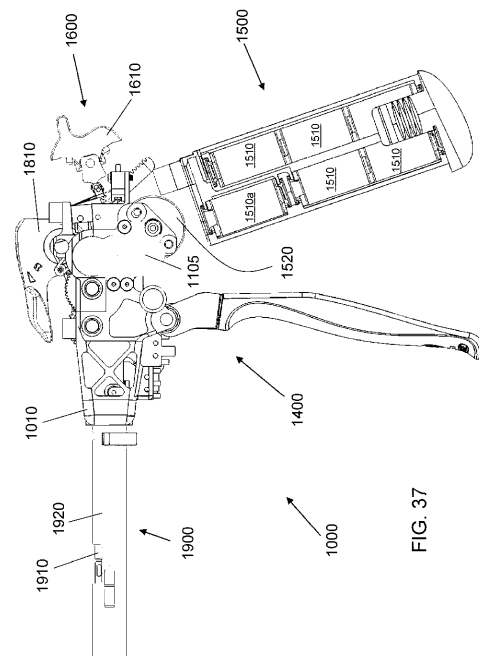


FIG. 37


【図 38】

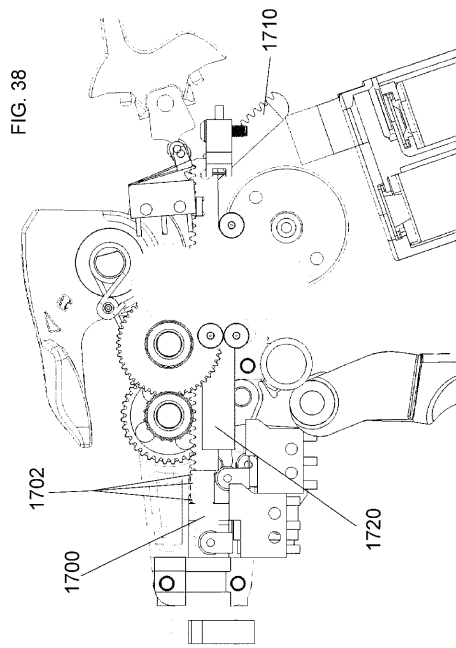


【図 39】

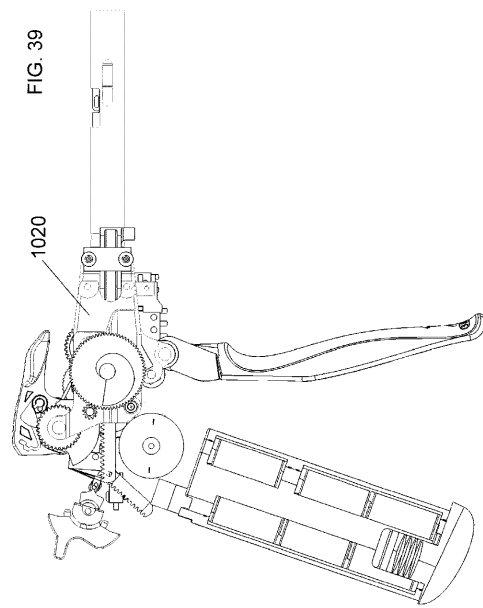


【図 40】

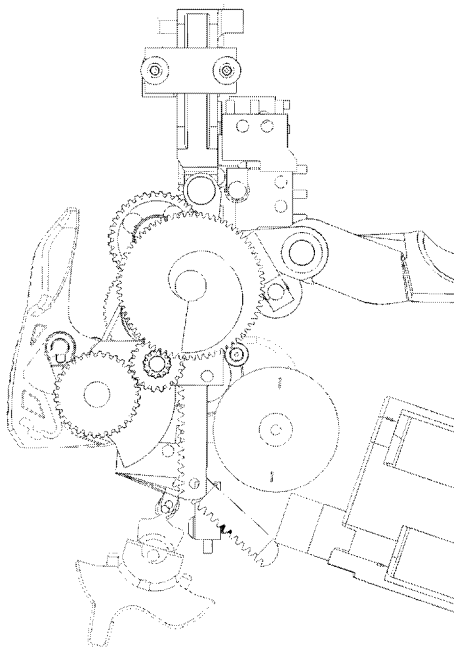


【図 41】

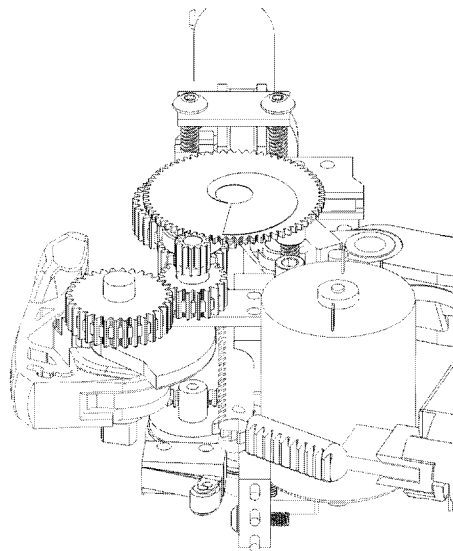


【図 4 2】

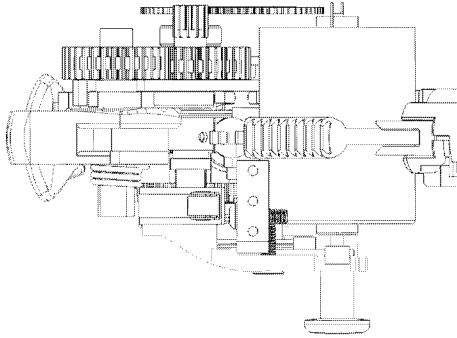


【図 4 3】

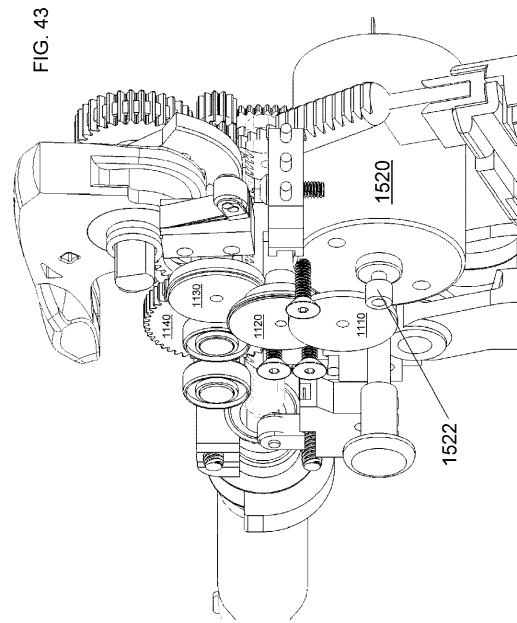


【図 4 4】

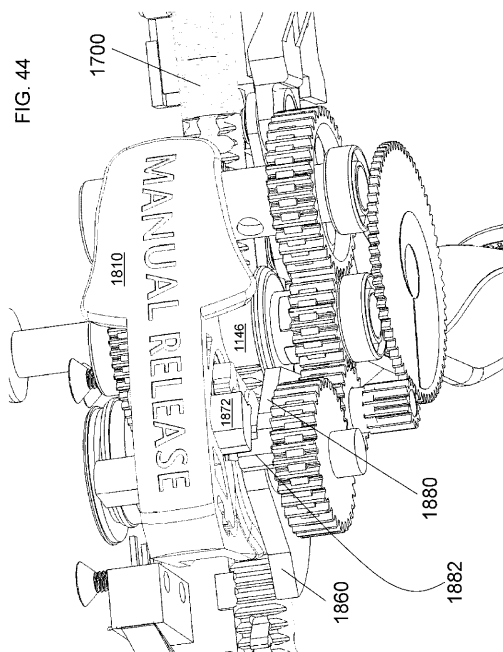


【図 4 5】

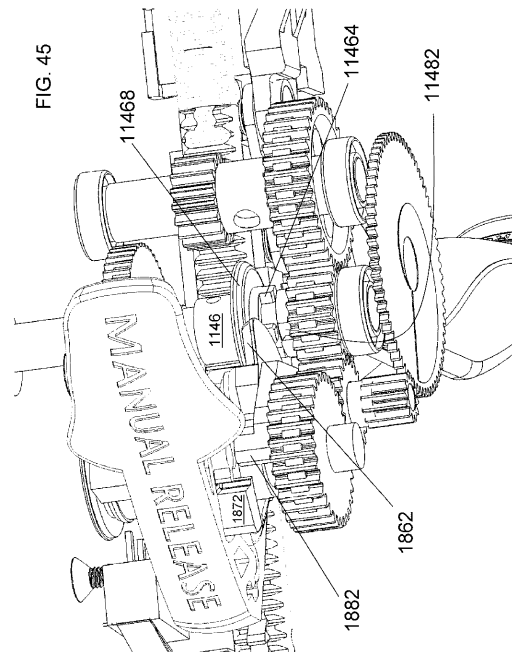


【図 4 6】

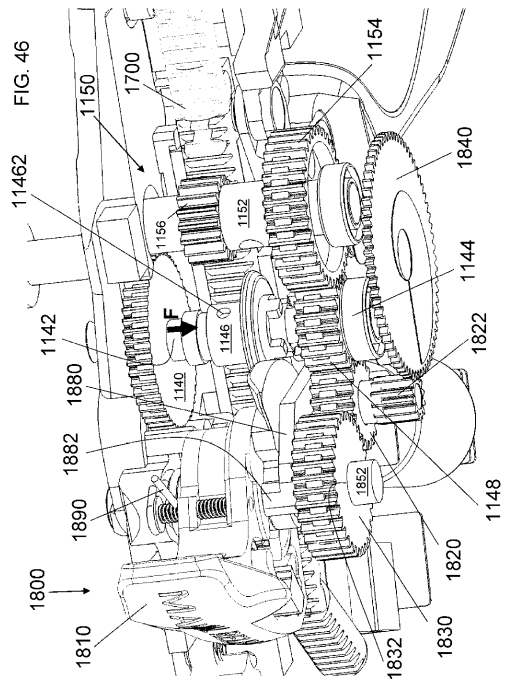


【図 4 7】

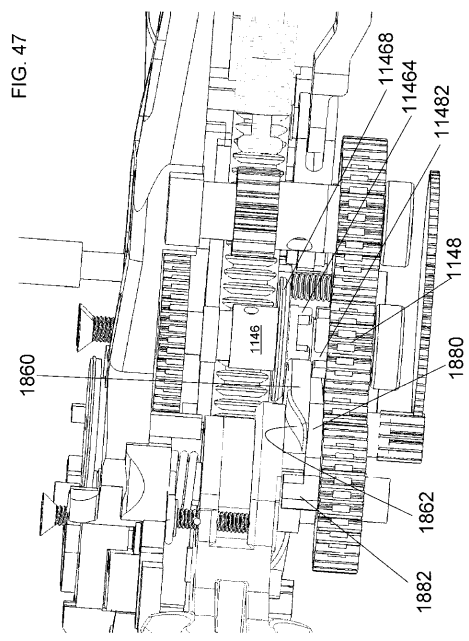


【図 4 8】

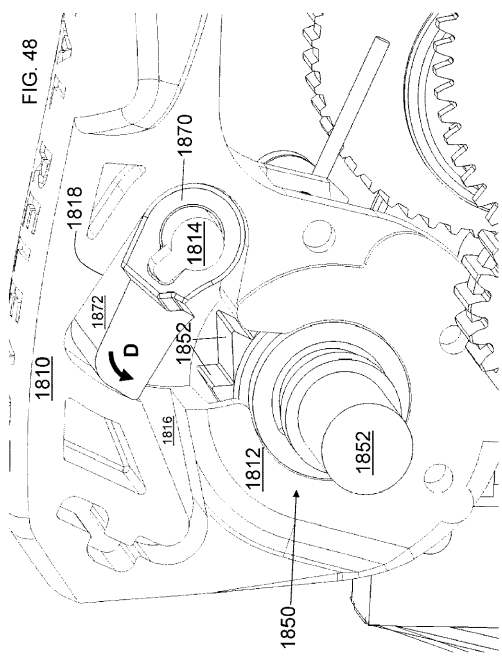

【図 4 9】




【図 5 0】

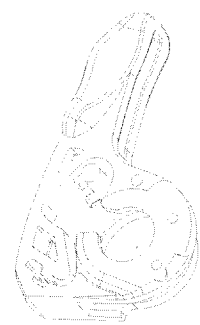


【図 5 1】




【図 5 2】

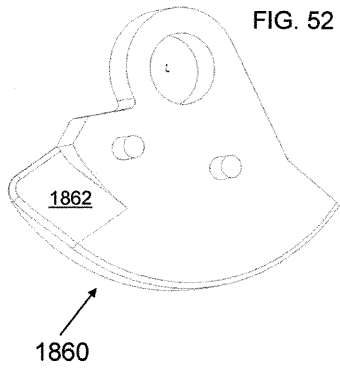


【図 5 3】

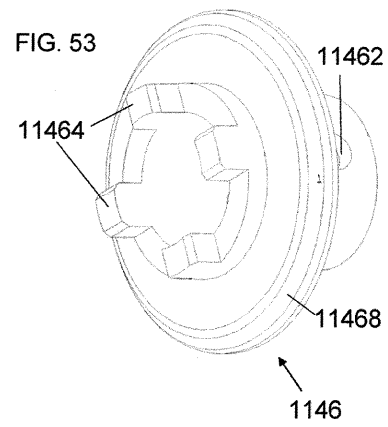


【図 5 4】

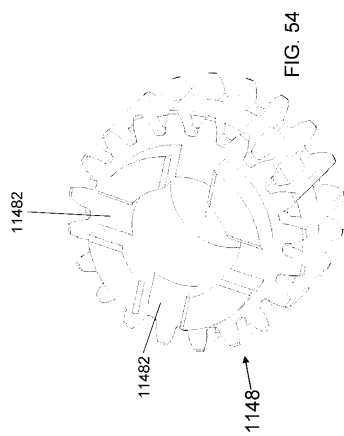


【図 5 5】

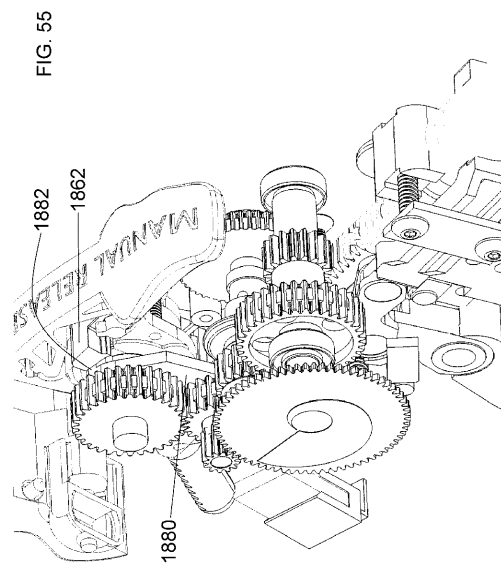


【図 5 6】

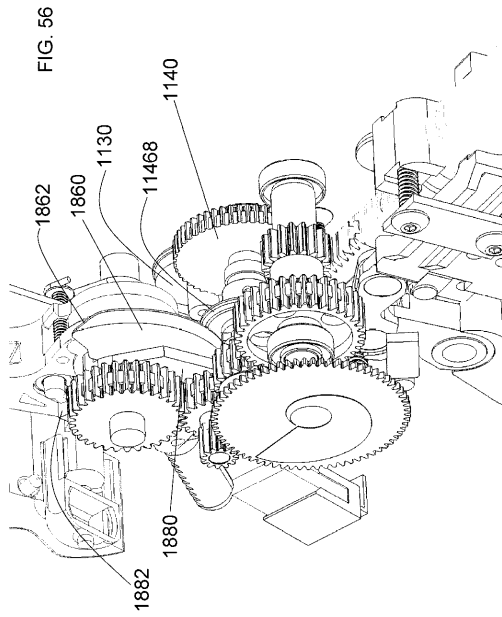


【図 5 7】

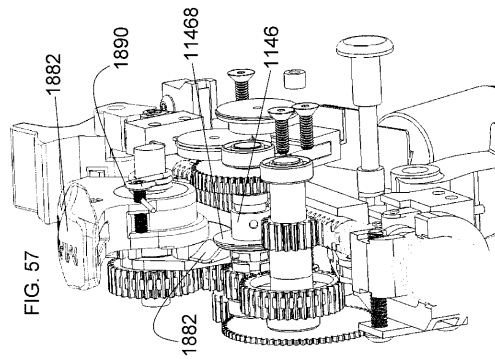


【図 5 8】

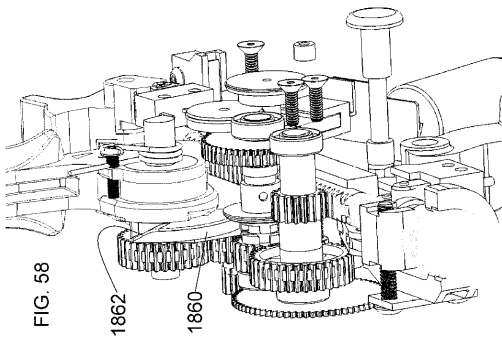


【図 5 9】

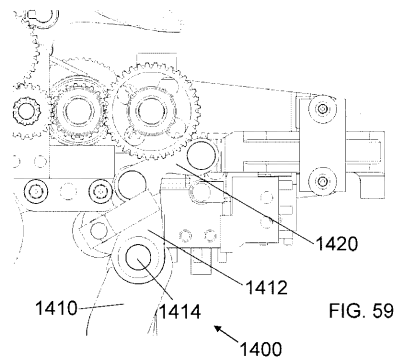


【図 60】

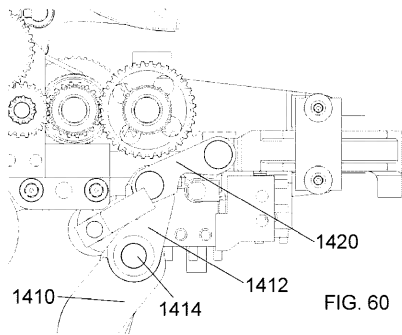


【図 61】

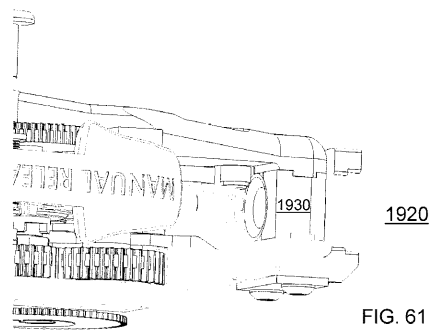


【図 62】

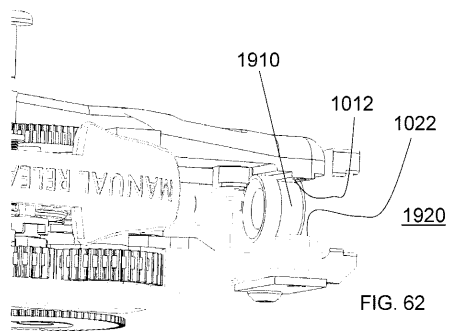


【図 63】

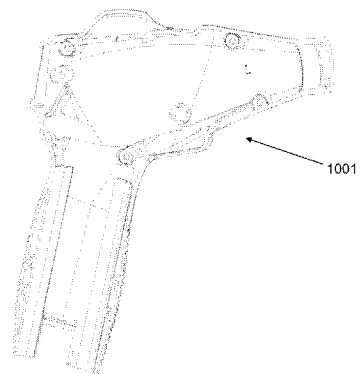


【図 64】

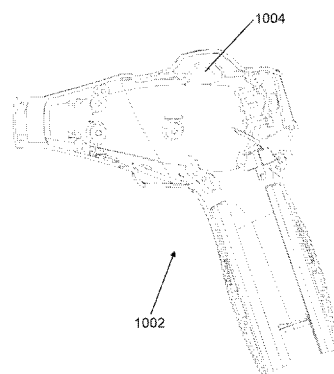

【図 6 5】

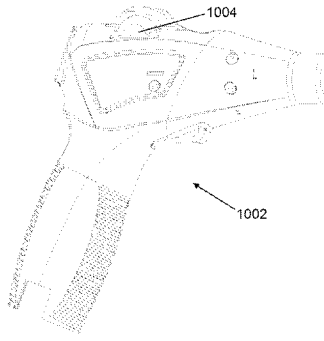

【図 6 6】

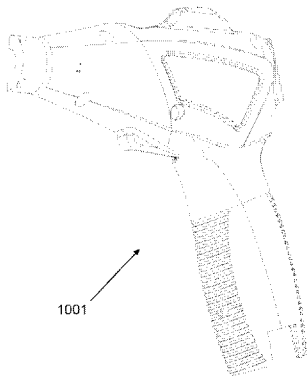

フロントページの続き

(31)優先権主張番号 12/034,320

(32)優先日 平成20年2月20日(2008.2.20)

(33)優先権主張国・地域又は機関
米国(US)

(特許庁注：以下のものは登録商標)

1. ブルートゥース

(72)発明者 バレス, トーマス

アメリカ合衆国 フロリダ州 3 3 1 5 6, コーラルゲーブルス, アルビダレーン 9 1 5 1

(72)発明者 ドゥビル, デレク

アメリカ合衆国 フロリダ州 3 3 1 5 5, マイアミ, サウスウエスト34ストリート 5 7 3 0

(72)発明者 リヴェラ, カルロス

アメリカ合衆国 フロリダ州 3 3 3 3 0, クーパーシティ, サウスウエスト120アベニュー
5 8 1 7

(72)発明者 パーマー, マシュー

アメリカ合衆国 フロリダ州 3 3 1 5 6, マイアミ, サウスウエスト64コート 1 2 7 9 0

Fターム(参考) 4C160 CC33

专利名称(译)	手术器械		
公开(公告)号	JP2019217331A	公开(公告)日	2019-12-26
申请号	JP2019156824	申请日	2019-08-29
[标]申请(专利权)人(译)	伊西康内外科公司		
申请(专利权)人(译)	爱惜康结束 - 杰里先生，油墨.		
当前申请(专利权)人(译)	爱惜康结束 - 杰里先生，油墨.		
[标]发明人	スミス ケビン バレストーマス ドゥビルデレク リヴェラカルロス パーマー マシュー		
发明人	スミス, ケビン バレス, トーマス ドゥビル, デレク リヴェラ, カルロス パーマー, マシュー		
IPC分类号	A61B17/115		
CPC分类号	A61B17/1114 A61B17/115 A61B90/98 A61B2017/00084 A61B2017/00398 A61B2017/00473 A61B2017/00734 A61B2017/2943 A61B2090/065 A61B2090/08021 A61B2090/0811 A61B17/07207 A61B17/1155 A61B2017/0046 A61B2017/07257 A61B2017/07271 A61B2017/07285 A61B2090/0814 H04L9/10		
FI分类号	A61B17/115		
F-TERM分类号	4C160/CC33		
优先权	60/902534 2007-02-21 US 60/977489 2007-10-04 US 12/034320 2008-02-20 US		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供一种使用自电力的电动自驱动手术器械。解决方案：手术器械包括外科手术末端执行器，该手术末端执行器具有用于在其中可移除地容纳可互换部分的容纳部分。接收部分具有通信连接。连接到末端执行器的手柄可致动末端执行器。手柄具有电连接到通信连接的控制器，用于在放置在末端执行器上时验证可互换的零件。可互换部分可移除地连接到接收部分，并且具有加密装置，当其放置在接收部分处时，该加密装置可电移除地连接到通信连接。当由电子控制器查询时，加密设备对可互换部分进行身份验证。图30

