### (19)中华人民共和国国家知识产权局



# (12)实用新型专利



(10)授权公告号 CN 208481452 U (45)授权公告日 2019. 02. 12

(21)申请号 201820147089.8

(22)申请日 2018.01.29

(73)专利权人 江苏邦士医疗科技有限公司 地址 225300 江苏省泰州市泰州中国医药 城口泰路东侧、新阳路北侧G21幢6层

(72)发明人 何成东 朱高兴 岳欣

(74) 专利代理机构 南京正联知识产权代理有限 公司 32243

代理人 文雯

(51) Int.CI.

A61B 18/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

#### (54)实用新型名称

精准手术能量控制系统

#### (57)摘要

本实用新型提供一种精准手术能量控制系统,包括中央处理模块、电源接口、整流模块、DC-DC变压器一、DC-DC变压器二、模拟PID闭环控制及固定频率驱动模块、频率与占空比可变的数字驱动模块一、频率与占空比可变的数字驱动模块二、DC-AC逆变器、过流过压过温检测模块和解码模块,整流模块通过电源接口连通电源,整流模块通过DC-DC变压器一、DC-DC变压器一、DC-AC逆变器分别通过过流过压过温检测模块连接中央处理模块;该系统能够实现精准医疗手术,实现各种有源治疗设备的高度集成。本实用新型还能够降低医生口设备操作不熟而产生医疗风险,且丰富的功能高满足手术需求。

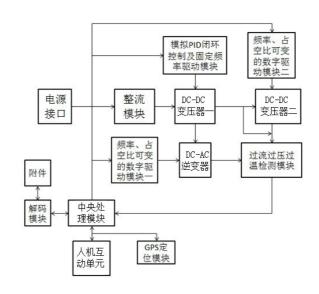

CN 208481452 U

- 1.一种精准手术能量控制系统,其特征在于:包括中央处理模块、电源接口、整流模块、DC-DC变压器一、DC-DC变压器二、模拟PID闭环控制及固定频率驱动模块、频率与占空比可变的数字驱动模块一、频率与占空比可变的数字驱动模块二、DC-AC逆变器、过流过压过温检测模块和解码模块,整流模块通过电源接口连通电源,整流模块通过DC-DC变压器一连接DC-DC变压器二、DC-DC变压器二、DC-DC变压器二、DC-AC逆变器分别通过过流过压过温检测模块连接中央处理模块,中央处理模块通过占空比可变的数字驱动模块一连接DC-AC逆变器,中央处理模块通过频率与占空比可变的数字驱动模块二连接DC-DC变压器二,中央处理模块通过模拟PID闭环控制及固定频率驱动模块连接DC-DC变压器一,中央处理模块通过解码模块连接附件接口。
- 2.如权利要求1所述的精准手术能量控制系统,其特征在于:中央处理模块还分别连接 人机互动单元和GPS定位模块。
- 3.如权利要求1所述的精准手术能量控制系统,其特征在于:中央处理模块连接有外接接口,外接接口连接有脚踏开关。
  - 4. 如权利要求1所述的精准手术能量控制系统,其特征在于:附件接口连接有附件。
- 5.如权利要求1所述的精准手术能量控制系统,其特征在于:附件接口包括精准电刀模式接口、精准等离子模式接口、精准超声刀模式接口、精准碎石模式接口。

## 精准手术能量控制系统

#### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种精准手术能量控制系统。

#### 背景技术

[0002] 目前进行手术时,一台有源设备往往不可单一完成手术,需要一台或多台设备配合完成。这个过程中,存在主机和附件不具备识别和匹配,往往因混乱而出错,单台功能不全,2台又会功能重复,增加不必要的采购成本,医生需操作多品牌的设备,出错概率增大;功能参数粗略,技术落后,不满足精准手术需求。此外医院人多设备多,空间有限,设备占用空间越少越好。

[0003] 上述问题是在精准手术过程中应当予以考虑并解决的问题。

#### 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种精准手术能量控制系统解决现有技术中存在的多台有源设备配合使用时,主机和附件不具备识别和匹配,往往因混乱而出错,需操作多品牌的设备,出错概率增大;功能参数粗略,技术落后,不满足精准手术需求的问题。

[0005] 本实用新型的技术解决方案是:

[0006] 一种精准手术能量控制系统,包括中央处理模块、电源接口、整流模块、DC-DC变压器一、DC-DC变压器二、模拟PID闭环控制及固定频率驱动模块、频率与占空比可变的数字驱动模块一、频率与占空比可变的数字驱动模块二、DC-AC逆变器、过流过压过温检测模块和解码模块,整流模块通过电源接口连通电源,整流模块通过DC-DC变压器一连接DC-DC变压器二、DC-DC变压器二、DC-AC逆变器分别通过过流过压过温检测模块连接中央处理模块,中央处理模块通过占空比可变的数字驱动模块一连接DC-AC逆变器,中央处理模块通过频率与占空比可变的数字驱动模块二连接DC-DC变压器二,中央处理模块通过模拟PID闭环控制及固定频率驱动模块连接DC-DC变压器一,中央处理模块通过解码模块连接附件。

[0007] 进一步地,中央处理模块还分别连接人机互动单元和GPS定位模块。

[0008] 讲一步地,中央处理模块连接有外接接口,外接接口连接有脚踏开关。

[0009] 进一步地,附件接口连接有附件。

[0010] 进一步地,附件接口包括精准电刀模式接口、精准等离子模式接口、精准超声刀模式接口、精准碎石模式接口。

[0011] 进一步地,中央处理模块具有附件主动识别功能,目自动匹配模式和最佳能量。

[0012] 本实用新型的有益效果是:该种精准手术能量控制系统,能够实现精准医疗手术,实现各种有源治疗设备的高度集成,能够节省医院宝贵空间,并能够降低设备采购量价。本实用新型还能够降低医生因设备操作不熟而产生医疗风险,且丰富的功能满足任何手术需求。

#### 附图说明

[0013] 图1是本实用新型实施例精准手术能量控制系统的说明框图:

[0014] 图2是实施例中中央处理模块与精准电刀模式接口、精准等离子模式接口、精准超声刀模式接口、精准碎石模式接口的说明框图。

#### 具体实施方式

[0015] 下面结合附图详细说明本实用新型的优选实施例。

#### 实施例

[0016] 一种精准手术能量控制系统,如图1,包括中央处理模块、电源接口、整流模块、DC-DC变压器一、DC-DC变压器二、模拟PID闭环控制及固定频率驱动模块、频率与占空比可变的数字驱动模块一、频率与占空比可变的数字驱动模块二、DC-AC逆变器、过流过压过温检测模块和解码模块,整流模块通过电源接口连通电源,整流模块通过DC-DC变压器一连接DC-DC变压器二、DC-DC变压器二、DC-AC逆变器分别通过过流过压过温检测模块连接中央处理模块,中央处理模块通过占空比可变的数字驱动模块一连接DC-AC逆变器,中央处理模块通过频率与占空比可变的数字驱动模块二连接DC-DC变压器二,中央处理模块通过模拟PID闭环控制及固定频率驱动模块连接DC-DC变压器一,中央处理模块通过解码模块连接附件。

[0017] 该种精准手术能量控制系统,能够实现精准医疗手术,实现各种有源治疗设备的高度集成,能够节省医院宝贵空间,并能够降低设备采购量价。本实用新型还能够降低医生因设备操作不熟而产生医疗风险,且丰富的功能满足任何手术需求。

[0018] 中央处理模块连接有外接接口,外接接口连接有脚踏开关。附件接口连接有附件,即各有源治疗设备。如图2,附件接口包括精准电刀模式接口、精准等离子模式接口、精准超声刀模式接口、精准碎石模式接口。

[0019] 该种精准手术能量控制系统包括高频交流和脉冲直流两部分,其高频交流输出频率在低于1MHz任意可调可控,且波形可控可调;任意单一模式下有效输出功率〈400W。

[0020] 中央处理模块具有附件主动识别功能,且能自动匹配好模式和最佳能量;GPS全球卫星定位;远程授权开通;远程升级。

[0021] 中央处理模块还分别连接人机互动单元和GPS定位模块。实施例中,人机互动单元 采用液晶显示,能够实现不同模式分屏显示。精准电刀模式至少包含:电切、电凝、双极凝; 精准等离子模式至少包含消融切割、凝固止血;精准超声刀模式至少包含:切、凝、凝切等模式;精准碎石模式至少包含:细碎、粉碎、破碎等模式。

[0022] 实施例与现有技术的对比结果如表1。

[0023] 表1 实施例与现有技术的对比结果表

对		效果	特点	性能指标
比	精准医疗手术	相放不	<b>粗放式模拟控制、能</b>	高頻电刀、等离子刀、超
现	相征医力于水	精准	保证基本的安全有	南級电バ、寺南丁が、地 声刀、碎石刀各厂家主要
有		413.11	效: 每种设备功能单	性能指标不一致,各产品
技			<del></del> 1	间功能有重合
术	各种有關治疗设备 的高度集成	否	不具有符合性功能	每种设备功能单一
	节省医院宝贵空间	否	需4台主机、4个脚踏 及与之匹配的电源	是本方案的 5 倍, 甚至更 多
	降低设备采购量价	总量多 总价高		高出本方案 30%
	降低医生因设备操	混乱	各种设备、线缆交织	出错率高出 15%,尤其需
	作不熟面产生医疗			要多台设备才可完成的
68	大皇 化水体流压体	-	Warte Barriet A Hill W	手术
	丰富的功能 續足任 何手术 需求	否	一次手术可能会用到 任何1台、2台、多台	不渝足
8 U	精准医疗手术	精准	精密數字化控制、多	具有单极切割止血、双极
实		3000000	应用本领于一身	消融切割止血、碎石、超
施				声切割止血
例	各种有關治疗设备	是	将高頻电刀、等离子	有电刀模式、等离子模
33	的高度集成		刀、超声刀、碎石设 备的功能高度融合	式、碎石模式、超声模式
	节省医院宝贵空间	是	一台主机一个脚踏	空间节省 70%
	降低设备采购量价	是	1 台设备 4 台设备价	节省30%费用
	THE CONTRACTOR	_	€ CE	P H SWASCA
8	降低医生因设备操	是	一台主机一个脚踏	主机识别模式匹配能量。
- 80	作不熟而产生医疗		Septimized and September 1992 (Septimized Septimized Se	人为干预较少,出错率大
	风险			<b>幅降低</b>
	丰富的功能端足任	是	一次手术可能会用到	常用功能齐全,各模式可
26 2	何手术需求		任何1台、2台、多台 解决所有手术	交替使用

[0024]

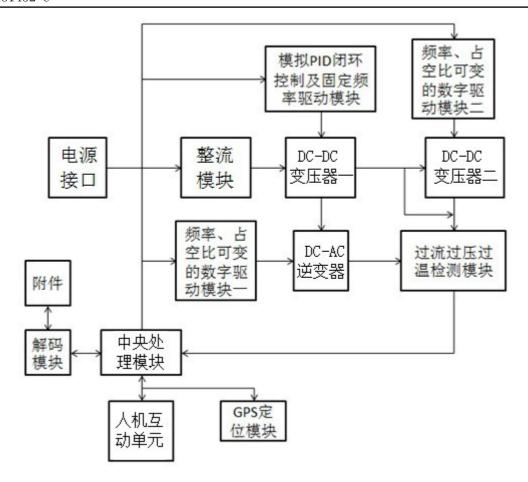


图1

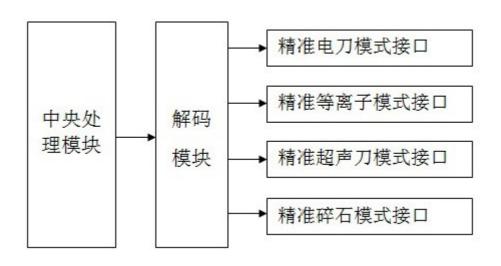


图2



专利名称(译)	精准手术能量控制系统			
公开(公告)号	CN208481452U	公开(公告)日	2019-02-12	
申请号	CN201820147089.8	申请日	2018-01-29	
[标]申请(专利权)人(译)	江苏邦士医疗科技有限公司			
申请(专利权)人(译)	江苏邦士医疗科技有限公司			
当前申请(专利权)人(译)	江苏邦士医疗科技有限公司			
[标]发明人	何成东 朱高兴 岳欣			
发明人	何成东 朱高兴 岳欣			
IPC分类号	A61B18/00			
代理人(译)	文雯			
外部链接	Espacenet SIPO			

#### 摘要(译)

本实用新型提供一种精准手术能量控制系统,包括中央处理模块、电源接口、整流模块、DC-DC变压器一、DC-DC变压器二、模拟PID闭环控制及固定频率驱动模块、频率与占空比可变的数字驱动模块一、频率与占空比可变的数字驱动模块二、DC-AC逆变器、过流过压过温检测模块和解码模块,整流模块通过电源接口连通电源,整流模块通过DC-DC变压器一连接DC-DC变压器二、DC-DC变压器一、DC-DC变压器二、DC-AC逆变器分别通过过流过压过温检测模块连接中央处理模块;该系统能够实现精准医疗手术,实现各种有源治疗设备的高度集成。本实用新型还能够降低医生因设备操作不熟而产生医疗风险,且丰富的功能满足手术需求。

