

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-73890

(P2004-73890A)

(43) 公開日 平成16年3月11日(2004.3.11)

(51) Int.Cl.⁷

A61B 18/00

// A61B 18/12

F I

A61B 17/36

330

A61B 17/39

310

A61B 17/39

320

テーマコード (参考)

4C060

審査請求 有 請求項の数 1 O L (全 24 頁)

(21) 出願番号 特願2003-396311 (P2003-396311)
 (22) 出願日 平成15年11月26日 (2003.11.26)
 (62) 分割の表示 特願2003-366718 (P2003-366718)
 の分割
 原出願日 平成7年4月6日 (1995.4.6)

(71) 出願人 000000376
 オリンパス株式会社
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
 (74) 代理人 100076233
 弁理士 伊藤 進
 (72) 発明者 菅井 俊哉
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
 リンパス株式会社内
 Fターム(参考) 4C060 JJ13 JJ23 KK03 KK04 KK12
 MM24


(54) 【発明の名称】 超音波切開凝固装置

(57) 【要約】

【課題】よりの確に生体組織に対して処置を施すことを可能とする超音波切開凝固装置を提供する。

【解決手段】超音波振動を発生する超音波振動子と、前記超音波振動子に接続され、前記超音波振動を生体組織に対して処置を行う為の処置部へ伝達する振動伝達部材としてのプローブと、前記プローブ遠位端部との間に生体組織を把持する把持部材と、前記プローブ遠位端部と前記把持部材とにより生体組織を把持及び開放する為の操作を行う操作手段と、を有し、前記プローブ遠位端部は、前記把持部材との間で生体組織を把持可能とするとともに、遠位側に向けて細径化する形状を呈する。

【選択図】図2

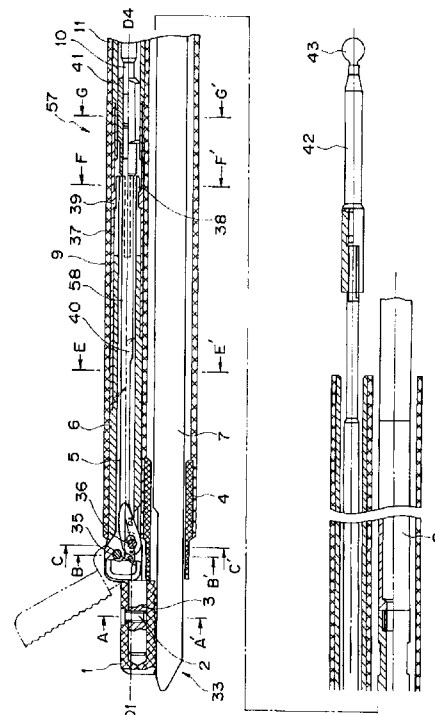

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

超音波振動を発生する超音波振動子と、
前記超音波振動子に接続され、前記超音波振動を生体組織に対して処置を行う為の処置部へ伝達する振動伝達部材としてのプローブと、
前記プローブ遠位端部との間に生体組織を把持する把持部材と、
前記プローブ遠位端部と前記把持部材とにより生体組織を把持及び開放する為の操作を行う操作手段と、
を有する超音波切開凝固装置において、
前記プローブ遠位端部は、前記把持部材との間で生体組織を把持可能とするとともに、遠位側に向けて細径化する形状を呈することを特徴とする超音波切開凝固装置。 10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は超音波を利用して切開或いは凝固等の処置を行う超音波切開凝固装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、超音波振動を用いて生体組織に対して処置を行う事は一般的に知られており、その中でも生体組織を吸着あるいは把持する等、超音波処置具に固定して処理を行うものがあった。 20

【0003】

例えば特願昭62-127042では結石を把持して超音波振動により破碎する様になっており、特願平1-232944では生体組織を把持鉗子で把持して固定し、超音波振動するプローブで切開する様になっていた。又、特願平1-232945では生体組織を吸着させて固定し、超音波振動するメスにより切開する様になっていた。

【0004】

更に特願平1-232948では切除鉗子に超音波振動を加える事により生体組織の切除を効率的に行える様になっており、特願平1-232949では特願平1-232944と同様に把持手段により生体組織を固定し、超音波振動を加えた処置部材により生体組織に処置を加える様になっており、USP5,322,055ではプローブの上部に把持部材を設け、プローブと把持部材により生体組織を固定して処置を行う様になっていた。これらは通常の外科鉗子の様に生体組織を把持して処置が行えるので、一般にプローブ単体で処置を行う場合よりも良好な処置が行い易かった。 30

【0005】

又、USP4,988,334や特願平2-203573等の様に一般に超音波吸引装置と呼ばれるものには、シースがハンドピースに対して分解及び組立可能となっているものもあったが、前述の様な把持部材を有するものの中にはこの様なものは無く、特に分解及び組立が出来るものは無かった為、洗浄及び滅菌工程時には細心の注意を持って各部を洗浄及び滅菌する必要がある、非常に手間が掛かっていた。或いはこの手間を省くために使い捨てとする場合もあったが、医療量削減や汚染された廃棄物の削減、資源の節約といった点に問題があった。 40

【0006】

又、どこか一部でも破損すると全体を修理するか交換する必要があるがあった。更には各部を何種類か用意しておき、処置に最適な組み合わせで使用する事も出来ず、必要な種類だけ超音波処置具を用意する必要があるがあった。

【0007】

この様に超音波処置具で生体組織を把持出来る手段の備わっているものについては、取り扱う者の人手や時間あるいは費用の問題があり、その負担は結果的に医療費の高騰原因の一つともなる可能性があった。

【 0 0 0 8 】

又、従来、内視鏡下外科手術において使用される処置具は一般的に生体組織に対して処置を行う処置部が、処置部を生体内に挿入する為の挿入部であるシースの遠位端に設けられており、挿入部の近位端に処置部を操作する為の操作手段が設けられていた。

【 0 0 0 9 】

これらの内視鏡下外科手術用の処置具において、D E 7 3 3 0 2 9 1 や特願平 6 - 1 7 9 0 4 9 の様に挿入部、処置部、操作部等に各部を分解及び組立可能としたものが知られている。そしてこの構造により洗浄及び滅菌工程においては、より確実な各部の洗浄及び滅菌が可能となる他、例えば処置部のみが破損した場合等にその部分だけを交換出来る、あるいは各部をそれぞれ何種類か用意しておく事により、色々な部品を組み合わせで処置に最適な処置具を用意出来る等のメリットがある為に、前述の様な問題点がある程度解決してはいた。

10

【 0 0 1 0 】

しかし、この様な処置具は一般に生体組織を切開、凝固する際に高周波電流のみを用いる事が出来た。ところが高周波電流は生体組織のタンパク変性する範囲が広いので場合によっては過剰な処置を行ってしまう原因ともなっており、出来れば超音波振動と併用し状況に応じて使い分ける事が望ましかったが、この様な処置具単体では不可能であった。

【 発明の開示 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 1 1 】

前述の様な超音波処置具において把持部材を有するものには特に分解及び組立が出来るものは無かった為、洗浄及び滅菌工程時には細心の注意を持って各部を洗浄及び滅菌する必要がある、非常に手間が掛かっていた。或いはこの手間を省くために使い捨てとする場合もあったが、医療量削減や汚染された廃棄物の削減、資源の節約といった点に問題があった。

20

【 0 0 1 2 】

又、どこか一部でも破損すると全体を修理するか交換する必要があった。更には各部を何種類か用意しておき、処置に最適な組み合わせで使用する事も出来ず、必要な種類だけ超音波処置具を用意する必要があった。

その為に取り扱う者の人手や時間あるいは費用の問題があり、その負担は結果的に医療費の高騰原因の一つともなる可能性があった。

30

【 0 0 1 3 】

また、把持部材等を用いて生体組織を把持する等の処置を行う際、よりの確に生体組織に対して処置を施すことが望まれている。

【 0 0 1 4 】

本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、よりの確に生体組織に対して処置を施すことを可能とする超音波切開凝固装置を提供することを目的とする。

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 1 5 】

本発明の超音波切開凝固装置は、超音波振動を発生する超音波振動子と、前記超音波振動子に接続され、前記超音波振動を生体組織に対して処置を行う為の処置部へ伝達する振動伝達部材としてのプローブと、前記プローブ遠位端部との間に生体組織を把持する把持部材と、前記プローブ遠位端部と前記把持部材とにより生体組織を把持及び開放する為の操作を行う操作手段と、を有する超音波切開凝固装置において、前記プローブ遠位端部は、前記把持部材との間で生体組織を把持可能とするとともに、遠位側に向けて細径化する形状を呈することを特徴とする。

40

【 発明の効果 】

【 0 0 1 6 】

本発明によれば、よりの確に生体組織に対して処置を施すことを可能とする超音波切開凝固装置を提供することができる。

50

【発明を実施するための最良の形態】

【0017】

(第1実施例)

図1～図9は本発明の第1実施例に係り、図1は本発明の第1実施例の全体図、図2は処置部と挿入部の構造を示す断面図、図3は図2のD1-D2-D3-D4線断面図、図4は図2の正面から見た処置部の正面図、図5は図2のA-A'～G-G'線断面図、図6は操作手段を示す平面図、図7は操作手段及びその一部を拡大して示す部分断面図、図8は図7(A)のH-H'線及びI-I'線断面図、図9は図7(A)のJ-J'～M-M'線断面図である。

【0018】

10

図1に示すように本発明の第1実施例の超音波切開凝固装置31は遠位端(先端)に処置を行う処置部33を設けた挿入部57と、この挿入部57の近位端(後端)に形成され、処置部33を操作する操作手段34とを有する。この挿入部57は生体内に挿入できるように細長のシース9で挿入部外套管が形成されている。

【0019】

操作手段34の上部の近位端側には、前記シース9よりも太い径のシース22が設けられ、このシース22の近位端に処置部33に対し、切開及び凝固の処置の為の超音波振動を供給する超音波振動子50(図7参照)を内蔵した振動子ユニットとしてのハンドピース32が設けてある。

【0020】

20

図2に示すように挿入部57を構成するシース9は、このシース9で保護された例えば上下に2つ独立した管路を有し、その上部側の管路内には切開及び凝固の処置を行う処置具としての鉗子ユニット58が挿通され、下部側の管路内にはハンドピース32内の超音波振動子50からの超音波振動を伝達する振動伝達部材としてのプローブ8と、このプローブ8の遠位端に螺合により着脱自在に取り付けた先端部材7とが挿通されている。

処置部33及び挿入部57は図2～図5に示す様な構造になっている。

【0021】

鉗子ユニット58はパイプ状の外管部材内に、操作手段34による操作力を伝達する進退自在な略円柱形状の可動部材を挿通し、さらにプローブ8の遠位端に設けた先端部材7との間で生体組織を把持したり開放したりする把持部材1が、鉗子ユニット58の遠位端の可動部3にネジ2により接合されている。つまり、図4に示すように把持部材1の下端と先端部材7の上端とは略平面状であり、両平面で生体組織を把持及び開放できるようにしている。

30

なお、図3に示すように把持部材1の下端側の面には横方向に延びる横溝を設けて組織を確実に把持して凝固易くする凝固溝61が形成されている。

【0022】

図2及び図3に示すように上記可動部3は鉗子ユニット58の伝達部材としての第1の伝達部材5の遠位端側にピン35を中心に回転自在に支持され、かつ長孔に係入したピン36の進退移動によりピン35を中心として回転される。

【0023】

40

この第1の伝達部材5の近位端側には連結部材41が螺着されており、この連結部材41には第2の伝達部材10の遠位端が螺着されており、さらにこの第2の伝達部材10の近位端側は挿入部57を形成するシース9の近位端から近位側(後方)に突出し、この突出する近位端には係合部材42の遠位端が螺着により接続されている。つまり、鉗子ユニット58を構成する第1の伝達部材5は螺着によりその近位側の伝達部材10及びさらにその近位側の係合部材42と(分解及び組立可能に)連結されている。

【0024】

この係合部材42の近位端には球状部43が形成されており、この球状部43は図1及び図7に示す操作手段34を構成する可動操作ハンドル30の上部側の係止機構で挿入部57の軸方向に進退移動可能に保持され、可動操作ハンドル30の開閉操作により係合部

50

材 4 2、第 2 の伝達部材 1 0 及び第 1 の伝達部材 5 が進退駆動され、前述の様に可動部 3 を開閉させる事が出来る。

【 0 0 2 5 】

鉗子ユニット 5 8 の外管側部材を形成するシース 1 1 はその外側のシース 1 0 と共に、その近位端はノブ 1 2 の内側の位置で結合部材 1 3 を介してパイプ 1 4 と結合（連結）され、このパイプ 1 4 は操作手段 3 4 における固定側操作部材となる固定操作ハンドル 2 9 に取付られる。

【 0 0 2 6 】

把持部材 1、ネジ 2 は後述する様に先端部材 7 に高周波電流を流して処置を行う場合には樹脂材等の絶縁材料で成形されるが、その他の場合には金属等で成形しても良い。

10

【 0 0 2 7 】

図 2 及び図 3 に示すようにシース 9 における鉗子ユニット 5 8 が挿通される上部側の管路には略円筒形状の嚙合部材 3 7 が挿通され、この嚙合部材 3 7 の近位よりの内周面には半径内側に突出する突起部 3 9（図 2、図 3、図 5（F）参照）が設けてあり、この突起部 3 9 には先端カバー 6 の近位端に設けられているスナップフィット 3 8 により係合し、この先端カバー 6 のスナップフィット 3 8 を突起部 3 9 を越えて近位側に押し込むことにより両者を係合状態にして鉗子ユニット 5 8 をシース 9 内に固定（ロック）できるようにしている。そして、鉗子ユニット 5 8 をシース 9 の遠位側に強く引っ張る操作を行うことにより両者の係合を解いて分解、つまり鉗子ユニット 5 8 をシース 9 から取り外す事ができるようにしている。

20

【 0 0 2 8 】

この時、把持部材 1 が少しでも開放されていると、それにより連結部材 4 1 の位置が前進して連結部材 4 1 の遠位端がスナップフィット 3 8 内部に進入するようにしている。そして、この侵入の為にスナップフィット 3 8 が内周方向に撓む事が出来ずに鉗子ユニット 5 8 をシース 9 から取り外す事が出来ない様になっている。

【 0 0 2 9 】

即ち、鉗子ユニット 5 8 側を取り外す際には把持部材 1 が先端部材 7 に対して完全に閉鎖している必要があるので、実際の使用時に生体組織を把持している場合等のように完全の閉鎖状態に無い場合には鉗子ユニット 5 8 が脱落してしまう危険性が無く、安全性を確保して鉗子ユニット 5 8 をシース 9 から分解及び組立可能な構造にしている。

30

【 0 0 3 0 】

又、この際、嚙合部材 3 7 と先端カバー 6 との嵌合する部分を回転対称でない構造（例えば、先端カバー 6 の外周面に、嚙合部材 3 7 が嵌合するように形成する段差面の遠位端の位置が周方向で異なるように形成する）にした回転防止機構 4 0（図 2、図 3、図 5（F）参照）により、鉗子ユニット 5 8 がシース 9 に対して回転する事を防止し、生体組織を把持した場合等において不用意に回転して操作性が低下するのを解消している。

嚙合部材 3 7 の近位端はシース 9 の内側に介装されるシース 1 1 と連結されている。

【 0 0 3 1 】

シース 9 の下部の管路には先端部材 7 と、この先端部材 7 の近位端に螺着されて超音波振動子 5 0 からの超音波振動を先端部材 7 に伝達するプローブ 8 が挿入されている。先端部材 7 の遠位端は上部側が図 5（A）の様に平面となっており、把持部材 1 との間で生体組織を把持しやすい様になっている。この先端部材 7 の上部側の平面は図 2 及び図 5（B）、図 5（C）に示すように把持部材 1 よりも近位側にまで形成され、それより近位側の断面形状は図 5（D）～図 5（F）に示すように円形である。

40

【 0 0 3 2 】

又、先端部材 7 の遠位端頂点は略錐状に成形されており、把持部材 1 よりも遠位側に突出しており、この部分で剥離操作を行う事が出来る。先端部材 7 はプローブ 8 の先端に対して螺合により着脱自在となっており、把持部材 1 も可動部 3 に対してネジ 2 により脱着自在となっているので、それぞれを自由に交換して処置に最適な形状の先端部材 7 と把持部材 1 を使用する事が出来る。

50

【 0 0 3 3 】

図 2 に示すようにシース 9 の下部管路の遠位側開口部には、P T F E やセラミック等の耐熱性と超音波振動に対する耐性のある保護部材 4 が設けられており、これにより生体組織を把持した際に先端部材 7 に下方への曲げ反応が発生した場合等に、先端部材 7 とシース 9 が接触して破損する事を防止している。

【 0 0 3 4 】

図 6 ~ 図 9 に操作手段 3 4 を示す。操作手段 3 4 は挿入部 5 7 の近位端に設けられており、シース 9 と結合部材 1 3 が接合されている。その結合部材 1 3 の外周にパイプ 1 4 の遠位端が接合されており、このパイプ 1 4 の遠位端外周にノブ 1 2 が嵌合し、ネジ 4 4 により結合（固定）されている。

10

【 0 0 3 5 】

このネジ 4 4 を緩めるとノブ 1 2 はシース 9 の遠位端側に外すことができ、後述するようにシース 9 側（シース 9、パイプ 1 4、シース 2 2）を操作手段 3 4 に対して分解でき、また組立することも可能な構成にしている。

【 0 0 3 6 】

このパイプ 1 4 は固定操作ハンドル 2 9 の前後に分岐した上部にそれぞれ接合されている第 1 の軸受け 1 5 及び第 2 の軸受け 1 9 の内部を貫通しており、固定操作ハンドル 2 9 に固定される第 1 の軸受け 1 5 及び第 2 の軸受け 1 9 に対してパイプ 1 4 は回転自在に支持され、またパイプ 1 4 外周面と第 1 の軸受け 1 5 及び第 2 の軸受け 1 9 の内周面との少なくとも周方向に（この実施例では前後方向にも）摺動自在の摺動面にはリング 4 5 と 2 つのリング 4 7 が設けられており、パイプ 1 4 と軸受け 1 5 及び軸受け 1 9 との回転力を調節可能にしている。

20

【 0 0 3 7 】

従って、ノブ 1 2 をつかんで回転する操作を行うと、ノブ 1 2 と共にパイプ 1 4 は第 1 の軸受け 1 5 及び第 2 の軸受け 1 9 に対して回転する。このパイプ 1 4 の中心軸に沿ってプローブ 8 が挿通され、この中心軸から偏心して鉗子ユニット 5 8 がシース 9 内に挿通されているので、鉗子ユニット 5 8 はプローブ 8 の中心軸（この中心軸は超音波振動子 5 0 の中心軸と一致する）の回りで回転されるようになる。

【 0 0 3 8 】

なお、図 7 等から分かるようにシース 9 の中心軸はプローブ 8 の中心軸とずれているので、ノブ 1 2 を回転した場合にはパイプ 1 4 の回転に連動して（遠位端に処置部 3 3 を設けた）挿入部 5 7（或いはシース 9 側）は偏心して回転されることになる。

30

【 0 0 3 9 】

円筒形状のパイプ 1 4 内には図 8（A）、（B）にも示すように同軸となるようにその中心軸に沿ってプローブ 8 が挿通され、このプローブ 8 の近位端は円筒状のシース 2 2 に対し嵌合する円筒形外周面を有する摺動自在のハンドピース 3 2 内部に設けた超音波を発生する超音波振動子 5 0 の振動駆動軸に例えば螺合による着脱自在（分解及び組立自在）の連結部材を介して連結されている。

【 0 0 4 0 】

また、このパイプ 1 4 は第 1 の軸受け 1 5 及び第 2 の軸受け 1 9 の間の部分では図 6 に示すように上下方向に貫通し前後方向に長い楕円形状の溝 5 5 が形成され、この溝 5 5 にはその上下方向から略半円板形状の駆動部材 1 6、1 7（図 7、図 8（B）参照）が前後方向に移動自在に係入され、図 8（B）で示すようにネジ 5 3 で互いに結合される。これら両駆動部材 1 6、1 7 は係合部材 4 2 を進退駆動させ、前述の様に伝達部材 1 0、5 の進退駆動により把持部材 1 を開閉動作させる様になっている。

40

【 0 0 4 1 】

そして、パイプ 1 4 の途中まで偏心して挿通された係合部材 4 2 はその近位端の球状部 4 3 が可動操作ハンドル 3 0 の上部に取り付けた一方の駆動部材 1 6 の半径方向に設けた係合溝内に係入されて係止されている。

【 0 0 4 2 】

50

パイプ１４の近位側には結合部材２０が両者を（分解及び組立可能に）結合するネジ４６により接合されており、この結合部材２０の近位側外周にはハンドピース３２が嵌入されたシース２２がネジ４９により接合されている。このシース２２の近位側の外周面にネジ部が設けてあり、そのネジ部に螺合するようにリング２３が取り付けられている。

【００４３】

そしてこのリング２３の内周面にはバックアップリング２４とＯリング５９が収納されており、リング２３を操作部シース２２に対して締結方向に回動させる事により、Ｏリング５９が圧縮され、ハンドピース３２外周を圧迫し、ハンドピース３２をシース２２対して固定する事が出来る。

【００４４】

又、この構造によりリング２３を解放方向に回動させる事によりハンドピース３２をシース２２に対して進退自在と出来るので、ハンドピース３２を進退させる事により先端部材７の処置部３３における突出量を調節出来るようにして、対象組織に対して処置に適した突出量に設定して処置を行ったり、先端部材７を交換して実際に使用する先端部材７の場合に対して処置に適した突出量に設定する等の調節を行うことができるようにしている。

【００４５】

ハンドピース３２には先端側に延出されるガイドシース２１が設けてあり、このガイドシース２１の遠位側外周にはＯリング４８が設けられており、結合部材２０と密閉構造となっている。

【００４６】

又、結合部材１３と結合部材２０の間のプローブ８が貫通している管路を外部と遮断する為に結合部材１３と結合部材２０の間をパイプ１８によって連結し、密閉された管路を構築している。

【００４７】

ここで後述する様にプローブ８に高周波電流を流して処置を行う場合にはシース９、結合部材１３、結合部材２０、パイプ１８、ガイドシース２１をＰＴＦＥ、ポリサルフォン等の絶縁材料で成形すると高周波電流が漏れる心配が無く安全である。

【００４８】

この構造により、鉗子ユニット５８とプローブ８は完全に絶縁されているので、鉗子ユニット５８に接続するコネクタを設ける、あるいは直接高周波電流を流す等すれば、例えば可動部３と先端部材７に選択的に高周波電流を流して生体組織を処置したり、両者に高周波電流を流して処置したり、あるいは両者にわたり、生体組織を通して高周波電流を流すことにより、バイポーラにして処置を行うことも出来る。

【００４９】

この様な場合は駆動部材１６、駆動部材１７、固定操作ハンドル２９、可動操作ハンドル３０、係合部材４２、軸受け１５、軸受け１９、シース２２、リング２３の露出している面を例えばＰＴＥ材等の電気絶縁材で塗装する等して術者に高周波電流が漏れない様にすると良い。

【００５０】

又、プローブ８が挿通される管路及びこのプローブ８の近位側の管路は密閉された管路が形成しているので、ハンドピース３２の近位端に設けられている送水／吸引口金５１に接続された図示しない送水／吸引装置により、この管路を利用してプローブ８の周囲の空隙部分を利用して送水或いは吸引等、流体を流すことが可能な流路（通路）が形成されるようになっており、例えば切開などの処置の際に流れ出た血液を吸引して外部に排出することができるようにしている。

【００５１】

また、ハンドピース３２の近位端にはコード５２の接続部が形成されており、コード５２を介して超音波振動子５０に対し超音波振動させる駆動電源を（図示しない超音波駆動電源装置から）供給するようにしている。

10

20

30

40

50

【 0 0 5 2 】

前述の様にシース 9 の上部側管路を貫通している伝達部材 1 0 の近位側には係合部材 4 2 が螺着されており、この係合部材 4 2 の近位端には球状部 4 3 が形成され、図 8 (B) に示す様に球状部 4 3 が駆動部材 1 6 の係合溝に噛合している。

【 0 0 5 3 】

駆動部材 1 6 及び 1 7 の外周面には周方向に係合溝 5 6 が設けてあり、その係合溝 5 6 に駆動ピン 2 5 が左右から係入している。従って、駆動ピン 2 5 が前後に移動すると駆動部材 1 6 及び 1 7 も前後に移動する。各駆動ピン 2 5 は半円状の駆動部材 2 6 の両端で支持されており、駆動部材 2 6 の下端はネジ 5 4 により可動操作ハンドル 3 0 の上端に結合している。

10

また、可動操作ハンドル 3 0 と固定操作ハンドル 2 9 とはネジ 2 7 と 2 8 とにより、可動操作ハンドル 3 0 を回転自在に保持している。

【 0 0 5 4 】

従って、可動操作ハンドル 3 0 を固定操作ハンドル 2 9 に対して前後に移動する操作を行うことにより、駆動ピン 2 5、駆動部材 1 6 及び 1 7 を介して球状部 4 3 を前後に移動し、鉗子ユニット 5 8 の把持部材 1 を開閉することができるようになっている。

【 0 0 5 5 】

つまり、可動操作ハンドル 3 0 の下端側の指掛けを開閉操作すると、ネジ 2 7 を支点として駆動部材 2 6 が進退移動し、それにより駆動ピン 2 5 が進退駆動される。そして駆動ピン 2 5 の進退駆動により駆動部材 1 6、駆動部材 1 7 が進退駆動され、係合部材 1 3 と共に伝達部材 1 0、連結部材 4 1、伝達部材 5 が進退駆動し、前述の様に可動部 3 が開閉する事で把持部材 1 が開閉動作する様になっている。

20

【 0 0 5 6 】

また、ノブ 1 2 を操作手段 3 4 に対して回転させる事でハンドピース 3 2 も連動して回転し、結果的に操作手段 3 4 に対して処置部 3 3 を回転させる事が出来る構造にして、生体組織を把持する向きを変えられるようにして処置する際の操作性を向上している。

【 0 0 5 7 】

つまり、前述の様な処置部 3 3 の回転操作をする際に、駆動部材 1 6、駆動部材 1 7 も同時に回転するが、外周が円形であり駆動ピン 2 5 とは円形の係合溝 5 6 によって係合しているので操作手段 3 4 に対して 3 6 0 ° 問題なく回転出来る様になっている。

30

【 0 0 5 8 】

次に本実施例の実際の使用方法について述べる。

まず本超音波切開凝固装置 3 1 を処置を行おうとする生体組織に対向させ、ノブ 1 2 を回転させる事により処置部 3 3 の向きを処置を行いやすい向きに合わせる。この際に、前述した様にリング 4 5、リング 4 7 により回転力量を適切な力量に調節する事が出来るので、回転が必要な時にはノブ 1 2 を回転出来、不用意には回転出来ない程度の力量とする事が出来る。

【 0 0 5 9 】

そして可動操作ハンドル 3 0 を開方向に操作し、把持部材 1 を開放する。目的の生体組織を把持部材 1 と先端部材 7 の間に挟み、可動操作ハンドル 3 0 を閉鎖して把持部材 1 と先端部材 7 により生体組織を把持する。

40

【 0 0 6 0 】

そこで図示しないフットスイッチ等の操作により超音波振動子 5 0 の駆動電源から駆動電力を超音波振動子 5 0 に供給し、超音波振動子 5 0 を励振させる。そしてこの超音波振動がプローブ 8 から先端部材 7 に伝達され、この先端部材 7 から把持された生体組織に与えられ、摩擦熱により把持された生体組織を高温にして切開とか凝固の処置を行うことができる。この際に、生体組織に超音波振動を与える時間や振幅、生体組織を把持する力量を調節する事により、生体組織を切開したり凝固し易くする事が出来る。

【 0 0 6 1 】

例えば時間を長く、振幅を大きく、把持力量を強くすると切開に都合が良く、その逆の

50

ファクタにすると凝固に都合が良い設定となる。

又、只単に生体組織を把持する場合等は前述の様に先端部材 7 と把持部材 1 で生体組織を把持する事も出来る。

【 0 0 6 2 】

また、生体組織の剥離操作を行う場合には把持部材 1 を閉鎖状態にするか、あるいは開放状態にして先端部材 7 遠位端の略錐形状の部分を用いて鈍的に剥離操作を行うか、前述の様に超音波振動を加えて剥離操作を行う事も出来る。

更には先端部材 7 単体を生体組織に押しつけて超音波振動を加える事により、生体組織の切開、凝固操作を行う事も出来る。

【 0 0 6 3 】

又、高周波電流による処置が必要な場合には図示しない高周波電源よりハンドピース 3 2 に高周波電流を供給し、超音波振動子 5 0 を経由してハンドピース 3 2 から先端部材 7 へと高周波電流を供給する。

【 0 0 6 4 】

これにより先端部材 7 から高周波電流を生体組織に与え、前述の超音波振動を用いた場合と同様に高周波電流により生体組織の剥離、切開、凝固を行う事が出来る。この際、前述の様にプローブ 8 と鉗子ユニット 5 8 の管路が完全に絶縁されており、更に把持部材 1 が絶縁部材で成形されているので、高周波電流の漏れが無く安全に効率良く高周波電流による処置を行う事が出来る。

又、必要があれば超音波振動による処置と高周波電流による処置を併用しても構わない。

【 0 0 6 5 】

次に本実施例の分解及び組立方法について述べる。

まず組立られた状態の図 1 に示す超音波切開凝固装置 3 1 に対し、可動操作ハンドル 3 0 の上部の両駆動部材 1 6 及び 1 7 を結合する 2 つのネジ 5 3 を取り外し、駆動部材 1 6 及び駆動部材 1 7 をパイプ 1 4 から上下に取り外し、球状部 4 3 を駆動部材 1 6 の係合溝による係合から開放する。これにより鉗子ユニット 5 8 側の近位端側を開放状態にできる。

【 0 0 6 6 】

次に把持部材 1 を先端部材 7 に対して完全に閉鎖する状態に設定して把持部材 1 をシース 9 に対して遠位方向に引き抜く。この引き抜く操作により、スナップフィット 3 8 は内周方向に撓んで突起部 3 9 を乗り越えるので鉗子ユニット 5 8 をシース 9 から分解できる。

【 0 0 6 7 】

続いてシース 2 2 の近位端に配置したリング 2 3 を開放方向に回転させ、ハンドピース 3 2 とシース 2 2 の結合を緩めてハンドピース 3 2 を操作手段 3 4 の後方側に引き抜く。この引き抜く操作でハンドピース 3 2 をプローブ 8 と共に、挿入部 5 7 及び操作手段 3 4 から後方側に外すことができる。

【 0 0 6 8 】

その後、プローブ 8 をハンドピース 3 2 に対して回転させて両者の螺合を解除し、プローブ 8 をハンドピース 3 2 より取り外す。その後、同様に螺合を解除する操作を行うことにより先端部材 7 をプローブ 8 から取り外すことができる。

【 0 0 6 9 】

挿入部 5 7 と操作手段 3 4 の分解は、ノブ 1 2 に設けたネジ 4 4 をノブ 1 2 から取り外し、ノブ 1 2 をシース 9 の遠位端側から取り外す。続いて操作手段 3 4 からシース 9、パイプ 1 4、シース 2 2 等が一体となったものを操作手段 3 4 の後方側に引き抜く事で、駆動部材 2 6、可動操作ハンドル 3 0 及び固定操作ハンドル 2 9 側から取り外す。

【 0 0 7 0 】

これらの一連の動作により超音波切開凝固装置 3 1 は各部が十分に洗浄及び滅菌可能な状態となるが、更に駆動部材 2 6 と可動操作ハンドル 3 0 とを結合するネジ 5 4 を取り外

10

20

30

40

50

すことにより、駆動部材 26 と可動操作ハンドル 30 を分解できる。

【0071】

また、ネジ 27、ネジ 28 を分解する事により固定操作ハンドル 29 と可動操作ハンドル 30 を分解する事も出来る。又、ガイドシース 21 とハンドピース 32 も螺合を解除する事により分解可能である。

【0072】

このように分解した各部材を洗浄び滅菌等を行い、洗浄び滅菌等が終了して再度組立する場合には前述の分解の逆の順番で組立を行えば超音波切開凝固装置 31 の組立が行える。

又、この様に分解及び組立が出来る構造にしてあるので、分解により各部を手間をかけないで十分或いは確実に洗浄及び滅菌が可能であると共に、万一、一部の部材が破損した場合等にはその破損した部品のみを交換出来き、経済的に継続して使用できる様になっている。

【0073】

さらに、鉗子ユニット 58 は、スナップフィット 38 によりシース 9 に取り付けられているので、鉗子ユニット 58 部分を交換するなどして処置に適した形状或いはサイズなどが異なる他の鉗子ユニット 58 を使用して処置を行うことができるし、プローブ 8 側でもその先端部材 7 が着脱自在（分解及び組立自在）であるので、形状或いはサイズなどが異なる他の先端部材 7 を使用して処置を行うことができる。

【0074】

（第 2 実施例）

図 10（A）及び図 10（B）に本発明の第 2 実施例の主要部を示す。

本実施例は第 1 実施例とほぼ同様な構成であるが、主に生体組織の切開を目的としており把持部材 1 が設けられていない。その代わりに可動部 3 の遠位端と先端部材 7 により鉗が形成されており、生体組織の切開を効率良く、かつ安全に行える様になっている。

【0075】

その他の構成は第 1 実施例と同様である。この実施例では可動部 3 の遠位端と先端部材 7 の先端を切開しようとする生体組織に押し当てて可動部 3 を開いた状態から閉じる方向に可動させることにより、挟部分に接触する生体組織に超音波振動を印加して生体組織を切除できる。

【0076】

つまり、第 1 実施例の把持して切開及び凝固（の少なくとも一方を）する機能の代わりに、挟みで挟んで切除（或いは切開）する機能である。また、図 10 では示していないノブ 12 を操作して処置部 33 をプローブ 8 の中心軸（つまり超音波振動子 50 の中心軸）の回りで回転することができることは第 1 実施例と同様である。

また、第 1 実施例と同様に分解及び組立ができるので、分解して洗浄及び滅菌等を行う等が可能である。この実施例の効果は第 1 実施例とほぼ同じである。

【0077】

（第 3 実施例）

図 11（A）及び図 11（B）は本発明の第 3 実施例の主要部を示す。

本実施例は第 1 実施例とほぼ同様な構成であるが、可動部 3 の把持部材 1 と先端カバー 6 に挟まれた部分の先端部材 7 と対向する面に切開面 62 が形成されている。

【0078】

その為に把持部材 1 と先端部材 7 で生体組織を把持し、凝固面 61 を用いて生体組織を凝固すると共に、凝固面 61 の近位側の幅を細くして切開面 62 を形成し、この切開面 62 と先端部材 7 とで把持する細い幅の生体組織の切開を行える様にしている。その他は第 1 実施例と同様の構成である。

【0079】

この構成れにより例えば凝固しながら切開を行う場合では、生体組織の端部から順番に把持して超音波振動を加える事により、切開する部分は必ず事前に凝固される様になるの

10

20

30

40

50

で、出血する可能性を低くでき、非常に安全な切開を行う事が出来る。

その他の作用及び効果は第 1 実施例と同様である。

【 0 0 8 0 】

(第 4 実施例)

図 1 2 は本発明の第 4 実施例における主要部を示す。

本実施例は第 1 実施例とほぼ同様な構成であるが、鉗子ユニット 5 8 とシース 9 の固定方法がスナップフィット 3 8 では無く、図 2 の F - F ' 断面付近と同等な部分の断面を示している図 1 2 に示す様に、先端カバー 6 と噛合部材 3 7 により形成されている噛合ネジ部 6 3 により分解及び組立可能な構造にしている。

【 0 0 8 1 】

その他は第 1 実施例と同様な構成である。この実施例の作用は分解の際に固定を解除する操作と組立の操作が一部異なるのみで、その作用及び効果は第 1 実施例と殆ど同じである。

【 0 0 8 2 】

(第 5 実施例)

図 1 3 は本発明の第 5 実施例における主要部を示す。

本実施例は第 1 実施例とほぼ同様な構成であるが、鉗子ユニット 5 8 とシース 9 の固定方法がスナップフィット 3 8 ではなく、図 1 3 に示している様に先端カバー 6 に設けられたカムロック 6 4 と噛合部材 3 7 の突起部 3 9 (図 2、図 5 (E) 参照) により分解及び組立可能な構造となっている。

【 0 0 8 3 】

その他は第 1 実施例と同様な構成である。この実施例の作用は分解の際に固定を解除する操作と組立の操作が一部異なるのみで、その作用及び効果は第 1 実施例と殆ど同じである。

【 0 0 8 4 】

(第 6 実施例)

図 1 4 は本発明の第 6 実施例における主要部を示す。

本実施例は第 1 実施例とほぼ同様な構成であるが、鉗子ユニット 5 8 とシース 9 の固定方法がスナップフィット 3 8 では無く、図 2 の E - E ' 断面付近と同等な部分の断面を示している図 1 4 に示す様に、接合ネジ 6 5 により分解及び組立可能な構造となっている。つまりシース、噛合部材 3 7 を貫通して先端カバー 6 にはネジ孔が形成され、このネジ孔には接合ネジ 6 5 が螺着されるようになっており、この接合ネジ 6 5 により分解及び組立可能な構造にしている。なお、必要に応じて、水密を保持する O リングを介在させて接合ネジ 6 5 で螺着するようにしても良い。

【 0 0 8 5 】

その他は第 1 実施例と同様な構成である。この実施例の作用は分解の際に固定を解除する操作と組立の操作が一部異なるのみで、その作用及び効果は第 1 実施例と殆ど同じである。

【 0 0 8 6 】

(第 7 実施例)

図 1 5 (A) 及び図 1 5 (B) は本発明の第 7 実施例における回動係止の為の固定機構を示し、図 1 5 (A) はパイプ 1 4 と第 1 の軸受け 1 5 或いは第 2 の軸受け 1 9 との固定機構を示し、図 1 5 (B) はボールクリックを用いた回動係止の固定機構部分を示す。

【 0 0 8 7 】

本実施例は第 1 実施例とほぼ同様な構成であるが、軸受け 1 5 或いは軸受け 1 9 とパイプ 1 4 においてボールクリックを用いた回動係止の固定機構が設けられている。

パイプ 1 4 には内外を貫通する孔にパネ等の弾性部材 7 9 を収納し、この弾性部材 7 9 の外側に収納したボール 7 8 を弾性部材 7 9 の弾性力で外周方向に付勢している。ここでパイプ 1 4 に設けられているボール 7 8 が通る孔の外側端部での直径はボール 7 8 直径よりも小さい内径となるように設定しているので付勢されたボール 7 8 が孔から突出して脱

10

20

30

40

50

落する危険性は無い。

【0088】

このボール78と軸受け15或いは軸受け19の内周面に中心軸と平行な方向に沿って多数設けられているクリック溝80により任意の角度で操作手段34に対して処置部33を小さな角度を単位としてその角度の整数倍の任意の角度位置に回動して固定(ロック)する事が出来る様になっている。

【0089】

つまり、通常の使用状態では突出するボール78がクリック溝80に係入されてた係合状態にして回転(回動)が規制された固定状態に設定でき、この係合を解除するような回転力で回動することにより固定位置を可変設定できるようにしている。

10

【0090】

その他は第1実施例と同様な構成である。この実施例の作用は分解の際にこの固定機構を解除する操作と組立の操作が一部異なるのみで、その作用及び効果は第1実施例と殆ど同じである。

【0091】

(第8実施例)

図16及び17は本発明の第8実施例に係り、図16は操作手段34における主要部を示し、図17は図16の後方側から見た第2の軸受け19とシース22との回動係止のための固定機構を示す。

【0092】

本実施例は第1実施例とほぼ同様な構成であるが、第2の軸受け19におけるシース22に対向するリング形状の端面(図16から分かるように近位側端面)には放射状に多数のクリック溝80が形成されており、一方シース22におけるこの端面に対向する端面にはクリック爪81が例えば2箇所に設けてあり、クリック溝80とクリック爪81との係合により回動係止の為の固定機構が形成されている。又、ノブ12は弾性部材で成形されている。その他は第1実施例と同様な構成である。

20

【0093】

これらの構成により、処置部33の回動操作を行う場合にはノブ12を近位側に操作手段34に押しつける様にする。それによりノブ12が軸受け15と接触して弾性変形し、クリック爪81がクリック溝80から外れる。

30

【0094】

そこでノブ12を操作手段34に対して回動させる事により、処置部33が操作手段34に対して回動する。ここでノブ12を操作手段34に押しつける力量を解除するとクリック爪81がクリック溝80に再び噛合して回動が規制される係止状態に設定できる。

【0095】

又、クリック爪81がクリック溝80に噛合したまま、ノブ12を強制的に操作手段34に対して回動させてもクリック爪81がクリック溝80の山を乗り越える際にノブ12が前述の様に弾性変形するので、処置部33を操作手段34に対して回動させる事が出来る。その他の効果は第1実施例と同様である。

【0096】

(第9実施例)

図18~23は本発明の第9実施例に係り、図18は第9実施例の全体を示し、図19は処置部及びプローブを示し、図20(A)~(D)は図19の各部の断面を示し、図21は挿入部を示し、図22は操作手段を示し、図23(A)~(C)は図22の各部の断面を示す。

40

【0097】

第1実施例の超音波切開凝固装置31では保護部材としての機能を有するシース9内に2つの中空管路を形成し、その一方に処置部33を設けた鉗子ユニット58を通し、他方の管路に超音波振動子50からの超音波を伝達するプローブ8側を通し、鉗子ユニット58の近位端側を操作手段34の可動操作手段に係止し、この可動操作手段を操作すること

50

によりプローブ 8 の先端部材 7 に対して開閉できる構造にしたが、この実施例では保護部材としての機能を有するシース 9 は円筒状の中空管路（単一の管路）であり、このシース 9 内に略筒状のプローブ 8 を通し、このプローブ 8 内に処置部 33 の可動部材に連結した伝達部材側を挿通し、この伝達部材の近位端を、リング状の超音波振動子 50 の中空部内を後方側に延出させて可動操作手段に連結した構造にしている。

【0098】

超音波切開凝固装置 31 は図 18 に示す様に処置部 33 と、この処置部 33 を生体内に挿入する為の挿入部 57 を有し、この挿入部 57 の近位端には処置部 33 を操作する操作手段 34 が設けられている。この操作手段 34 の上部近位側には処置部 33 に処置の為の超音波振動を供給する超音波振動子 50 を内蔵したハンドピース 32 が設けられている。 10

【0099】

処置部 33 及び処置部 33 に超音波振動子 50 からの超音波振動を伝達するプローブ 8 等の構成は図 19 ~ 21 の様になっている。処置部 33 はプローブ 8 遠位端に螺合され、超音波振動により生体組織に処置を行う先端部材 7 が設けられている。

【0100】

先端部材 7 の遠位端は鉗子状に成形されており、中央部から近位端には可動部 3 を挟み込む先端カバー 6 が形成されている。可動部 3 と先端部材 7 の遠位端は互いに噛み合い、組織を把持したり開放する鉗子としての機能を有する様になっている。

【0101】

本実施例では通常、剥離鉗子と呼ばれる遠位端が細く剥離操作に有効な形状になっているが、この形状は例えば第 2 実施例の様に鉗形状にしたり、第 3 実施例の可動部 3 の様な形状としても良く、その形状に制限は特にない。 20

【0102】

又、可動部 3 はピン 35 により先端カバー 6 に回転自在に支持されており、ピン 36 により伝達部材 5 と連結されている。又、伝達部材 10 は伝達部材 5 の近位端に螺合されている。

【0103】

先端カバー 6 の近位側とプローブ 8 は中空に形成されており、第 1 の伝達部材 5、第 2 の伝達部材 10 がその内部を貫通している。第 2 の伝達部材 10 の外周面には P T F E 材等の耐熱性と超音波振動吸収性のある材料で形成されているチューブ 66 で被覆しており、超音波振動がプローブ 8 に加えられた場合に、プローブ 8 と伝達部材 10 が接触する事で金属音が発生したり接触部が発熱する、あるいは破損する等の危険を防止している。 30

【0104】

第 1 実施例と同様に伝達部材 10 の近位端には係合部材 42 が螺合により連結されており、この係合部材 42 の近位端には球状部 43 が形成されている。この係合部材 42 が可動操作ハンドル 30 の開閉操作により進退駆動され、伝達部材 5 が進退駆動される事によりピン 36 を通じて可動部 3 に力量が伝達され、可動部 3 が先端部材 7 に対して開閉駆動される。

【0105】

又、係合部材 42 の外周面には後述する高周波電流を用いた処置の際に術者の手等に高周波電流が漏れる危険を防止する為に、P T F E 材等の電気絶縁性を有する材料で形成されたチューブ 67 で被覆している。 40

プローブ 8 は例えば 3 つの部品から形成されており、図 19 (A) の Q, R に示されている部分で T i g 溶接等により連結して組立てられている。

【0106】

図 20 (A) に示すように可動部 3 を回転自在に支持するピン 35 は先端カバー 6 にカシメあるいはレーザ溶接等で固定されているので、先端カバー 6 と一体となっており、前述の様に先端カバー 6 に超音波振動が伝達されると、ピン 35 を経由して可動部 3 にも超音波振動が伝達される様になっている。

【0107】

以上の様な構造となっている処置部 33 とプローブ 8 が後述する挿入部 57 内に挿入され、操作手段 34 のハンドピース 32 の超音波振動子 50 に連結される。

【0108】

挿入部 57 は図 21 に示す様な構成をしており、複数の部品により構成されるシース 9 の遠位端にシース 9 と前述の先端カバー 6 や先端部材 7 が接触する事により、金属音が発生したり発熱する、あるいは両者が破損する等の危険を防止する為に P T F E 材やセラミック等の耐熱性と超音波振動に耐性のある材料で形成されている保護部材 4 が設けられている。

【0109】

シース 9 の近位端外周には O リング 68 と C リング 69 が設けられており、後述するネジリング 82 に水密で接続される。本実施例ではシース 9 とネジリング 82 の接続が C リング 69 による脱着となっているが、例えば第 1 実施例のスナップフィット 38 と突起部 39 による構造や、第 4 実施例の様な接合ネジ部 63 による接続機構あるいは、第 5 実施例の様なカムロック 64 によるもの、第 8 実施例の様な接合ネジ 65 による方法でも良く、特に接続方法に制限はない。

【0110】

次に操作手段 34 について述べる。図 22 に示すように操作手段 34 は支持部材 72 上部の遠位側に第 1 の軸受け 15 がネジ 71 により接合されており、中央上部付近で第 2 の軸受け 19 がネジ 73 により接合されている。

【0111】

第 1 の軸受け 15 の遠位側にはネジリング 82 が挿入されており、この軸受け 15 を挟んでハンドピース 32 と螺合されている。そしてネジリング 82 はハンドピース 32 と共に、第 1 の軸受け 15 に回転自在になっており、O リング 45 により水密が保たれている。

【0112】

又、ネジリング 82 の遠位側には前述のシース 9 が C リング 69 により接合されており、第 1 の軸受け 15 とは回転自在に O リング 68 等の水密手段により水密状態が保たれている。この実施例では、第 1 の軸受け 15 の上部には送水 / 吸引口金 51 が設けられており、この送水 / 吸引口金 51 に図示しない送水 / 吸引手段を接続する事により、第 1 の軸受け 15 からシース 9 を経由する管路を用いて送水或いは吸引を行う事が出来る。

【0113】

ハンドピース 32 の近位側は第 2 の軸受け 19 内に挿通されており、O リング 47 により支持されている。ハンドピース 32 は前述の O リング 45 と O リング 47 により、回転が必要な場合には回転させる事が可能であり、不用意に回転しない適度な回転抵抗を持って操作手段 34 に対して回転自在となっている。

【0114】

この回転係止の固定機構は O リング 47 以外に例えば第 7 実施例の様なボールクリック機構や第 8 実施例の様なクリック機構を用いたものでもよい。

【0115】

ハンドピース 32 内部には前述の様に生体組織に処置を行う為の超音波振動を供給する超音波振動子 50 がリング状に設けられており、この超音波振動子 50 で発生した超音波振動の駆動軸（振動軸）の遠位端には前述のプローブ 8 の近位端が螺着により連結されている。

【0116】

このプローブ 8 内部には前述の第 2 の伝達部材 10 が挿通されており、超音波振動子 50 内部の管路を通じてハンドピース 32 の近位端の後方側に突出している。

この際、ハンドピース 32 の近位端側に延びるこの伝達部材 10 が挿通されている管路を通じて気腹ガス等が漏洩する事を防止する目的で、この管路と第 2 の伝達部材 10 の近位端付近には略チューブ状の気密部材 74 が設けられており、この気密部材 74 は例えばゴム等の弾性部材や P T F E 材等のシール部材で成形されている。

10

20

30

40

50

【 0 1 1 7 】

第 2 の伝達部材 1 0 の近位端には係合部材 4 2 が螺着で連結されており、この係合部材 4 2 の外周には後述する高周波電流による処置の際に、高周波電流が漏電する事を防止する為に P T F E 材等の電気絶縁性のある材質で形成されたチューブ 6 7 で被覆されている。

【 0 1 1 8 】

この係合部材 4 2 の近位端には球状部 4 3 が設けられており、図 2 3 (A) に示す様に可動操作ハンドル 3 0 上部に挿入されている係合受け部材 7 5 に噛合している。この係合受け部材 7 5 は図 2 3 (A) , 図 2 3 (B) に示す様に上下方向に溝状となっており、この溝内を球状部 4 3 が摺動する事が出来る様になっている。

10

【 0 1 1 9 】

ここで係合受け部材 7 5 の溝開口部は上部が球状部 4 3 が通過出来る幅で開口しており、下部は球状部 4 3 が通過出来ない幅で開口している。そしてこの下部の開口部には球状部 4 3 の根本の部分が挟まる様になっており、通常はこの下部の溝内に球状部 4 3 が係合している。

【 0 1 2 0 】

この構造により可動操作ハンドル 3 0 を固定操作ハンドル 2 9 に対して開閉する事で、係合部材 4 2 を進退駆動する事が出来、係合部材 4 2 が進退駆動する事によりこれに螺着されている伝達部材 1 0 、伝達部材 5 が進退駆動され、それにより可動部 3 が先端部材 7 に対して開閉駆動される。

20

【 0 1 2 1 】

支持部材 7 2 の近位端には固定操作ハンドル 2 9 がネジ 7 6 とナット 7 7 により結合されており、固定操作ハンドル 2 9 には図 2 3 (B) に示す様に可動操作ハンドル 3 0 が回動自在に支持されているので、前述の様に固定操作ハンドル 2 9 に対して可動操作ハンドル 3 0 を開閉操作する事が出来る。

【 0 1 2 2 】

次に本実施例の実際の使用例について述べる。

まず、処置を行う生体組織に処置部 3 3 を対向させる。次にハンドピース 3 2 を操作手段 3 4 に対して回動させ、生体組織を処置するのに都合の良い向きに処置部 3 3 を合わせる。

30

【 0 1 2 3 】

そして可動操作ハンドル 3 0 を開放方向に回動させ、可動部 3 を開放させる。処置を行う生体組織を適当な力量を把持する。その後、図示しない超音波振動子 5 0 の駆動電源により超音波振動子 5 0 を駆動し、先端部材 7 と可動部 3 に超音波振動を伝達し生体組織に超音波振動を与える。

【 0 1 2 4 】

この時に前述の様に超音波振動の振幅を大きくする、把持力量を大きくする、超音波振動を与える時間を長くするといったファクタで処置を行うと、生体組織を切開するのに都合が良く、逆のファクタにすると凝固を行うので都合が良いので、生体組織の状況等を考慮して適切な処置を行う。

40

【 0 1 2 5 】

又、図示しない高周波電流供給電源を超音波振動子 5 0 に印加する事により、超音波振動子 5 0 からプローブ 8 、先端カバー 6 、先端部材 7 、可動部 3 を通じて生体組織に高周波電流を与える事が出来、高周波電流を用いた処置を行う事も出来る。

【 0 1 2 6 】

この際に前述の様に外部に露出している係合部材 4 2 外周が電気絶縁性のあるチューブ 6 7 によって被覆されており、可動操作ハンドル 3 0 、シース 9 、ネジリング 8 2 、軸受け 1 5 、ハンドピース 3 2 、ケーシング等を P E E K やポリサルフォン等の電気絶縁性のある材料で成形する事により、高周波電流の漏電を防止出来るので安全に処置が行える。

【 0 1 2 7 】

50

超音波振動による処置と高周波電流による処置は独立して行う事が出来るので、それぞれを別々に用いて処置を行っても良く、あるいは同時に用いて処置を行っても良い。

【 0 1 2 8 】

次に本実施例の分解及び組立方法について述べる。

まず、シース 9 をネジリング 8 2 から遠位方向に引き抜く。次に固定操作ハンドル 2 9 をネジ 7 6 を取り外す事により、支持部材 7 2 から下方に取り外す。これに伴い、可動操作ハンドル 3 0 も下方に移動するので、前述の係合受け部材 7 5 に係合している球状部 4 3 が溝から外れる事により、係合部材 4 2 が可動操作ハンドル 3 0 から脱落する。

これにより、固定操作ハンドル 2 9、可動操作ハンドル 3 0 が一体となったものが操作手段 3 4 より分解される。

10

【 0 1 2 9 】

続いてネジリング 8 2 をハンドピース 3 2 から取り外し、それにより軸受け 1 5 から分解される。その後、ハンドピース 3 2 を近位側に軸受け 1 5、軸受け 1 9 から引き抜く事により、ハンドピース 3 2 とプローブ 8 等が一体となったものが操作手段 3 4 から分解される。

【 0 1 3 0 】

ハンドピース 3 2 からプローブ 8 を取り外し、伝達部材 1 0 から係合部材 4 2 を取り外す。その後、プローブ 8 から先端部材 7 を取り外す。

以上の分解操作により超音波切開凝固装置 3 1 は洗浄及び滅菌が良好に行える状態になり、各部の洗浄及び滅菌を行う事が出来る。

20

【 0 1 3 1 】

再度、超音波切開凝固装置 3 1 を組立てる場合には前記分解手順の逆の手順で組み立てる事が出来る。

又、この様に分解及び組立が出来るので、万一、一部が破損した場合等にはその部品のみを交換する事で再び使用出来る様になっている。

【 0 1 3 2 】

(第 1 0 実施例)

図 2 4 は本発明の第 1 0 実施例を示す。

【 0 1 3 3 】

本実施例の構成は第 9 実施例とほぼ同様であるが、プローブ 8 が湾曲しており、シース 9 とその内部を挿通されている伝達部材 1 0 とが弾性部材で形成されている。伝達部材 1 0 は例えば N i - T i 合金等で製造されている超弾性ワイヤ等で形成されている。シース 9 は例えば P T F E 材等の可撓性部材で成形されている。

30

【 0 1 3 4 】

これにより、湾曲しているプローブ 8 をシース 9 内部に挿入する事が出来ると共に、プローブ 8 内を伝達部材 1 0 が進退駆動可能となっている。

【 0 1 3 5 】

これらの構成により、処置部 3 3 が操作手段 3 4 に対して回動出来る事とあいまって良好な操作性で得られている。

その他の構成、動作等は第 9 実施例と同様である。

40

【 0 1 3 6 】

なお、上述の各実施例等において、例えばネジとネジ孔或いは雄ネジと雌ネジとの螺合或いは螺着による分解及び組立可能な構造においてはネジ或いは雄ねじを設けた部材とネジ孔或いは雌ネジを設けた部材とを入れ換える等しても良いことは明らかであるし、突起或いは爪或いはピン等と凹部或いは溝等との噛合或いは係合等の場合も同様である。

【 0 1 3 7 】

以上の様に本発明の主旨である、超音波切開凝固装置の生体組織に対して処置を行う処置部を生体内に挿入する為の挿入部のシースを操作手段に対して回動自在にしたという点に沿った範囲であれば、その他の構成はどの趣旨のものでも良くその内容に制限は無い。

【 0 1 3 8 】

50

〔付記〕

1. 超音波振動を発生する超音波振動子と、前記超音波振動子を内蔵したハンドピースを有し、前記超音波振動子により発生した超音波振動を、生体組織に対して処置を行う為の処置部へ伝達する振動伝達部材であるプローブが超音波振動子に接続されており、前記プローブを覆う保護部材であるシースを有し、前記プローブ遠位端との間に生体組織を把持する把持部材を有し、前記プローブ遠位端と前記把持部材とにより生体組織を把持及び開放する為の操作を行う操作手段と、前記操作手段の操作により前記把持部材を駆動する伝達部材を有する超音波切開凝固装置において、操作手段に対して前記シースを分解及び組立可能な構成となっている。

【0139】

10

そして、分解することにより各部を簡単確実に洗浄及び滅菌出来ると共に、破損時の部品交換を容易にし、更には色々な把持部材やシース、プローブ等を組み合わせて処置に最適な超音波切開凝固装置を構築出来る。

【0140】

2. 付記1において、
前記把持部材と前記伝達部材は該ユニット状の鉗子ユニットとなっており、
前記シースは前記プローブが挿通される管路と、
前記鉗子ユニットが挿通される管路を有し、
前記鉗子ユニットは前記シースに対して分解及び組立可能であり、
前記シースと前記鉗子ユニットが共に前記操作手段に対して分解及び組立可能であるもの。

20

3. 付記1、付記2において、
前記ハンドピースが前記シース及び前記操作手段に対して分解及び組立可能であるもの。

【0141】

4. 付記1、付記2、3において、
前記プローブが前記ハンドピースに対して分解及び組立可能であるもの。
5. 付記1において、
前記把持部材は前記プローブ遠位端に設けられた先端部材に回動自在に取り付けられ、
前記伝達部材と前記プローブが前記シース内の同一管路内に挿通しているもの。

30

6. 付記5において、
前記伝達部材が前記プローブ内部に挿通しているもの。

【0142】

7. 付記5、6において、
前記ハンドピースと前記伝達部材が前記操作手段及び前記シースに対して分解及び組立可能であるもの。

8. 付記5～7において、
前記先端部材が前記プローブに対して分解及び組立可能であると共に、
前記伝達部材が前記操作手段に対して分解及び組立可能であるもの。

9. 付記1～付記8において、
前記シースを前記操作手段に対して分解する際に、
前記シースは前記操作手段に対して遠位方向に移動する事により分解し、
前記シースを前記操作手段に対して組み立てる際には、
前記シースを前記操作手段に対して近位方向に移動する事により結合するもの。

40

【0143】

10. 付記1、付記2～9において、
前記ハンドピースが前記プローブと前記先端部材を装備した状態で前記操作手段に取り付けられており、
前記伝達部材が前記操作手段に結合した状態で、
前記シースが前記操作手段に対して分解及び組立可能であるもの。

50

1 1 . 付記 1、付記 2 ~ 1 0 において、

前記シースと前記操作手段の分解及び組立方法がネジとネジ孔によるもの。 1 2 . 付記 1、付記 2 ~ 1 0 において、

前記シースと前記操作手段の分解及び組立方法が弾性部材と弾性部材に噛合する溝あるいは突起によるもの。

【 0 1 4 4 】

1 3 . 付記 1、付記 2 ~ 1 0 において、

前記シースと前記操作手段の分解及び組立方法が両者のうちのどちらかに設けられている雄ネジと、

もう一方に設けられている雌ネジによるもの。

10

1 4 . 付記 1、付記 2 ~ 1 0 において、

前記シースと前記操作手段の分解及び組立方法が両者のうちのどちらかに設けられているカム溝と、

もう一方に設けられている該カム溝に噛合するピンによるもの。

【図面の簡単な説明】

【 0 1 4 5 】

【図 1】本発明の第 1 実施例の全体図。

【図 2】処置部と挿入部の構造を示す断面図。

【図 3】図 2 の D 1 - D 2 - D 3 - D 4 線断面図。

【図 4】図 2 の正面から見た処置部の正面図。

20

【図 5】図 2 の A - A ' ~ G - G ' 線断面図。

【図 6】操作手段を示す平面図。

【図 7】操作手段及びその一部を拡大して示す部分断面図。

【図 8】図 7 (A) の H - H ' 線及び I - I ' 線断面図。

【図 9】図 7 (A) の J - J ' ~ M - M ' 線断面図。

【図 1 0】本発明の第 2 実施例における処置部の正面及び側面形状を示す図。

【図 1 1】本発明の第 3 実施例における処置部の形状及び可動部の一部を示す図。

【図 1 2】本発明の第 4 実施例における挿入部の一部を示す断面図。

【図 1 3】本発明の第 5 実施例における処置部を示す斜視図。

【図 1 4】本発明の第 6 実施例における挿入部の一部を示す断面図。

30

【図 1 5】本発明の第 7 実施例における操作手段の軸受け部及びボールクリック機構を示す図。

【図 1 6】本発明の第 8 実施例における操作手段を示す断面図。

【図 1 7】第 8 実施例における操作手段の軸受け部を示す斜視図。

【図 1 8】本発明の第 9 実施例の全体図。

【図 1 9】処置部及びプローブと処置部の一部の断面を示す図。

【図 2 0】図 1 9 の N - N ' ~ P - P ' 線及び S - S ' 線断面図。

【図 2 1】挿入部を示す断面図。

【図 2 2】操作手段を示す断面図。

【図 2 3】図 2 2 の T - T ' ~ V - V ' 線断面図。

40

【図 2 4】本発明の第 1 0 実施例の全体図。

【符号の説明】

【 0 1 4 6 】

1 ... 把持部材

2 ... ネジ

3 ... 可動部

4 ... 保護部材

5、1 0 ... 伝達部材

6 ... 先端カバー

7 ... 先端部材

50


8 ... プロープ
9、 1 1、 2 2 ... シース
1 2 ... ノブ
1 3、 2 0 ... 結合部材
1 4、 1 8 ... パイプ
1 5、 1 9 ... 軸受け
1 6、 1 7 ... 駆動部材
2 1 ... ガイドシース
2 3、 2 4 ... リング
2 5 ... 駆動ピン
2 6 ... 駆動部材
2 7、 2 8 ... ネジ
2 9 ... 固定操作ハンドル
3 0 ... 可動操作ハンドル
3 1 ... 超音波切開凝固装置
3 2 ... ハンドピース
3 3 ... 処置部
3 4 ... 操作手段
3 8 ... スナップフィット
3 9 ... 突起部
4 0 ... 回転防止機構
4 1 ... 連結部材
4 2 ... 係合部材
4 3 ... 球状部
4 5、 4 7、 4 8 ... Oリング
5 0 ... 超音波振動子
5 6 ... 係合溝
5 7 ... 挿入部

10


20

代理人 弁理士 伊藤 進

【図 6】

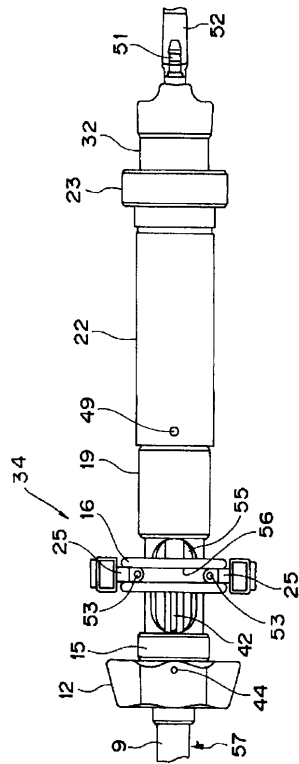


【図 7】

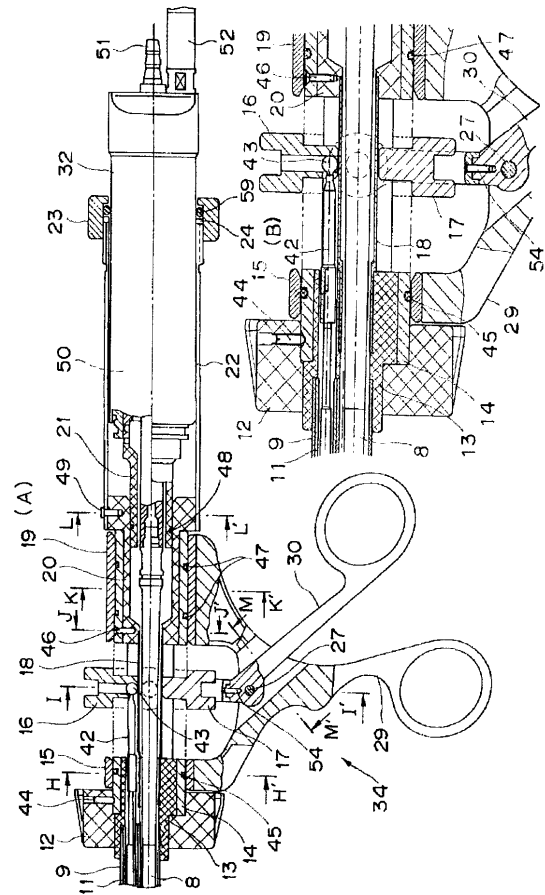

【図 8】

(A)


(B)

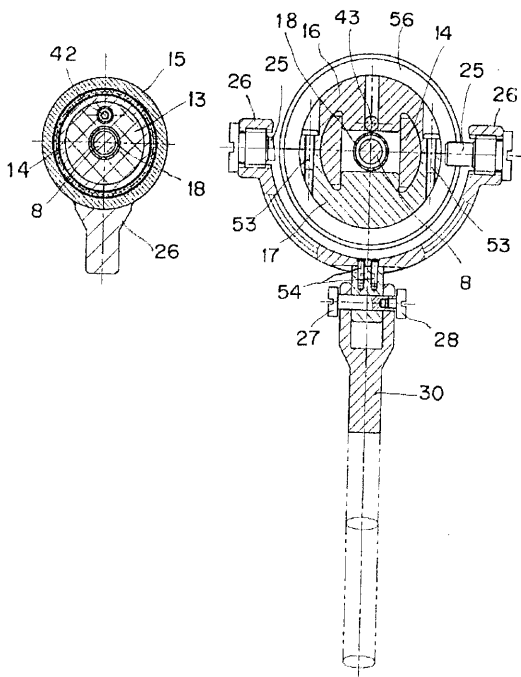


【図 9】

(A)


(B)

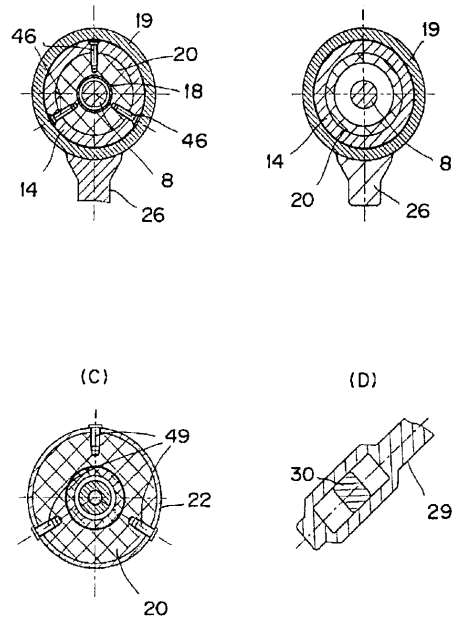


【図 10】

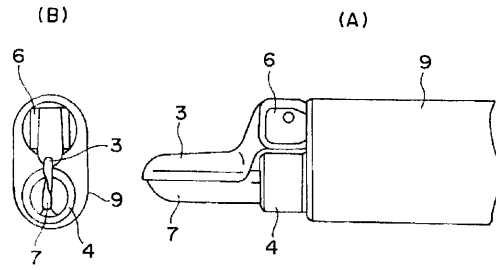


【図 11】

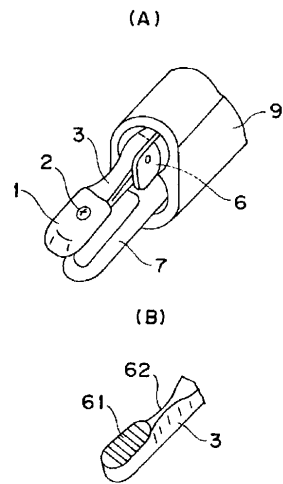


【図 15】

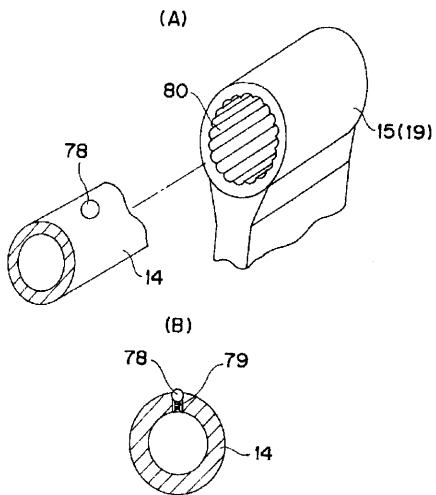


【図 12】

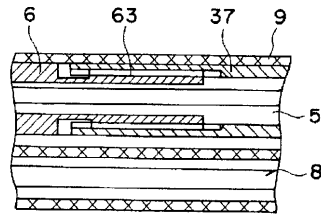


【図 13】




【図 14】




【図 16】

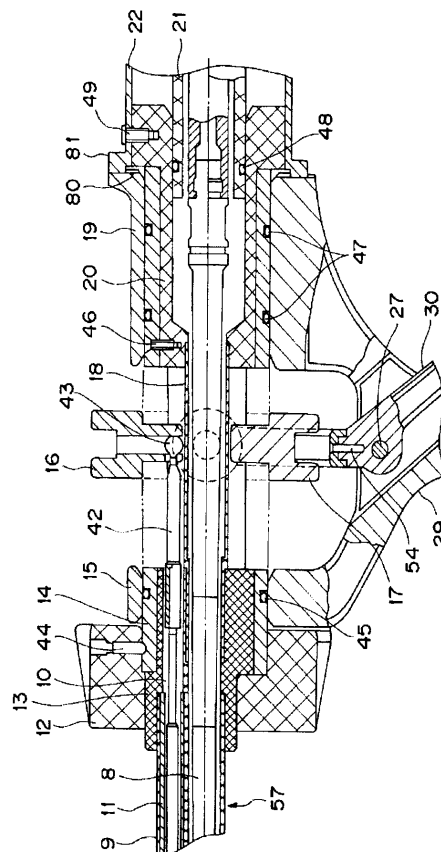


【図 17】

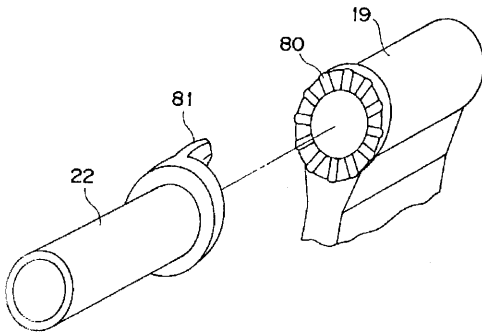


【図 18】

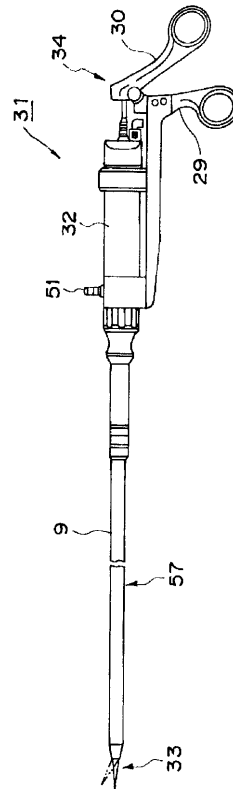


【図 19】

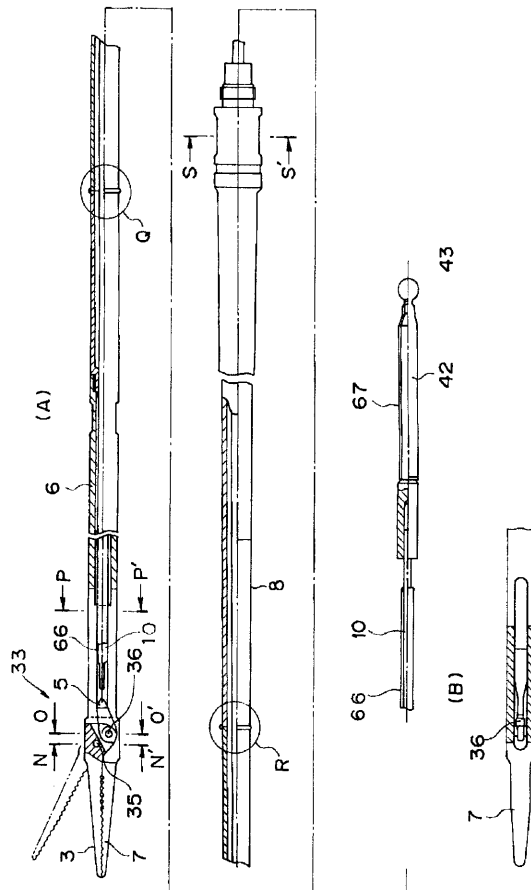


【図 20】

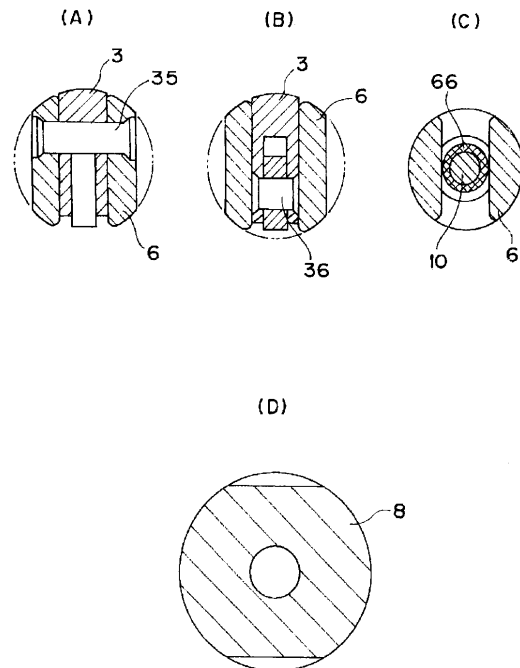


【図 2 1】

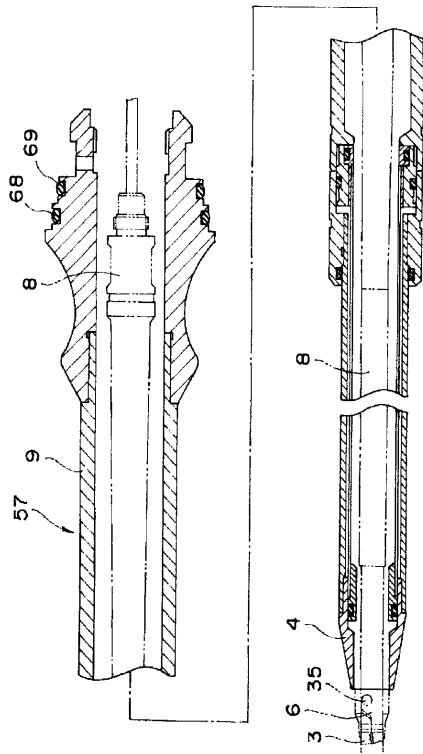


【図 2 2】

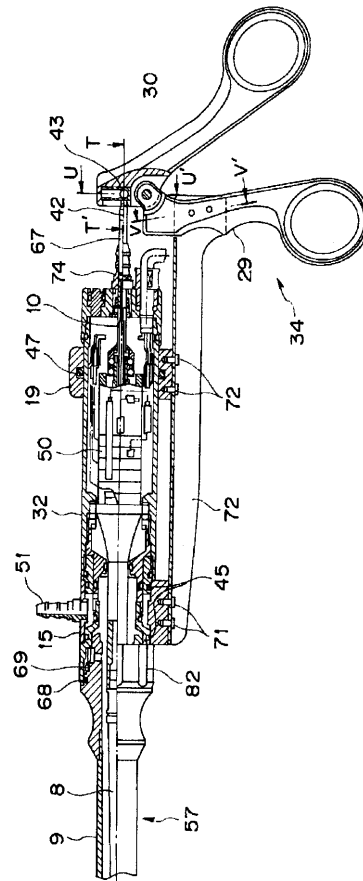

【図 2 3】

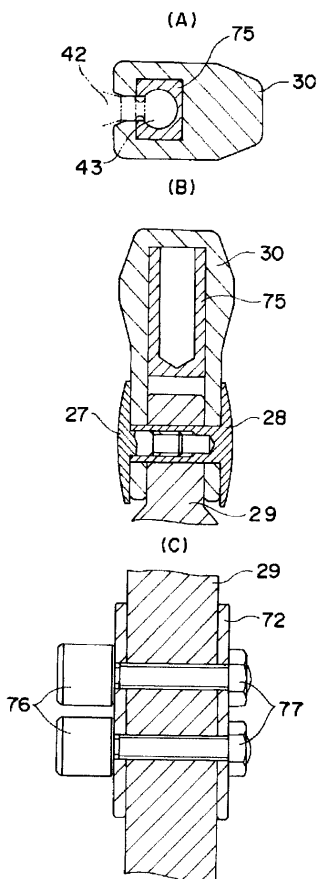

【図 2 4】

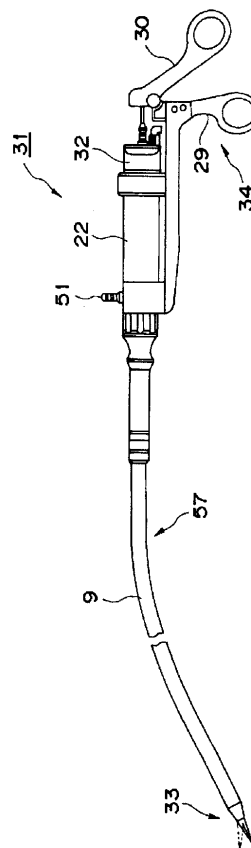

专利名称(译)	超音波切开凝固装置		
公开(公告)号	JP2004073890A	公开(公告)日	2004-03-11
申请号	JP2003396311	申请日	2003-11-26
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	菅井俊哉		
发明人	菅井 俊哉		
IPC分类号	A61B18/00 A61B18/12		
FI分类号	A61B17/36.330 A61B17/39.310 A61B17/39.320 A61B17/32.510 A61B18/12 A61B18/14		
F-TERM分类号	4C060/JJ13 4C060/JJ23 4C060/KK03 4C060/KK04 4C060/KK12 4C060/MM24 4C160/JJ13 4C160/JJ15 4C160/JJ23 4C160/JJ24 4C160/JJ46 4C160/JJ47 4C160/KK03 4C160/KK04 4C160/KK15 4C160/KK36 4C160/KK37 4C160/KL02 4C160/MM32 4C160/NN03 4C160/NN09 4C160/NN10 4C160/NN12 4C160/NN13 4C160/NN22		
代理人(译)	伊藤 进		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够更精确地治疗活组织的超声切口凝结装置。 解决方案：产生超声波振动的超声波振动器，以及与超声波振动器连接并将超声波振动传递到用于对活组织进行治疗的治疗部的振动传递部件 探针和将生物组织夹持在探针远端部之间的夹持构件，以及操作单元，该操作单元执行用于通过探针远端部和夹持构件夹持和释放生物组织的操作， 探针的前端部具有能够利用把持部件把持生物组织的形状，并且其直径朝向顶端侧减小。 [选择图]图2

